



Continuous Glucose Monitoring System

- ▶ Datenmanagementsystem (DMS) Pro-Benutzerhandbuch
- ▶ Manuale di istruzioni del sistema di gestione dei dati (DMS) Pro
- ▶ Guide de l'utilisateur du système de gestion des données (DMS) Pro

Inhaltsverzeichnis | Sommario | Inhoudsopgave | Table des matières

Deutsch	Datenmanagementsystem (DMS) Pro-Benutzerhandbuch.....	05
Italiano	Manuale di istruzioni del sistema di gestione dei dati (DMS) Pro	59
Français	Guide de l'utilisateur du système de gestion des données (DMS) Pro.....	114



Datenmanagementsystem (DMS) Pro-Benutzerhandbuch

Eversense und das Eversense-Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Andere Markenzeichen und ihre Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Eversense DMS enthält keine Malware oder Computerviren, die Ihren Computer beschädigen können. Wir empfehlen Ihnen, ein geeignetes Firewall-Programm und ein Antiviren-Programm auf Ihrem Computer zu nutzen, um ihn gegen Malware und Viren zu schützen.

Die Eversense Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **global.eversenseddiabetes.com**.

Inhalt

Glossar.....	9	4. DMS-Dashboard.....	32
I. Einleitung.....	10	Anzeigen von Eversense DMS-Daten eines Patienten	32
Verwendungszweck	10	Einstellen des Datumbereichs	34
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie	10	Eversense DMS-Dashboard	35
Hilfe und Support	10	5. Berichte.....	39
2. Erste Schritte.....	11	Zeit im Zielbereich	41
Registrieren einer Klinik und Erstellen Ihres Administratorkontos	11	Zeit im Bereich	42
Zugriff auf Eversense DMS Pro	13	Bericht Glukosevariabilität	44
Eversense DMS Pro-Administrator	13	Bericht Glukose-Trend	46
Navigationsmenü	14	Bericht Glukoseverlauf	47
Eversense DMS Pro – Klinikmitarbeiter-Benutzer	19	Täglicher Glukosebericht	48
Ihr Profil und das Navigationsmenü	19	Bericht Glukoseverteilung	50
Profil	20	Bericht Transmitter-Protokoll	51
Kennwort vergessen?	22	6. Einstellungen.....	53
Startseite	23	Glukose	53
3. Berechtigungen.....	24	7. Hilfe.....	55
Anzeigen	25	Über uns	55
Hinzufügen	27	8. Fehlerbehebung.....	56
Bearbeiten	30		
Administrator	31		

AutoSync Wenn diese Funktion auf der Eversense Mobilgeräte-App eingeschaltet ist, werden Ihre Glukosdaten und -einstellungen automatisch alle zwei Stunden mit dem Eversense DMS synchronisiert.

Blutzucker Der über einen Fingerbeerenstich erhaltene Blutzuckerwert.

Blutzucker Der vom Eversense-Sensor gemessene und angegebene Blutglukosewert.

Blutzuckermessgerät Ein im Handel erhältliches Gerät zum Messen des Blutzuckers anhand einer Blutprobe, die mittels Stich in die Fingerbeere gewonnen wird.

CGM Kontinuierliche Glukoseüberwachung. Die kontinuierliche Überwachung Ihres Glukosespiegels anhand der Gewebsflüssigkeit alle paar Minuten.

EULA Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

Eversense App Softwareprogramm, das auf einem Mobilgerät installiert ist und zur Anzeige der vom Smart Transmitter gesendeten CGM-Glukosdaten dient.

Eversense Datenmanagementsystem (DMS) Eine webbasierte Anwendung, die mit der Eversense App kompatibel ist und in der Ihre Glukosdaten gespeichert und angezeigt werden können.

Eversense Kundenanwendung Eine Desktop-Anwendung, die es Eversense-Benutzern erlaubt, die Daten von ihrem Smart Transmitter mithilfe eines USB-Kabels auf das Datenmanagementsystem hochzuladen.

Gewebsflüssigkeit (Interstitial Fluid, ISF) Die Flüssigkeit zwischen den Körperzellen. Das Eversense CGM misst die Glukose in einer Gewebsflüssigkeitsprobe und nicht den Glukosewert in einer Blutprobe, die über einen Stich in die Fingerbeere entnommen wird.

Kalibrierung Messung des Blutzuckers anhand einer in die Eversense App eingegebenen Blutzuckermessung, um so die Genauigkeit des Systems zu überprüfen. Beim Eversense System gibt es zwei Phasen: Die Initialisierungsphase, während der vier Blutzuckermessungen erforderlich sind, und die tägliche Kalibrierungsphase, während der zweimal täglich eine Blutzuckermessung benötigt wird.

Kontraindikation Ein Zustand bzw. ein Umstand, der bedingt, dass das Gerät von einer Person nicht angewendet werden sollte.

mg/dl Milligramm pro Deziliter, eine Maßeinheit, welche die Konzentration einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeitsmenge angibt. In einigen Ländern, einschließlich den Vereinigten Staaten, werden Glukose-Testergebnisse in mg/dl angegeben. Dazu misst ein Blutzuckermessgerät die Glukose im Blut. CGM-Systeme, wie das Eversense CGM-System, messen die Glukose in der Gewebsflüssigkeit.

mmol/l Millimol pro Liter, eine Maßeinheit, welche die Konzentration einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeitsmenge angibt. In vielen Ländern werden Glukose-Testergebnisse in mmol/l angegeben. Dazu misst ein Blutzuckermessgerät die Glukose im Blut. CGM-Systeme, wie das Eversense CGM-System, messen die Glukose in der Gewebsflüssigkeit.

Sensor Ein subkutan eingesetztes Gerät zur kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels in der Gewebsflüssigkeit.

Smart Transmitter Ein wiederverwendbares Gerät, das extern über dem eingesetzten Sensor getragen wird und welches den Sensor mit Spannung versorgt und die Glukosdaten zur Anzeige in der Eversense App an das Mobilgerät sendet.

I. Einleitung

Verwendungszweck

Das Eversense Data Management System (DMS) Pro ist eine webbasierte Anwendung und für medizinische Fachleute vorgesehen, die die Glukosedaten ihrer Patienten, bei denen das Eversense CGM System eingesetzt ist, verwalten und überprüfen.

Eine Liste kompatibler Geräte und Betriebssysteme finden Sie unter <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie

Die Nutzung von Eversense DMS Pro unterliegt den AGB der aktuellen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzrichtlinie von Eversense. Diese Dokumente werden von Zeit zu Zeit aktualisiert und unter global.eversenseddiabetes.com bereitgestellt.

Hilfe und Support

Sollten Sie weitere Fragen zum DMS Pro-Benutzerhandbuch haben oder Hilfe zur Problembeseitigung benötigen, wenden Sie sich innerhalb der USA unter der gebührenfreien Nummer 844-SENSE4U (844-736-7348) an den Kundendienst. Wenden Sie sich außerhalb der USA an Ihren regionalen Händler, den Sie unter global.eversenseddiabetes.com finden.

2. Erste Schritte

Registrieren einer Klinik und Erstellen Ihres Administratorkontos

Um Ihre Klinik zu registrieren, müssen Sie auch ein klinisches Administratorkonto registrieren. Gehen Sie dazu zu **globalpro.eversensedms.com**. Nach der Registrierung wird Ihrer Klinik eine Kliniknummer zugewiesen, die Patienten bei der Anmeldung bei Ihrer Klinik als Kennung nutzen können:

So registrieren Sie Ihre Klinik und erstellen Sie Ihr Administratorkonto:

1. Gehen Sie zu **globalpro.eversensedms.com**.
2. Klicken Sie im Anmeldefeld auf „Anmelden“.

eversense®

German

Benötigen Sie ein Eversense DMS Pro-Konto?

Anmelden

E-Mail-Adresse *

Beispiel@email.com

Kennwort *

Kennwort

* Pflichtfeld

Anmelden

[Kennwort vergessen?](#)


Problem beim Anmelden? [Kontakt](#)

Um sich bei Eversense DMS für Ihr CGM-System anzumelden, klicken Sie [hier](#)

3. Füllen Sie das Registrierungsformular aus.

WICHTIG: Sie können nicht die gleiche E-Mail-Adresse als Benutzernamen für Eversense DMS Pro und ein persönliches Eversense DMS-Konto verwenden.

4. Klicken Sie auf „Übermitteln“.

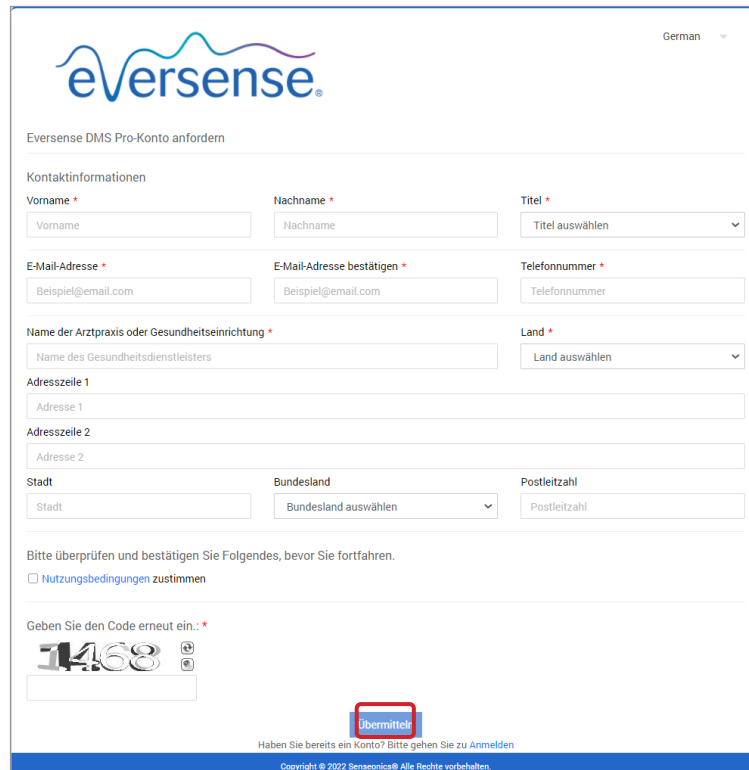

German

eversense®

Eversense DMS Pro-Konto anfordern

Kontaktinformationen

Vorname * Nachname * Titel *

Vorname Nachname Titel auswählen

E-Mail-Adresse * E-Mail-Adresse bestätigen * Telefonnummer *

Beispiel@email.com Beispiel@email.com Telefonnummer

Name der Arztpraxis oder Gesundheitseinrichtung * Land *

Name des Gesundheitsdienstleisters Land auswählen

Adresszeile 1

Adresse 1

Adresszeile 2

Adresse 2

Stadt Bundesland Postleitzahl

Stadt Bundesland auswählen Postleitzahl

Bitte überprüfen und bestätigen Sie Folgendes, bevor Sie fortfahren.

Nutzungsbedingungen zustimmen

Geben Sie den Code erneut ein.: *

1468

Übermitteln

Haben Sie bereits ein Konto? Bitte gehen Sie zu Anmelden.


Copyright © 2022 Senseonics® Alle Rechte vorbehalten.

5. Sie erhalten einen Link per E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren, wenn Ihre Klinik und Administratorkonten genehmigt wurden.

Der Link verfällt nach 72 Stunden.

6. Nachdem Sie auf den Link geklickt haben, um Ihr Konto zu aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Eversense DMS Pro-Kennwort zu erstellen.

Nach Erstellung Ihres Kennworts können Sie sich anmelden und die Kliniknummer oben auf dem Bildschirm neben dem Kliniknamen sehen.

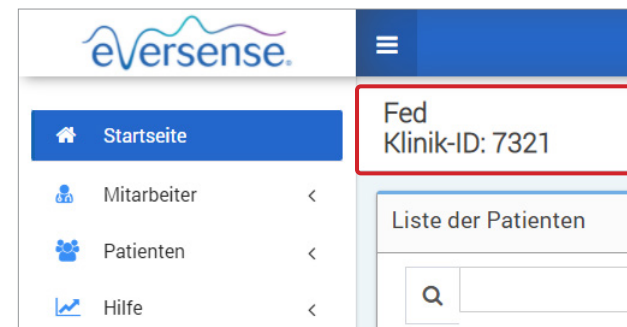

eversense®

Startseite

Mitarbeiter <

Patienten <

Hilfe <

Fed Klinik-ID: 7321

Liste der Patienten

Q

Zugriff auf Eversense DMS Pro

Navigieren Sie zum Eversense DMS Pro, um auf globalpro.eversensedms.com zuzugreifen. Sie werden nach Auswahl Ihrer Region zur Anmeldeseite weitergeleitet.

Eversense DMS Pro-Administrator

Für Eversense DMS Pro ist mindestens ein Kontoadministrator erforderlich, der:

- die Klinik registrieren kann, die die eindeutige Klinikennung erstellt.
- andere Mitarbeiter einladen kann, um sich beim Klinikstandort anzumelden und ihre Berechtigungen einzurichten.
- die Berechtigung der Mitarbeiter ändern kann.
- Mitarbeiter aus dem klinischen Administratorkonto löschen kann.
- bei der Rücksetzung des Kennworts für andere Mitarbeiter helfen kann.

DMS Pro-Berechtigungsebenen

Bei Eversense DMS Pro gibt es verschiedene Berechtigungen, die ein Klinikmitarbeiter-Benutzer haben kann. Die Berechtigungen sind **Administrator**, **Anzeigen**, **Bearbeiten** und **Hinzufügen**. Der Administrator Ihrer Klinik weist den anderen Klinikmitarbeiter-Benutzern Berechtigungen zu.

- **Administrator:** Kann anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.
- **Anzeigen:** Ermöglicht es dem Klinikmitarbeiter-Benutzer die akzeptierten Patientenlisten und die Daten in jedem Konto des DMS anzuzeigen.
- **Hinzufügen:** Weist dem Klinikmitarbeiter-Benutzer dieselben Berechtigungen wie die Berechtigung Anzeigen zu. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, Patientenfragen zur Aufnahme in Ihre Klinik zu akzeptieren und Patienten Einladungen zur Aufnahme in Ihre Klinik zu senden.
- **Bearbeiten:** Ermöglicht es dem Klinikmitarbeiter-Benutzer, Patientendaten in DMS Pro zu bearbeiten, einen Patienten von der Klinik abzumelden und ihre Eversense DMS-Daten anzuzeigen. Jegliche in DMS Pro vorgenommene Änderungen führen nicht dazu, dass die Informationen, die der Patient auf seinem persönlichen Konto gespeichert hat, verändert werden.

eversense

German

Benötigen Sie ein Eversense DMS Pro-Konto ?

[Anmelden](#)

E-Mail-Adresse *

Beispiel@email.com

Kennwort *

Kennwort

* Pflichtfeld

[Anmelden](#)

[Kennwort vergessen?](#)

Problem beim Anmelden? [Kontakt](#)

Um sich bei Eversense DMS für Ihr CGM-System anzumelden, klicken Sie [hier](#)

Navigationsmenü

Links oben auf der Startseite befindet sich das Navigationsmenü. Sie können das Navigationsmenü öffnen, indem Sie auf  klicken. Klicken Sie im Menü auf jede Schaltfläche, um zu dieser Auswahl zu navigieren.


Hinweis:

- Sie können Ihre bevorzugte Sprache auch auswählen, indem Sie auf das Flaggensymbol oben rechts auf der Seite klicken.
- Ihr Navigationsmenü kann unter Umständen anders dargestellt werden, und zwar abhängig von der Berechtigung, die Ihnen vom Klinikadministrator zugewiesen wurde.

Administrator



Anzeigen

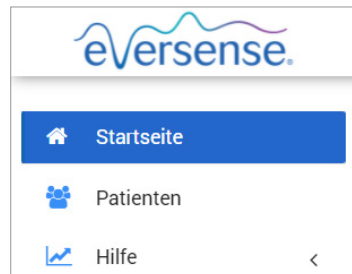

Hinzufügen




Bearbeiten




So fügen Sie Mitarbeiter hinzu:

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Mitarbeiter“.
2. Klicken Sie auf „Mitarbeiter hinzufügen“.
3. Geben Sie die Kontaktdaten ein und wählen Sie ihren Titel aus.
4. Überprüfen und bearbeiten Sie die Berechtigungen nach Bedarf.
Mehrere Berechtigungen können zugewiesen werden.
5. Klicken Sie auf „Senden“.
6. Der Klinikmitarbeiter erhält die Einladung per E-Mail, und er muss zum Anmelden auf den Überprüfungslink in der E-Mail klicken und dafür das in der E-Mail bereitgestellte Kennwort verwenden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird er aufgefordert, ein neues Kennwort zu erstellen.





WICHTIG: Die Zuweisung von Standardberechtigungen erfolgt auf der Basis des ausgewählten Titels. Wenn der Titel eines Benutzer geändert wird, sollten Sie die Berechtigungen überprüfen und nach Bedarf bearbeiten.



So bearbeiten Sie Mitarbeiterinformationen und Berechtigungen:

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Mitarbeiter“.
2. Klicken Sie auf , um deren Informationsseite zu öffnen.
3. Von dieser Seite aus können Sie:
 - a. Den Namen und/oder Titel bearbeiten
 - b. Ihre Berechtigungen aktualisieren
4. Klicken Sie nach der Fertigstellung auf „Aktualisieren“.

WICHTIG: Wenn der Titel eines Benutzer geändert wird, sollten Sie die Berechtigungen überprüfen und nach Bedarf bearbeiten.

Nachname	Vorname	Titel	E-Mail-Adresse	Status		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Aktiv		

Klinikmitarbeiter bearbeiten ✕

Kontaktinformationen

Vorname *

Nachname *

Titel *


Aktiv Inaktiv

Genehmigung *

<input checked="" type="checkbox"/>	Genehmigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator
<input checked="" type="checkbox"/>	Hinzufügen
<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzeigen

Aktualisieren
Abbrechen

So deaktivieren Sie die Konten von Klinikmitarbeitern:

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Mitarbeiter“.
2. Klicken Sie auf , um deren Informationsseite zu öffnen.
3. Wählen Sie unten auf der Seite **Inaktiv** aus.

Wenn ein Konto inaktiv ist, kann der Klinikmitarbeiter in DMS Pro keine Patientenkonten mehr hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

Klinikmitarbeiter bearbeiten

Kontaktinformationen

Vorname *

Nachname *



Titel *





Aktiv **Inaktiv**

Genehmigung *

<input checked="" type="checkbox"/>	Genehmigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator
<input checked="" type="checkbox"/>	Hinzufügen
<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzeigen

So unterstützen Sie die Zurücksetzung des Kennworts für Klinikmitarbeiter:

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Mitarbeiter“.
2. Klicken Sie auf .
Suchen Sie den Klinikmitarbeiter und klicken Sie auf .
3. Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es.
4. Klicken Sie auf Benutzer benachrichtigen, wenn Sie den Mitarbeiter per E-Mail darüber informieren möchten, dass sein Kennwort zurückgesetzt wurde.
5. Klicken Sie auf „Kennwort zurücksetzen“.

Nachname	Vorname	Titel	E-Mail-Adresse	Status		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Aktiv		

Passwort für Klinikmitarbeiter zurücksetzen ✕

Benutzername

Neues Kennwort

Kennwort bestätigen

Benutzer benachrichtigen

Eversense DMS Pro – Klinikmitarbeiter-Benutzer

Ihr Administrator erstellt für Sie ein Konto in Eversense DMS Pro. Sie erhalten eine E-Mail mit einem temporären Kennwort und einen Link für die Aktivierung Ihres Kontos und für die Erstellung eines permanenten Kennworts. Klicken Sie auf den Link, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen und die Startseite anzuzeigen. Sobald Ihr Konto aktiviert ist, können Sie sich jederzeit unter **globalpro.eversensedms.com** anmelden.

2

Ihr Profil und das Navigationsmenü

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Startseite angezeigt.

- Oben rechts auf der Seite können Sie auf die Informationen Ihrer **Profil**-Seite zugreifen.
- Oben links auf der Seite wird ein **Navigationsmenü** angezeigt. Ihr Navigationsmenü kann unter Umständen anders angezeigt werden, abhängig von der Berechtigung, die Ihnen vom Klinikadministrator zugewiesen wurde.

The screenshot displays the Eversense DMS Pro interface. On the left, a navigation menu is highlighted with a red box, containing the following items: 'Startseite' (with a home icon), 'Mitarbeiter' (with a person icon), and 'Patienten' (with a group icon). The main content area shows the clinic name 'High Street Clinic' and 'Klinik-ID: 7322'. Below this, there is a section titled 'Liste der Patienten' with a search bar and a refresh button. At the bottom right, there is a button labeled 'Patienten nach Anbieter'. In the top right corner, the user's profile is visible, showing the email address 'jonj97329@gmail.com' and a dropdown arrow. The language is set to 'German'.


Profil

Mit dieser Funktion, die sich oben rechts auf der Startseite befindet, können Sie Ihren Namen oder Ihr Kennwort ändern, Ihr Benutzerprofil bearbeiten oder sich von Eversense DMS Pro abmelden.


So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen.

Es wird ein Dropdown-Menü mit Ihrem Profilbild, Ihrer letzten Anmeldung und mit Optionen zum Anzeigen/Bearbeiten Ihres Profils oder zum Abmelden angezeigt.

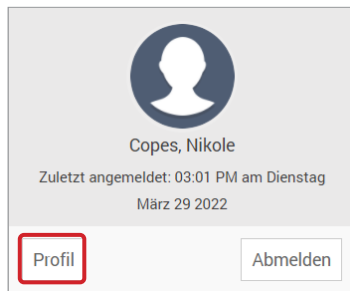

2. Klicken Sie auf „Profil“, um auf die Benutzerprofil-Einstellungen zuzugreifen.

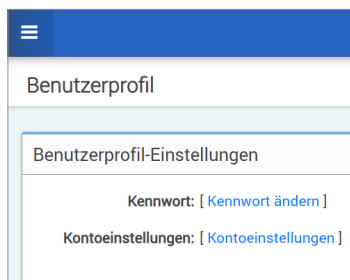

3. Klicken Sie auf „Kennwort ändern“, um Ihr aktuelles Kennwort anzuzeigen und zu ändern.

4. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein.

5. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein und bestätigen Sie es.

6. Klicken Sie auf „Kennwort ändern“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Kennwort ändern

Aktuelles Kennwort *

Neues Kennwort *

Neues Kennwort bestätigen *

[Zurück zum Profil](#)
[Kennwort ändern](#)

So passen Sie Ihre Kontodaten an:

1. Klicken Sie auf „Kontoeinstellungen“.

2. Geben Sie die Daten ein, die Sie ändern werden.

Sie können Ihr Profilbild ändern, indem Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen** klicken und auf Ihrem Computer ein Bild auswählen.

3. Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die Seite Benutzerprofil-Einstellungen wird erneut angezeigt. Klicken Sie oben links im Navigationsfeld auf „**Startseite**“, um zur Startseite zurückzukehren. Patienten, die Eversense DMS verwenden oder Klinikmitarbeiter-Benutzer, die Eversense DMS Pro verwenden, können Ihr Profilbild nicht sehen.

Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen

Profildetails

Profilbild **Choose File** No file chosen


Vorname *

Nachname *


Mobiltelefonnummer

Kennwort vergessen?

1. Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „**Kennwort vergessen**“.
2. Geben Sie nach Aufforderung Ihre E-Mail-Adresse ein.
3. Klicken Sie auf „**E-Mail senden**“.

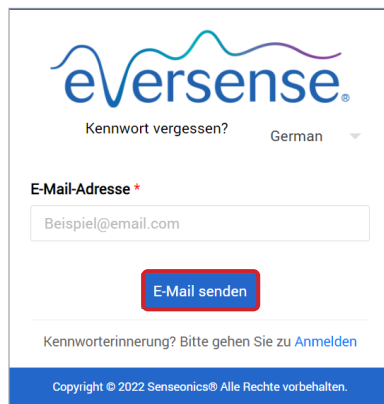

The screenshot shows the Eversense login page. At the top is the Eversense logo. Below it, the text 'Kennwort vergessen?' is highlighted with a red box. To the right of this text is a language dropdown menu set to 'German'. Below the logo area is a form with the label 'E-Mail-Adresse *' and a text input field containing 'Beispiel@email.com'. A red box highlights the 'E-Mail senden' button. At the bottom of the form, there is a link 'Kennworterinnerung? Bitte gehen Sie zu Anmelden' and a footer with 'Copyright © 2022 Senseonics® Alle Rechte vorbehalten.'

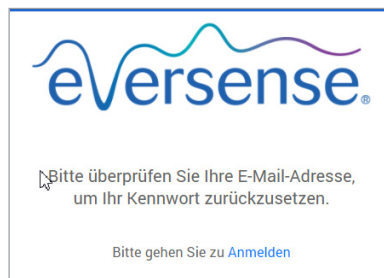


The screenshot shows a confirmation message from Eversense. It features the Eversense logo at the top. Below the logo, the text reads: 'Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um Ihr Kennwort zurückzusetzen.' A mouse cursor is pointing at the first 'i' in 'Bitte'. At the bottom, there is a link: 'Bitte gehen Sie zu Anmelden'.

Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Kennworts an Sie gesendet wurde.

4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Webseiten-Link.

Sie werden auf eine Webseite dirigiert, auf der Sie ein neues Kennwort erstellen und bestätigen können.

5. Klicken Sie auf „Kennwort zurücksetzen“.

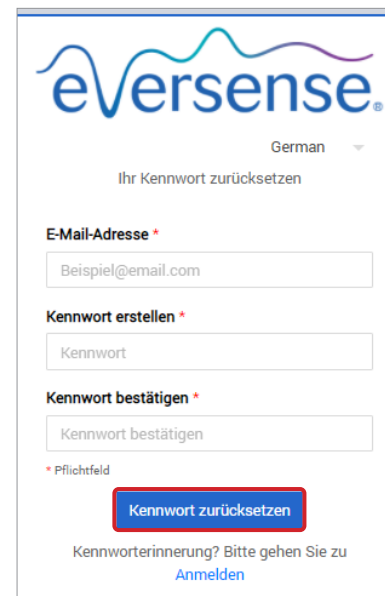

The screenshot shows the Eversense password reset page. At the top is the Eversense logo. Below it, the text 'German' is shown with a dropdown arrow. Underneath is the heading 'Ihr Kennwort zurücksetzen'. There are three form fields: 'E-Mail-Adresse *' (containing 'Beispiel@email.com'), 'Kennwort erstellen *' (containing 'Kennwort'), and 'Kennwort bestätigen *' (containing 'Kennwort bestätigen'). A red box highlights the 'Kennwort zurücksetzen' button. At the bottom, there is a link: 'Kennworterinnerung? Bitte gehen Sie zu Anmelden' and a small note '* Pflichtfeld'.



The screenshot shows a confirmation message from Eversense. It features the Eversense logo at the top. Below the logo, the text reads: 'Ihr Kennwort wurde zurückgesetzt.' At the bottom, there is a link: 'Bitte klicken Sie hier zum Anmelden'.

*Es wird eine Meldung angezeigt, dass Ihr Kennwort zurückgesetzt wurde. Wählen Sie „**klicken Sie hier**“ aus, um zur Anmeldeseite zurückzukehren.*

Startseite

Die Startseite zeigt je nach ausgewähltem Filter eine Liste aktiver Patienten und Systemstandards an. Bis Patienten zu DMS Pro Klinik hinzugefügt wurden, bleibt diese Seite leer.

The screenshot shows a web application interface for patient management. At the top, there is a blue header bar with a hamburger menu icon on the left, the language 'German' with a dropdown arrow, and a user profile icon with the email 'ouspro1@getnada.com' and a dropdown arrow. Below the header, the text 'Fed' and 'Klinik-ID: 7321' is displayed. The main content area is titled 'Liste der Patienten'. It features a search bar with a magnifying glass icon, a refresh button, and a checkbox labeled 'Deaktivierte Patienten anzeigen'. A blue button labeled 'Daten exportieren' is located on the right. Below this is a table with the following columns: 'Nachname des Patient', 'Vorname des Patienten', 'MRN', 'Geschlecht', 'DOB', 'Anbietername', 'Status', 'Datenaustausch', and 'Abbestellen'. The table is currently empty, and the text 'Keine Daten zur Anzeige' is centered below the table headers.


3. Berechtigungen

Ihr DMS Pro Administrator weist Ihnen eine Berechtigung zu.

3

Bei Eversense DMS Pro gibt es verschiedene Berechtigungen, die ein Klinikmitarbeiter-Benutzer in einer Klinik haben kann. Die Berechtigungen sind **Administrator, Anzeigen, Bearbeiten** und **Hinzufügen**. Der DMS Pro-Administrator Ihrer Klinik weist Ihnen die Berechtigungen zu. In allen Berechtigungsstufen ist es möglich, Patientenlisten zu durchsuchen, zu filtern und zu exportieren.

Patientenliste Suchen, Filtern und Exportieren




Klicken			
um zu	Suchen	Filtern	Exportieren
Wie	Sie können oben in der Suchleiste über der Patientenliste Patienten nach Namen suchen.	Sie können auch die Patientenliste nach Gesundheitsanbieter filtern, indem Sie auf Patienten nach Anbieter klicken. 1. Klicken Sie auf „Patienten nach Anbieter“. 2. Aktivieren Sie das Feld des Anbieters, dessen Patienten Sie anzeigen möchten. 3. Klicken Sie auf „Fortfahren“	Sie können die Patientenliste als Excel-Arbeitsblatt exportieren, wenn Sie auf Daten exportieren klicken.




Anzeigen

So zeigen Sie die Daten des Patienten an:

1. Klicken Sie auf den Namen des Patienten.

Liste der Patienten

🔍  Deaktivierte Patienten anzeigen Patienten nach Anbieter Daten exportieren

Nachname des Patient	Vorname des Patienten	MRN	Geschlecht	DOB	Anbietername	Status	Datenaustausch		Abbestellen
Martin	Paul		Männlich	01 Jun 1967	Laura Yankov	Aktiv	✓		

3

2. Die DMS-Informationen des Patienten werden angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter *Anzeigen von Eversense DMS-Patientendaten*.

3





Hinzufügen

Um einen Eversense CGM-Benutzer zu Ihrer Patientenliste hinzuzufügen, können Sie ihm entweder über DMS Pro eine Einladung senden oder eine Anfrage auf Aufnahme in Ihre Klinik stellen.

Der Patient muss bereits über ein Eversense DMS-Konto verfügen. Nur Eversense CGM-Benutzer können zu Ihrer Eversense DMS Pro-Patientenliste hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu, wie ein Patient ein persönliches Eversense DMS-Konto erstellen kann, finden Sie unter **global.eversenseddiabetes.com**, sehen Sie sich dort das Eversense DMS-Benutzerhandbuch an.

Sobald der Patient ein persönliches Konto erstellt hat, können Sie ihm eine Einladung schicken, oder er kann eine Anfrage auf Aufnahme in Ihre Klinik senden.

So senden Sie eine Patienteneinladung:

1. Klicken Sie auf Patienten .
2. Klicken Sie auf Patienten einladen .
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die der Benutzer bei der Registrierung seines Eversense-Kontos verwendet hat.

Hinweis: Eine Einladung kann nicht gesendet werden, wenn die E-Mail nicht bei Eversense DMS registriert ist.




Das Bild zeigt den oberen Teil des 'Patienten einladen' Formulars. Ein Textfeld für die E-Mail-Adresse enthält den Platzhalter 'Beispiel@email.com'. Darunter befindet sich ein blauer Button 'In Eversense suchen'. Am unteren Rand des Formulars sind zwei weitere Buttons: 'Senden' (blau) und 'Zurücksetzen' (grau).




4. Klicken Sie auf „In Eversense suchen“, um zu bestätigen, dass die E-Mail-Adresse bei Eversense registriert wurde.
5. Wenn die E-Mail registriert wurde, werden Sie aufgefordert, die Patientendaten einzugeben.
 - a. Eine MRN eingeben (optional)
 - b. Einen Anbieter in Ihrer Klinik für diesen Patienten auswählen
 - c. Den Vor- oder Nachnamen eingeben
 - d. Geburtstag eingeben (optional)
 - e. Ein Geschlecht eingeben (optional)

6. Klicken Sie nach Fertigstellung auf „Senden“.

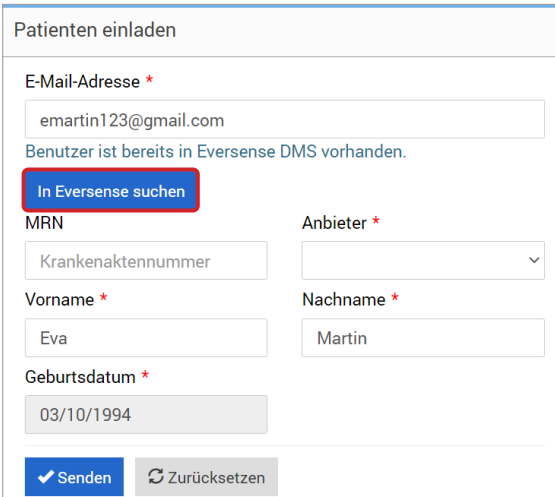Es wird per E-Mail eine Einladung an den Patienten gesendet.



Das Bild zeigt das 'Patienten einladen' Formular mit ausgefüllten Daten. Das E-Mail-Feld enthält 'emartin123@gmail.com'. Ein blauer Button 'In Eversense suchen' ist hervorgehoben. Darunter sind Felder für MRN (Krankenaktennummer), Anbieter (Auswahlliste), Vorname (Eva) und Nachname (Martin). Ein Geburtsdatum-Feld zeigt '03/10/1994'. Am unteren Rand befinden sich die Buttons 'Senden' (blau) und 'Zurücksetzen' (grau). Ein blauer Text unter dem E-Mail-Feld lautet: 'Benutzer ist bereits in Eversense DMS vorhanden.'

7. Sie werden gefragt, ob Sie eine weitere Einladung senden möchten. Wenn Sie auf Nein klicken, kehren Sie zum Bildschirm Patientenliste zurück, wo Sie den Patienten sehen können, den Sie gerade eingeladen haben.
8. Bis der Patient die Einladung akzeptiert hat, wird das Bild  in der Spalte Datenaustausch angezeigt.
9. Sobald Sie die Einladung akzeptiert haben, wechselt  zu , und Sie können jetzt auf den Namen klicken, um Ihre Eversense DMS-Daten anzuzeigen.


Liste der Patienten

Der Datensatz wurde erfolgreich aktualisiert.

Q  Deaktivierte Patienten anzeigen Patienten nach Anbieter Daten exportieren

Nachname des Patient	Vorname des Patienten	MRN	Geschlecht	DOB	Anbietername	Status	Datenaustausch		Abbestellen
Garcia	Jean		Weiblich	07 Okt 2000	Jon Johnson	Aktiv			
Martin	Paul		Männlich	01 Jun 1967	Laura Yankov	Aktiv			
Muller	Ingrid		Weiblich	01 Dez 1980	Jon Johnson	Aktiv			

Akzeptieren einer Patientenanfrage

Ein Patient kann eine Anfrage auf Aufnahme in Ihre Klinik von seinem persönlichen Eversense DMS-Konto aus senden, wenn Sie ihm die Eversense DM Pro-Kliniknummer mitgeteilt haben. Er kann die Kliniknummer eingeben, um Ihnen eine Anfrage auf der Seite Datenaustausch seines DMS-Kontos zu senden. Klicken Sie auf , um eine Liste ausstehender Anfragen zu anzeigen.

So akzeptieren Sie eine Patientenanfrage:

1. Klicken Sie auf Patienten .

2. Klicken Sie auf Ausstehende Anfragen.

Neben Ausstehende Anfragen wird eine Zahl angezeigt. Diese Nummer zeigt Ihnen, wie viele Anfragen sich derzeit in der Liste befinden. Wenn keine Nummer vorhanden ist, gibt es keine ausstehenden Anfragen.




Liste der ausstehenden Patienten

Q Ausstehenden Patienten s Daten exportieren

Nachname des Patient	Vorname des Patienten	MRN	Geschlecht	DOB	Anbietername	Status	
Green	George		Männlich	03 Mrz 2004	John Smith	Ausstehend	Annehmen Ablehnen

1 Insgesamt << < 1 > >>

3. Klicken Sie auf „Annehmen“, um den Patienten zu Ihrer Klinik hinzuzufügen.



- Wenn Sie auf Annehmen klicken, werden Sie aufgefordert, den Patienten einem Anbieter Ihrer Klinik zuzuweisen.
- Wenn Sie auf Ablehnen klicken, wird die Anfrage entfernt, und der Patient wird nicht in die Klinikliste aufgenommen.

Der Eversense CGM-Benutzer wird per E-Mail informiert, wenn Sie die Anfrage akzeptieren oder ablehnen.

Bearbeiten

Die Berechtigung **Bearbeiten** ermöglicht es Ihnen, die Daten eines Patienten in DMS Pro einzusehen und zu bearbeiten sowie einen Patienten aus der Eversense DMS Pro Klinikliste abzumelden. Jegliche in DMS Pro vorgenommene Änderungen führen nicht dazu, dass die Informationen, die der Patient auf seinem persönlichen Konto gespeichert hat, verändert werden.

3

So bearbeiten Sie die Daten eines Patienten:

1. Klicken Sie auf Patienten .
2. Klicken Sie auf .
3. Daraufhin wird ein Fenster mit Ihren Informationen angezeigt.

Sie können alle Daten außer der E-Mail-Adresse bearbeiten.

Klinikpatienten bearbeiten ✕



E-Mail-Adresse *

MRN Anbieter *

Nachname * Vorname *

Geburtsdatum *

So melden Sie einen Patienten von der Klinik ab:

1. Klicken Sie auf Patienten .
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf „Ja“.

Der Patient wird jetzt aus der DMS Pro-Klinikliste entfernt und seine Eversense-Daten können nicht mehr angezeigt werden.

Mit der Berechtigung Bearbeiten können Sie auch ausstehende Anfragen von Patienten akzeptieren, die in die Klinik aufgenommen werden möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *So akzeptieren Sie eine Patientenanfrage*.

Administrator


Die **Administrator**-Berechtigung bietet Ihnen die gleichen Berechtigungen wie **Anzeigen**, **Hinzufügen** und **Bearbeiten**. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, Mitarbeiter hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Weitere Informationen zu den **Administrator**-Berechtigungen finden Sie unter *Eversense DMS Pro-Administrator*.

4. DMS-Dashboard

Anzeigen von Eversense DMS-Daten eines Patienten

Wenn ein Patient zu Ihrer Klinik hinzugefügt wird, können Sie auf seinen Namen klicken, um eine Startseite zu öffnen, auf der die Eversense DMS-Daten angezeigt werden. Diese Seite ist fast identisch damit, was der Patient sieht, wenn er sich bei seinem persönlichen Eversense DMS-Konto anmeldet.

4

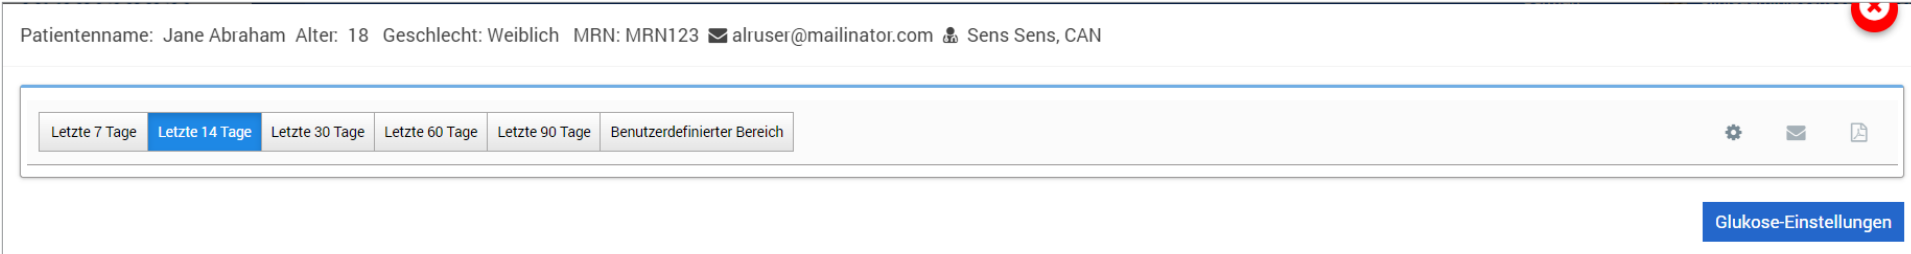

The screenshot shows a patient profile header with the following information: Patientenname: Jane Abraham, Alter: 18, Geschlecht: Weiblich, MRN: MRN123, Email: alruser@mailinator.com, and Health Provider: Sens Sens, CAN. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Letzte 7 Tage', 'Letzte 14 Tage' (which is selected and highlighted in blue), 'Letzte 30 Tage', 'Letzte 60 Tage', 'Letzte 90 Tage', and 'Benutzerdefinierter Bereich'. To the right of the tabs are icons for settings, email, and a document. At the bottom right of the dashboard area is a blue button labeled 'Glukose-Einstellungen'. A red 'X' icon in a circle is visible in the top right corner of the window frame.

WICHTIG: Jegliche Änderungen an Einstellungen oder Datumsbereichen in DMS Pro beeinträchtigen nicht die Einstellungen der Patienten, des Eversense DMS-Kontos oder der Eversense Mobilgeräte-App.

Oben auf der Startseite wird der Name, das Alter, das Geschlecht, MRN, die E-Mail-Adresse und der zugewiesene Gesundheitsanbieter angezeigt.

Sie können diese Seite verlassen, indem Sie im Fenster oben rechts auf  oder auf Schließen unten rechts im Fenster klicken.

Die Startseite enthält mehrere Abschnitte:

- Datenbereichs-Selektor
- Eversense-Tragezeit
- Ambulantes Glukoseprofil (AGP)
- Berichte
- Systemdaten
- Abkürzungen für das Drucken oder Mailen

Bis der Patient Sensor-Glukosedaten von der Eversense Mobilgeräte-App oder dem SmartTransmitter hochgeladen hat, werden keine Daten angezeigt.


WICHTIG: Wenn der Patient Autosync aktiviert hat, werden die Daten automatisch von der Mobilgeräte-App auf das DMS hochgeladen. Patienten können die Glukosedaten auch manuell vom SmartTransmitter per USB-Kabel hochladen. Weitere Informationen zum Datenupload finden Sie unter eversenseddiabetes.com, um das Eversense DMS-Benutzerhandbuch anzuzeigen.

Einstellen des Datumbereichs

Oben auf der Startseite finden Sie Berichte, die auf einem vorab festgelegten Datumsbereich basieren, oder einem benutzerdefinierten Datumsbereich, den Sie festgelegt haben.

So passen Sie die Einstellungen für den Datumsbereich an:



1. Wenn Sie einen Datensatz anzeigen möchten, der sich nicht innerhalb eines der vordefinierten Datumsbereiche befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierter Bereich“, um einen Dropdown-Kalender anzuzeigen.



Daraufhin wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie Ihren benutzerdefinierten Datumsbereich auswählen können.

Hinweis: Die über DMS Pro zugänglichen Daten reichen bis zu einem Jahr zurück.

2. Wählen Sie das *Startdatum* des gewünschten Berichts.
3. Wählen Sie das *Enddatum* des gewünschten Berichts.
4. Klicken Sie nach der Fertigstellung auf „OK“.

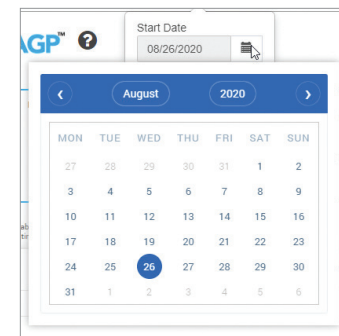


Eversense DMS-Dashboard

Das Eversense DMS Dashboard ist die Standardseite, die Ihrem Patient immer angezeigt wird, wenn sich der Patient beim DMS anmeldet. Auf dieser Seite sind die Eversense-Tragezeit, Captur AGP-Berichte und Systeminformationen des Patienten zu finden.

Eversense-Tragezeit

Die Eversense-Tragezeit ist die Zeit in Prozent, die der SmartTransmitter innerhalb des vom Patienten ausgewählten Datumsbereichs getragen wurde. 100 % entspricht 23,5 Stunden der täglichen SmartTransmitter-Tragezeit. Der Prozentwert umfasst nicht die Zeiten, in denen der Glukosewert nicht angezeigt wird. Beispiel: am Anfang der Initialisierungsphase oder wenn eine Warnung aktiviert wird, die verhindert, dass die Glukose angezeigt wird.

 Eversense-Tragezeit
44,57 %

Systemdaten: Oben auf dem AGP Dashboard befindet sich der Abschnitt mit den Systemdaten.

In diesem Abschnitt werden


- die Transmitter-Seriennummer,
- die Sensor-Seriennummer und die
- Glukose-Einstellungen des Patienten angezeigt. Glukose-Einstellungen können sowohl im DMS als auch in der Eversense Mobilgeräte-App geändert werden (siehe *Einstellungen* für weitere Informationen).

Systemdaten	Glukose-Einstellungen		
Transmitter: 95364	Ziel	Niedrig: 75 mg/dL	Hoch: 120 mg/dL
Sensor: 58554	Warnung	Niedrig: 60 mg/dL	Hoch: 350 mg/dL

Captur AGP in Eversense DMS

Der Hauptbericht des Eversense DMS Dashboard ist der Bericht Captur AGP (Ambulatory Glucose Profile, Ambulantes Glukoseprofil). Der AGP-Bericht zeigt die Glukosedaten innerhalb der 3 Abschnitte des Berichts an.

4

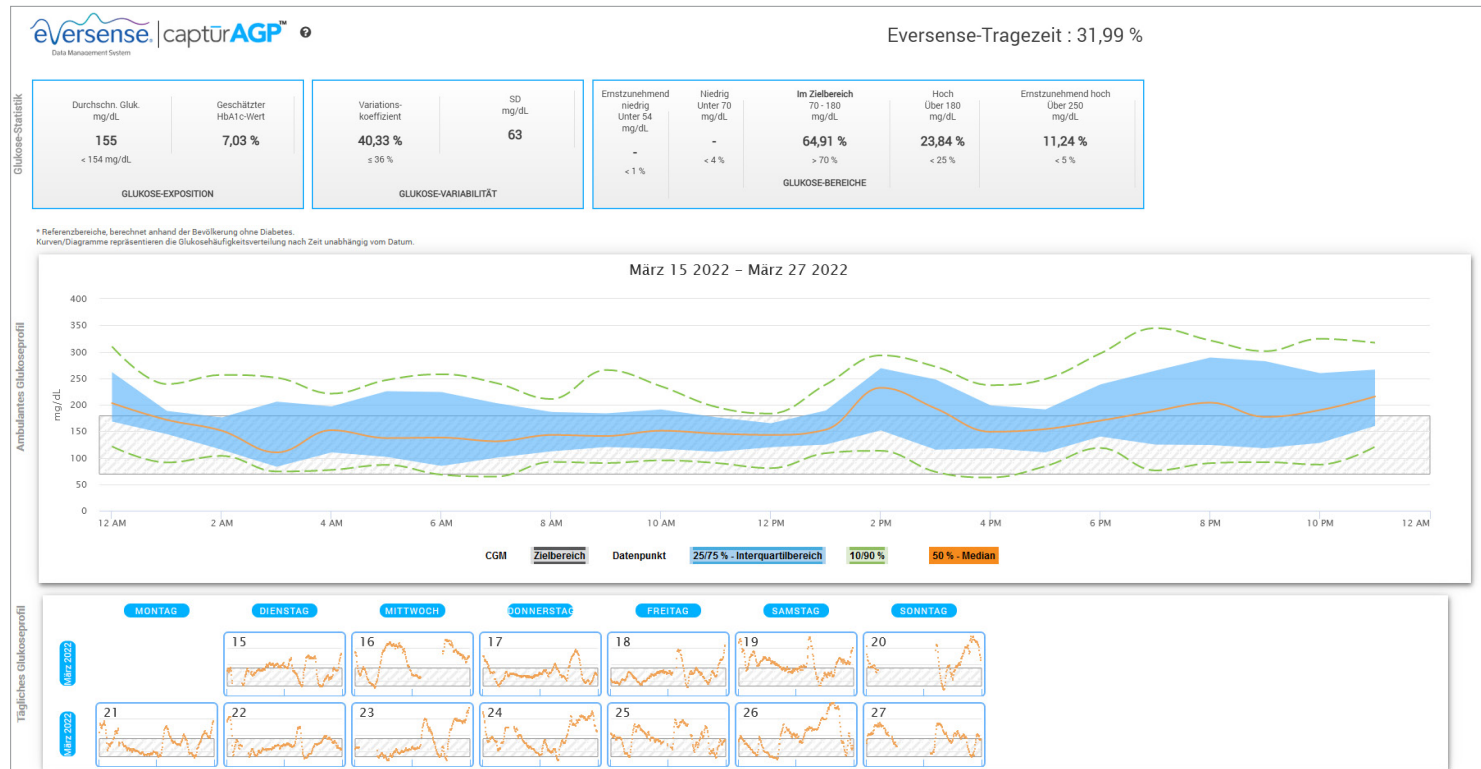

Glukose-Statistik: Metriken zu Ihren Glukosedaten

- Durchschn. Gluk. (Mittelwert): Alle Glukosewerte zusammen, geteilt durch die Anzahl der Messwerte
- Geschätzter HbA1c-Wert: Berechnet aus den AGP-Glukosewerten; kann aufgrund unterschiedlicher Zeiträume von einem Labor-A1c-Wert abweichen
- Glukosebereiche: Im Idealfall liegen die Glukosewerte im Zielbereich
 - Niedrig/Sehr niedrig: Ziel – keine sehr niedrigen oder niedrigen Werte; bei weniger niedrigen Werten fühlen Sie sich besser
 - Hoch/Sehr hoch: Ziel – keine sehr hohen oder hohen Werte; bei weniger hohen Werten nimmt mit der Zeit auch Ihr A1c-Wert ab
- SD (Standardabweichung, SA): Wie viel Variation sich im Datensatz befindet; ideal eine niedrige Zahl
- CV (Variationskoeffizient, VK): Abstand der Werte zum durchschnittlichen Wert; idealerweise eine niedrige Zahl





Glukoseprofile: Tägliche Glukoseprofile werden zu einem eintägigen (24 Stunden) Gesamtbild zusammengefasst. Idealerweise bleiben die Linien innerhalb des grau hinterlegten Bereichs (Zielbereich). Die Linien sind vielleicht nicht komplett durchgezogen, da der Patient seine Werte wahrscheinlich nicht jede Stunde im Tagesverlauf testet.

Orange: Median (mittlere) Linie, auf der sich die Hälfte der Glukosewerte über und die anderen Hälfte darunter befinden; idealerweise ist die orangefarbene Linie meistens flach und befindet sich innerhalb des grau schattierten Bereichs.

Blau: Bereich zwischen blauen Linien zeigt 50 % der Glukosewerte; im Idealfall ist der Abstand dazwischen schmal

Grün: 10 % der Werte befinden sich über (90 % obere Linie) und 10 % unter (10 % untere Linie); idealerweise ist es desto besser, je näher sich die grünen Linien dem grau schattierten Bereich nähern

Tägliche Glukoseprofile: Jedes Feld enthält ein Glukosemuster für einen einzelnen Tag. Es wird nur angezeigt, wenn der Datumsbereich auf 14 Tage oder weniger gestellt ist.



5. Berichte

Berichte bieten verschiedene Wege, Glukosewerte über die Zeit zu organisieren oder zu visualisieren.



Hinweis: Wenn Sie einen Bericht auswählen und keine Daten angezeigt werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Datumsbereich ausgewählt haben, in dem Daten verfügbar sind.

WICHTIG: Wenn Autosync nicht eingeschaltet ist, werden Daten von der Eversense Mobilgeräte-App nicht automatisch an das DMS gesendet.

Drucken oder Mailen, was in den Berichten angezeigt wird

Oben rechts auf der Startseite befinden sich Optionen für das Drucken und Mailen der Startseiten-Berichte.



Klicken			
für	Berichtstypen	E-Mail-Bericht	Bericht als PDF speichern
Wie	Wählen Sie aus, welchen Bericht Sie drucken oder mailen möchten.	Folgen Sie den Popup-Fenstern für das Mailen eines druckerfreundlichen Berichts an einen bestimmten Empfänger.	Klicken Sie auf das Symbol, um einen Bericht in eine PDF zu konvertieren, mit der Sie den Bericht drucken können.

Berichtsoptionen


Um die verschiedenen Berichtsoptionen anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Berichts im Berichtsbereich auf der Startseite.

Hinweis: Wenn Sie einen Bericht wählen und keine Daten angezeigt werden, überprüfen Sie Folgendes:

- Erweitern Sie den Datumsbereich, den Sie ausgewählt haben. Wenn es im gesamten Datumsbereich der letzten 90 Tage keine Daten gibt, kann es sein, dass der Patient in der Eversense CGM Mobilgeräte App die Autosynchronisierungsfunktion nicht eingeschaltet hat. Wenn Autosync nicht eingeschaltet ist, bitten Sie den Patienten, Autosync einzuschalten.
- Bitten Sie den Patienten, durch Antippen von „**Synchronisierung starten**“ in seiner Eversense CGM Mobilgeräte-App einen manuellen Upload durchzuführen.

5

The screenshot shows a user interface for selecting reports. At the top left, there is a blue button labeled "Zeit im Bereich" with a downward arrow. At the top right, the word "Berichte" is displayed. Below this, there are two input fields for date ranges, both containing "Mrz 16 2022 - Mrz 29 2022". The first field is labeled "Zeit im Bereich" and the second is labeled "Zeit im Bereich nach Tageszeit". To the right of the second field is a dropdown menu showing "6 Stund" with a downward arrow.

Einige Berichte können so gefiltert werden, dass sie bestimmte Informationen anzeigen. Sie können auswählen, welche Ereignistypen, Tage der Woche und andere Optionen in den Berichten angezeigt werden, indem Sie auf  neben dem Berichtsnamen klicken.

Dieser Filter nicht für die Berichte AGP, Zeit im Bereich nach Tageszeit oder Zeit im Zielbereich verfügbar.

The screenshot shows a blue button labeled "Glukose-Verlauf" with a downward arrow and a small grey triangle icon to its right.

Zeit im Zielbereich


Der Bericht Zeit im Zielbereich zeigt ein Tortendiagramm, das den Prozentwert der Zeit analysiert, in der die Glukose des Patienten unterhalb, innerhalb oder oberhalb des Zielbereichs liegt, die der Patient in den Glukose-Einstellungen festgelegt hat.

Patientenbericht anzeigen:

Der grüne Keil stellt den Prozentwert der Zeit dar, in der sich der Patient im Zielbereich befunden hat.

Der graue Keil stellt den Prozentwert der Zeit an, in der sich der Patient oberhalb des Zielbereichs befunden hat.

Der rote Keil zeigt den Prozentwert der Zeit an, in der sich der Patient unterhalb des Zielbereichs befunden hat.



Zeit im Bereich

Zeit im Bereich nach Tageszeit


Der Bericht Zeit im Bereich nach Tageszeit zeigt eine Reihe von Balkendiagrammen an, die den Prozentwert der Zeit analysieren, in der die Glukose des Patienten innerhalb der voreingestellten Glukose-Bereiche liegt.

- Sehr niedrig: < 54 mg/dl oder <3,0 mmol/l
- Niedrig: 54–70 mg/dl oder 3,0–3,9 mmol/l
- Innerhalb des Bereichs: 70–180 mg/dl oder 3,9–10,0 mmol/l
- Hoch: 180–250 mg/dl oder 10,0–13,9 mmol/l
- Sehr hoch: > 250 mg/dl oder >13,9 mmol/l

Es gibt zwei Abschnitte in diesem Bericht:

Zeit im Bereich


Anzeige der Zeit des Patienten in Prozent, die er in den voreingestellten Glukosebereichen verbracht hat.



Zeit im Bereich nach Tageszeit

In diesem Abschnitt des Berichts wird die Gesamtzeit in der Tabelle Zeit im Bereich in verschiedene segmentierte Tageszeiten aufgeteilt. Sie können die Daten Ihres Patienten in den Segmenten 4 Stunden, 6 Stunden oder 8 Stunden anzeigen. Dies wird durch Auswahl einer Option oben rechts im Bericht angepasst.

Jedes Segment zeigt die Zeit in Prozent an, in der die Glukose des Patienten in den gleichen Segmenten Sehr niedrig, Niedrig, Innerhalb des Bereichs, Hoch und Sehr hoch lag.





Bericht Glukosevariabilität

Der Bericht Glukosevariabilität zeigt Informationen auf zwei verschiedene Arten an:

Als Glukose-Trendkurve:

- Zeigt die zusammenfassenden Glukosewerte über einen 24-Stunden-Zeitraum an
- Umfasst Daten von mehreren Tagen, die auf der gleichen Grafik übereinander liegen
- Zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Glukosewerte für jede Stunde an
- Bietet eine visuelle Momentaufnahme von Schwankungen der täglichen Glukosewerte Ihres Patienten

Hinweis: Platzieren Sie den Cursor über einem bestimmten durchschnittlichen Sensor-Messwert, um die Details über die Messwerte während der Stunden anzuzeigen.



Als Tabelle:

- Organisiert die Glukosedaten in vierstündigen Zeitabschnitten
- Bietet eine detaillierte statistische Analyse für jeden Zeitraum
- Umfasst den Prozentwert der Messwerte, die sich innerhalb, innerhalb und oberhalb des Glukose-Zielbereichs befinden
- Zeigt eine Aufstellung der Insulinnutzung und Kohlenhydrate für diese gleichen Zeitperioden

Hinweis: Wenn Sie Probleme haben, den Bericht anzuzeigen, versuchen Sie den Datumsbereich zu begrenzen. Ungewöhnlich große Mengen an Daten, die dazu führen, dass der Bericht unter Umständen nicht funktioniert.

Glukose

Glukose	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00
% unter Niedrig-Warnwert	-	-	-
% über Hoch-Warnwert	-	-	-
Anzahl der Messwerte unter dem Niedrig-Warnwert	-	-	-
Anzahl der Messwerte über dem Hoch-Warnwert	-	-	-
% innerhalb Zielbereich	100 %	100 %	100 %
% unter Zielwert	-	-	-
% über Zielwert	-	-	-
Durchschnittliche Glukose	102 mg/dL	103 mg/dL	103 mg/dL
Niedrigster Glukosewert	88 mg/dL	89 mg/dL	76 mg/dL
Höchster Glukosewert	114 mg/dL	119 mg/dL	133 mg/dL
Standardabweichung	5.3 mg/dL	6 mg/dL	6 mg/dL
Anzahl der Messwerte innerhalb von 10–90 Perzentil	239	157	216
Gesamtanzahl der Glukosewerte	290	187	262
Anzahl der Tage mit mindestens einem Messwert	7	5	7
Durchschnittliche Anzahl an Messwerten pro Tag	41	37	37

Bericht Glukose-Trend


Der Bericht Glukose-Trend:

- Zeigt die zusammenfassenden Glukosewerte über einen 24-Stunden-Zeitraum an
- Zeigt mehrere Datentage an, die auf der gleichen Grafik übereinander liegen
- Bietet eine einfache Möglichkeit, die Variabilität unter den Wochentage zu bestimmen

Anzeigen des Berichts

Datenpunkte im Bericht sind farbkodiert, wobei jeder Wochentag eine andere Farbe hat. Sie können den Berichtsfilter verwenden, um die Tage anzuzeigen, die Sie auf der Grafik anzeigen möchten.

Hinweis: Platzieren Sie den Cursor über einem Sensormesswert, um Details zu diesem Messwert anzuzeigen.




Bericht Glukoseverlauf

Der Bericht Glukoseverlauf zeigt die historischen CGM- und manuell eingegebenen Daten in Form einer Trendgrafik an. Der Bericht Glukoseverlauf bietet eine effiziente Möglichkeit, die Sensor-Glukosemesswerte und Kalibrierungen anzuzeigen.

Anzeigen des Berichts

Jeder Datenpunkt ist ein Sensor-Glukosemesswert. Die Ereignisse, die vom Patienten in der Mobilgeräte-App protokolliert sind, werden im Bericht zum Zeitpunkt der Protokollierung angezeigt. Wenn Sie einen Datumsbereich von über 30 Tagen auswählen, werden Ereignisse wie Mahlzeiten, Insulin usw. nicht angezeigt.

Hinweis: Platzieren Sie den Cursor über einem Sensormesswert, um Details zu diesem Messwert anzuzeigen. Sie können den Cursor auch über ein Ereignissymbol platzieren, um damit Details über dieses Ereignis anzuzeigen.



Täglicher Glukosebericht


Der tägliche Glukosebericht zeigt den Verlauf Ihrer Glukosewerte jeweils über einen Zeitraum von 24 Stunden für mehrere aufeinanderfolgende Tage an.

Der tägliche Glukosebericht:

- Hat einen festen Glukose-Zielbereich von 70–180 mg/dl (3,9–10,0 mmol/l).
- Zeigt die vom CGM-Benutzer eingestellten oberen und unteren Glukose-Warnwerte (rote Linien) an.
- Zeigt die wichtigsten Statistiken für jeden Tag an, basierend auf dem Glukoseziel und den Warneinstellungen.
- Enthält eine Option zur Anzeige von Ereignissymbolen im Trenddiagramm und zur Erweiterung einer Ereignistabelle für jeden Tag.

Anzeigen des Berichts

Der tägliche Glukosebericht zeigt mehrere Tage in Folge für den ausgewählten Datumsbereich an und bietet eine Möglichkeit, Trends im Glukoseverlauf über mehrere Tage hinweg zu erkennen. Die Statistiken für jeden Tag werden rechts neben dem Trenddiagramm angezeigt und basieren auf dem Standard-Glukosezielbereich von 70–180 mg/dl (3,9–10,0 mmol/l) und den vom Patienten eingestellten oberen und sonstigen Glukosewarnwerten. Um zusätzliche CGM-Informationen für jeden Tag einzusehen (Warnungen, Kalibrierungen, Ereignisse, die Sie in die CGM-App eingegeben haben), können Sie die Anzeige der Ereignissymbole im Trenddiagramm einschalten und die Ereignistabelle unter dem Trenddiagramm erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen. Die erweiterte Ereignistabelle enthält Informationen in 4-Stunden-Schritten, die mit den 4-Stunden-Segmenten im Trenddiagramm übereinstimmen.

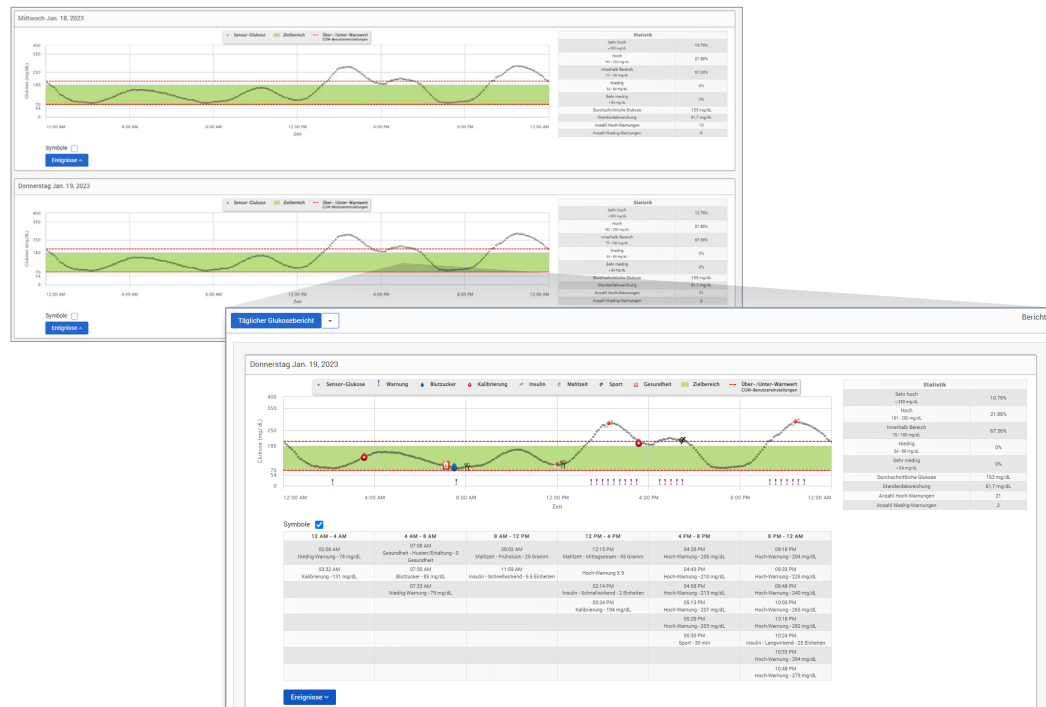

Statistik:

Die Statistiktafel bietet eine Analyse des Prozentsatzes der Zeit, in der der Glukosespiegel Ihres Patienten innerhalb der voreingestellten Glukosebereiche liegt.


- Sehr niedrig: <54 mg/dl oder <3,0 mmol/l
- Niedrig: 54–70 mg/dl oder 3,0–3,9 mmol/l
- Innerhalb des Normalbereichs: 70–180 mg/dl oder 3,9–10,0 mmol/l
- Hoch: 180–250 mg/dl oder 10,0–13,9 mmol/l
- Sehr hoch: >250 mg/dl oder >13,9 mmol/l

Der Tagesdurchschnitt des Glukosespiegels, die Standardabweichung und die Anzahl der Hoch- und Niedrigwarnungen sind ebenfalls enthalten.

Symbole und Ereignisse:

Die Symbole und Ereignisse werden auf der Grundlage der Glukosewarnungseinstellungen Ihres Patienten, der Kalibrierungen und aller in deren CGM-App eingegebenen Ereignisse angezeigt.

Hinweis: Falls gewünscht, können Sie die CGM-Warneinstellungen für den Bericht in DMS Pro anpassen. (Die Glukosezeleinstellungen sind auf 70–180 mg/dl (3,9–10,0 mmol/l) festgelegt und können nicht geändert werden.) Wenn Sie die Einstellungen für die Glukosewarnung anpassen, ändert sich die Platzierung der roten Warnlinien in den täglichen CGM-Trenddiagrammen, nicht aber in den täglichen Statistiken. Dies kann bei der Entscheidung über die optimale Einstellung für eine Warnung bei hoher oder niedriger Glukose helfen.

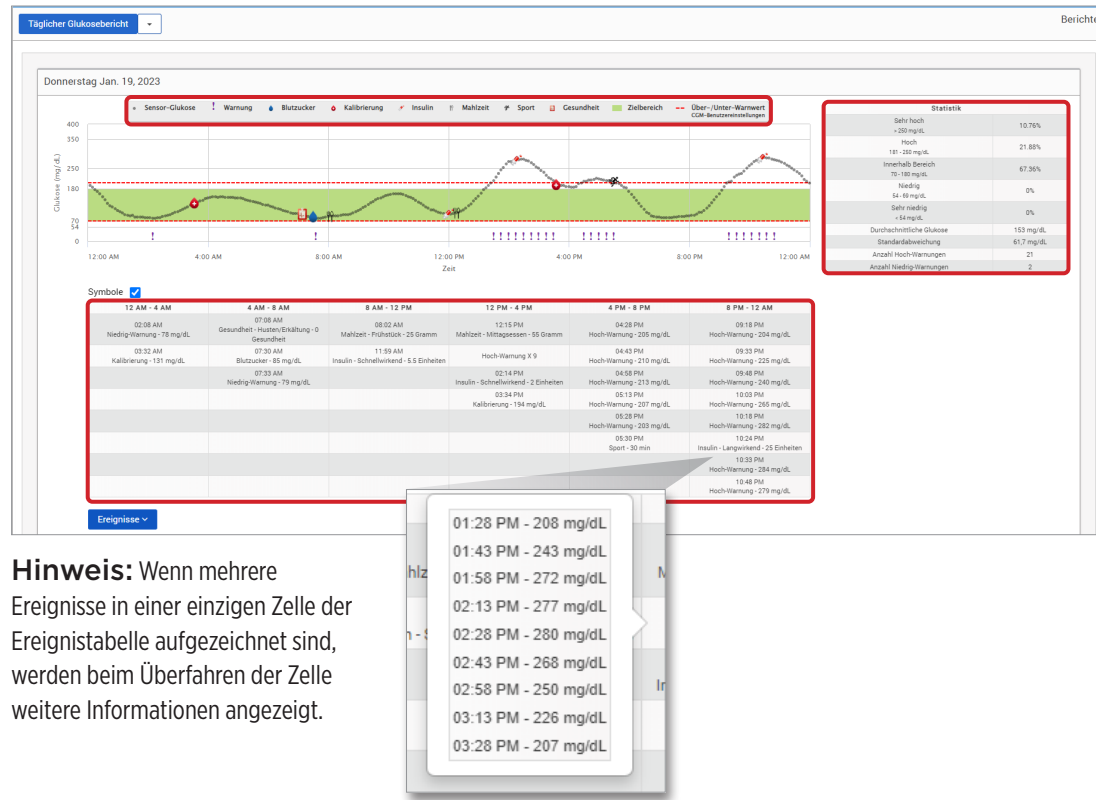

Hinweis: Wenn mehrere Ereignisse in einer einzigen Zelle der Ereignistabelle aufgezeichnet sind, werden beim Überfahren der Zelle weitere Informationen angezeigt.


Bericht Glukoseverteilung

Der Bericht Glukoseverteilung:

- Organisiert die Glukosedaten Ihres Patienten gemäß Ihrer Glukoseziele und Warnbereiche und zeigt die Daten in einem Tortendiagramm an
- Zeigt verschiedene Torgendiagramme für die aktuellen und vergangenen Zeiträume an
- Zielbereiche werden unter den Glukose-Einstellungen festgelegt
- Bietet einen visuellen Check der Anzahl der Messwerte im Zielbereich während des vordefinierten ausgewählten Bereichs und der Änderung über die Zeit

Anzeigen des Berichts

Der Bericht Glukoseverteilung zeigt zwei Tortendiagramme an, die vom vordefinierten Datumsbereich abhängen, den Sie auswählen. Er zeigt aktuelle und frühere Datensätze für den ausgewählten Datumsbereich an. Mit diesen Daten können Sie einen Vergleich aktueller an vergangenen Änderungen der Behandlung Ihres Patienten anzeigen.

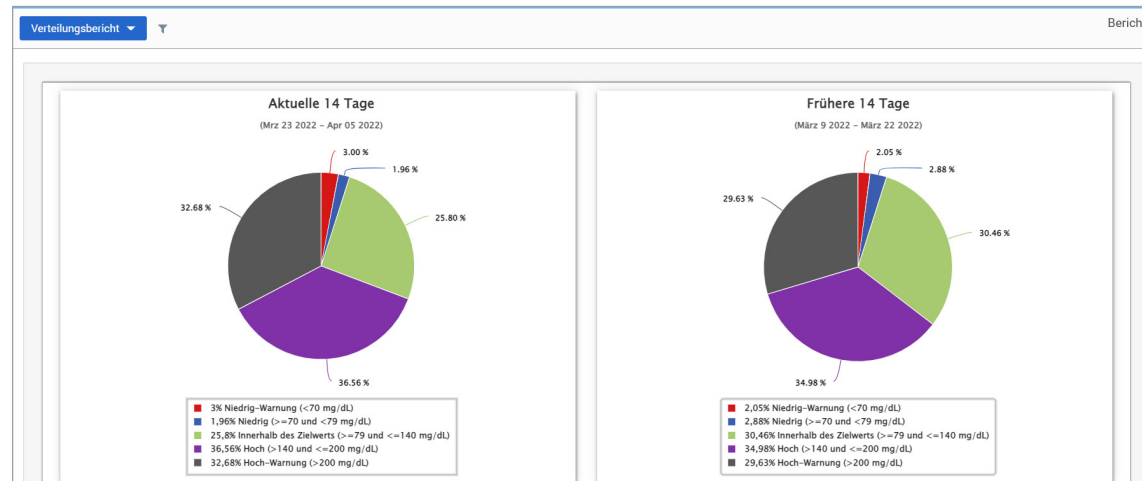

Bericht Transmitter-Protokoll

Der Bericht Transmitter-Protokoll bietet eine umfassende Datenüberprüfung über den ausgewählten Datumsbereich.

Der Bericht Transmitter-Protokoll zeigt drei verschiedene Tabellen an:

- **Blutzucker:** Für die Anzeige einer Listenansicht aller manuell eingegebenen Blutzucker- und zusammenhängender Ereignisse in chronologischer Reihenfolge
- **Ereignisanträge:** Für die Anzeige von Patientenergebnissen, die durch die Eversense Mobilgeräte-App eingegeben werden
- **Sensor-Glukose:** Für die Anzeige von Glukosewerten, die vom Sensor aufgenommen wurden




Anzeigen des Berichts


Ereignisse werden mit Informationen zu Datum, Zeit und:

- **Blutzucker:** Glukosewert, Einheit, Kalibrierung
- **Ereignisanträge:** Ereignistyp, Ereignisuntertyp, Wert
- **Sensor-Glukose:** Glukose-Wert, Einheit, Sensor-ID











Ereignisse können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge durch Anklicken sortiert werden. Die Anzahl der Datensätze ist unten in jedem Protokoll angezeigt.

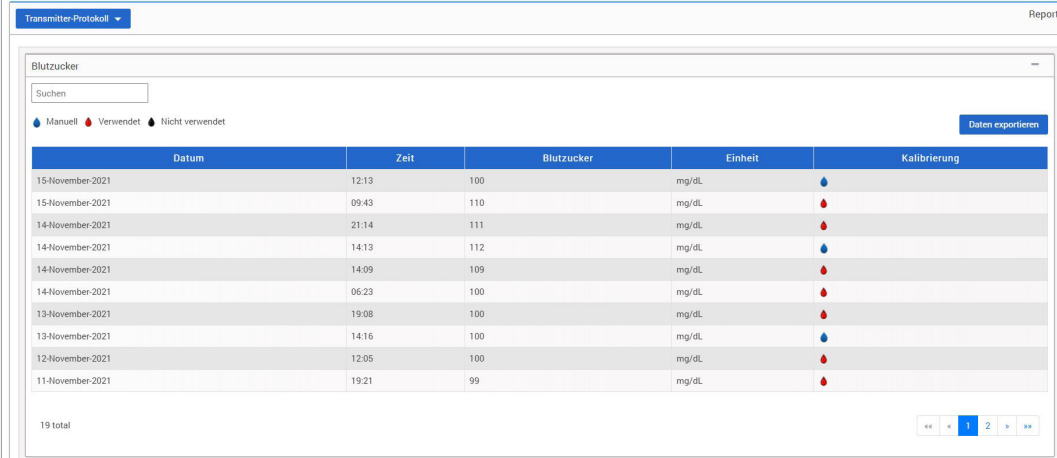Ein Symbol unter der Spalte „**Kalibrierung**“ der Tabelle Blutzucker zeigt an, ob ein Glukosewert für die Kalibrierung verwendet , nicht verwendet  oder manuell verwendet  wurde.

-  **Verwendet:** Ein Blutzuckerwert, der von Ihrem Patienten in die Eversense Mobilgeräte-App als Kalibrierung eingegeben wurde und vom System akzeptiert wird
-  **Nicht verwendet:** Eine Kalibrierung, die eingegeben wurde und über 400 mg/dl (22,2 mmol/l) oder unter 40 mg/dl (2,2 mmol/l) beträgt
-  **Manuell:** Ein Blutzuckerwert, der nicht als Kalibrierung eingegeben wurde



The screenshot shows a web interface for the 'Transmitter-Protokoll' report. It features a search bar, a legend for 'Manuell' (blue dot), 'Verwendet' (red dot), and 'Nicht verwendet' (black dot), and a 'Daten exportieren' button. The table below displays the following data:

Datum	Zeit	Blutzucker	Einheit	Kalibrierung
15-November-2021	12:13	100	mg/dL	
15-November-2021	09:43	110	mg/dL	
14-November-2021	21:14	111	mg/dL	
14-November-2021	14:13	112	mg/dL	
14-November-2021	14:09	109	mg/dL	
14-November-2021	06:23	100	mg/dL	
13-November-2021	19:08	100	mg/dL	
13-November-2021	14:16	100	mg/dL	
12-November-2021	12:05	100	mg/dL	
11-November-2021	19:21	99	mg/dL	

At the bottom of the table, it indicates '19 total' and includes a pagination control showing page 1 of 2.

Exportieren von Daten

Auf der Seite Bericht Transmitter-Protokoll können Sie Daten auch im .xlsx-Format exportieren.

1. Wählen Sie **Berichte > Transmitter-Protokoll** aus.
2. Wählen Sie in jeder Tabelle oben „**Daten exportieren**“ aus, um die Daten als .xlsx zu exportieren (Excel Spreadsheet).

Sensor-Glukose

[Daten exportieren](#)




DATUM	ZEIT	SENSOR-GLUKOSE	EINHEIT	SENSOR-ID
27-März-2022	23:59	170	mg/dL	262344
27-März-2022	23:54	175	mg/dL	262344




6. Einstellungen

Glukose

Glukose-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, das Glukose-Ziel und die Warnwerte in den Berichten anzupassen. Diese Einstellung beeinflusst, wie Glukose und andere Ereignisdaten organisiert und in Berichten angezeigt werden. Wenn der Patient seine Daten drahtlos über die Mobilgeräte-App synchronisiert, werden die auf der App gespeicherten Glukose-Einstellungen auf der App ebenfalls synchronisiert.

WICHTIG: Glukose-Einstellungen werden NICHT synchronisiert, wenn Daten vom SmartTransmitter über das USB-Kabel hochgeladen werden.

Patientenname: Nikole Copes Alter: NaN Geschlecht: Männlich MRN:  ous.e3@mailinator.com  Jahnvi Laherii, RD 

Letzte 7 Tage Letzte 14 Tage Letzte 30 Tage Letzte 60 Tage Letzte 90 Tage **Benutzerdefinierter Bereich**   

Glukose-Einstellungen

So ändern Sie die Einstellungen in der Ansicht Eversense DMS PRO:

1. Klicken Sie auf Glukosewerte, die oben auf dem Bildschirm angezeigt werden.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche mg/dl oder mmol/l unter der Maßeinheit, um die gewünschte Maßeinheit für die Anzeige der Glukosedaten auszuwählen.
Wenn Sie die Maßeinheit ändern, werden der Glukosebereich und der Warnbereich entsprechend geändert.
3. Klicken Sie auf die Schaltflächen +/- rechts vom oberen Zielbereich und vom unteren Zielbereich, um die oberen und unteren Grenzen Ihres Glukosezielbereichs anzuzeigen und anzupassen.
4. Die Schritte für den Glukosewarnbereich wiederholen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Diese Einstellungen werden für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie die Berichte dieses Patienten ansehen, auch wenn Sie sich aus DMS Pro abmelden. Eversense DMS Pro-Einstellungen beeinträchtigen die Eversense CGM System-Einstellungen oder die Eversense DMS-Anzeige nicht.

Glukose-Einstellungen ✕

Maßeinheit mg/dl mmol/l

Zielbereich (muss zwischen den Warneinstellungen liegen)	Warnbereich (muss zwischen 60 und 350)
Oberer Zielwert* <input type="text" value="219"/>	Hoch-Warnung* <input type="text" value="279"/>
Unterer Zielwert* <input type="text" value="70"/>	Niedrig-Warnung* <input type="text" value="64"/>


Erfolgreich aktualisiert

7. Hilfe

Über uns

Auf dieser Seite sind die aktuellsten Versionen des Eversense DMS Pro gezeigt.

WICHTIG: Wenn Sie Fragen zu Ihrem Eversense DMS Pro-Konto haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Wenden Sie sich in den USA an +844-SENSE4U (844-736-7348).

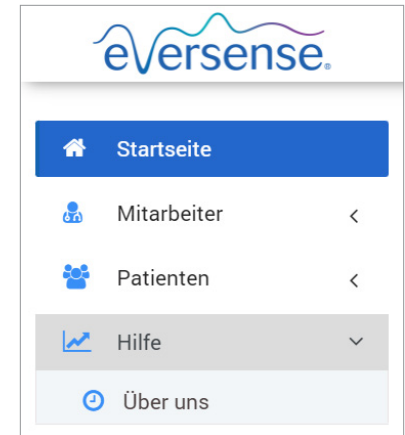

8. Fehlerbehebung

1. Meine vorherigen Filter werden nicht länger angewendet, wenn ich zurück zur Startseite oder Patientenseite wechsele.

- Filter werden nach Verlassen der Startseite oder der Registerkarte Patienten aktualisiert. Wenden Sie die Filter erneut an, um die gewünschte Patientenlisten anzuzeigen.

2. Wenn der einzige Klinik-Administrator seine Administratorberechtigungen aus Versehen löscht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

3. CGM-Benutzer in Deutschland können die Erstellung eines Eversense-Kontos ablehnen. Diese Benutzer können keine Daten mit dem Eversense DMS Pro teilen.



Manuale di istruzioni del sistema di gestione dei dati (DMS) Pro

Eversense e il logo Eversense sono marchi di Senseonics, Incorporated. Altri marchi e i loro prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Eversense DMS non contiene malware o virus informatici che potrebbero danneggiare il computer. Si raccomanda di utilizzare un programma firewall appropriato e un programma anti-virus sul proprio computer per prevenire malware e virus.

Per leggere l'informativa sulla privacy di Eversense, visitare il sito **global.eversenseddiabetes.com**.

Indice

Glossario.....	64	4. Dashboard DMS.....	87
I. Introduzione.....	65	Visualizzare i dati Eversense DMS del paziente	87
Usò previsto	65	Impostazione dell'intervallo di date	89
Contratto di licenza con l'utente finale e Regolamento sulla privacy	65	Dashboard Eversense DMS	90
Guida e assistenza	65	5. Report.....	94
2. Operazioni preliminari.....	66	Durata nel target	96
Registrare una clinica e creare un account amministratore	66	Durata nell'intervallo	97
Accesso a Eversense DMS Pro	68	Report variabilità glucosio	99
Amministratore Eversense DMS Pro	68	Report tendenza glucosio	101
Menu di navigazione	69	Report cronologia dei valori del glucosio	102
Utente Eversense DMS Pro del personale	74	Report glucosio giornaliero	103
Il profilo e il menu di navigazione	74	Report distribuzione glucosio	105
Profilo	75	Report registro trasmettitore	106
Password dimenticata	77	6. Impostazioni.....	109
Home page	78	Glucosio	109
3. Autorizzazioni.....	79	7. Guida.....	III
Vista	80	Informazioni	111
Aggiungi	82	8. Risoluzione dei problemi.....	II2
Modifica	85		
Amministratore	86		

Glossario

AutoSync Quando questa funzione è attivata nell'app mobile Eversense, i dati relativi al glucosio e le impostazioni glucosio verranno automaticamente sincronizzati con Eversense DMS ogni due ore.

App Eversense Programma software che viene installato su un dispositivo mobile e utilizzato per visualizzare i dati del monitoraggio del glucosio inviati dallo Smart Transmitter.

Calibrazione Lettura del valore glicemico tramite prelievo da polpastrello e immessa nell'app Eversense per verificare la precisione del sistema. Il sistema Eversense consta di due fasi: la fase di inizializzazione, durante la quale vanno eseguiti 4 test con prelievo da polpastrello, e la fase di calibrazione quotidiana, durante la quale si deve eseguire 1 test con prelievo da polpastrello due volte al giorno.

CGM Continuous Glucose Monitoring (Monitoraggio continuo del glucosio). Il monitoraggio continuo del glucosio eseguito sul liquido interstiziale ogni pochi minuti.

Controindicazione Condizione o circostanza in cui una persona non deve usare il dispositivo.

EULA End User License Agreement (Contratto di licenza con l'utente finale).

Eversense Client Application Applicazione desktop che permette agli utenti Eversense di caricare i dati del proprio Smart Transmitter al sistema di gestione dei dati utilizzando un cavo USB.

Glicemia Valore del glucosio ottenuto da un test con prelievo da polpastrello.

Glucometro Dispositivo disponibile in commercio che serve per misurare il glucosio tramite prelievo da polpastrello.

Glucosio rilevato dal sensore Il valore del glucosio ottenuto dal sensore Eversense.

Liquido interstiziale (LI) Liquido che si trova tra le cellule dell'organismo. CGM Eversense misura il glucosio da un campione di liquido interstiziale, a differenza dei dispositivi che misurano la glicemia tramite prelievo da polpastrello.

mg/dL Milligrammi per decilitro, unità di misura che mostra la concentrazione di una sostanza in una specifica quantità di liquido. In alcuni Paesi, compresi gli Stati Uniti, i risultati dei test del glucosio vengono espressi in mg/dL, che indicano quanto glucosio c'è nel sangue quando si usa un glucometro o quanto glucosio c'è nel liquido interstiziale quando si usano dei sistemi di monitoraggio continuo del glucosio come il CGM Eversense.

mmol/L Millimoli per litro, unità di misura che mostra la concentrazione di una sostanza in una specifica quantità di liquido. In molti Paesi, i risultati dei test del glucosio vengono espressi in mmol/L, che indicano quanto glucosio c'è nel sangue quando si usa un glucometro o quanto glucosio c'è nel liquido interstiziale quando si usano dei sistemi di monitoraggio continuo del glucosio come il CGM Eversense.

Sensore Dispositivo che viene inserito a livello sottocutaneo per misurare continuamente i livelli di glucosio del liquido interstiziale.

Glossario

Sistema di gestione dei dati (Data Management System, DMS) Eversense Applicazione web compatibile con l'app Eversense che consente all'utente di memorizzare e visualizzare i propri dati relativi al glucosio.

Smart Transmitter Dispositivo riutilizzabile che viene indossato esternamente sopra al sensore, alimenta il sensore e invia i dati relativi al glucosio al dispositivo mobile, che poi li mostra nell'app Eversense.

I. Introduzione

Uso previsto

Il sistema di gestione dei dati (DMS) Pro di Eversense è uno strumento per gli operatori sanitari, ideato per la gestione e la consultazione dei dati sul glucosio dei loro pazienti che utilizzano il sistema CGM Eversense.

Un elenco dei dispositivi e sistemi operativi compatibili è disponibile alla pagina web <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.

Contratto di licenza con l'utente finale e Regolamento sulla privacy

L'utilizzo dell'app Eversense DMS Pro è soggetto ai termini e alle condizioni delle versioni più recenti del Contratto di licenza Eversense con l'utente finale e dell'Informativa sulla privacy Eversense. Questi documenti vengono aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito global.eversenseddiabetes.com.

Guida e assistenza

Per ulteriori domande sui contenuti di questo Manuale di istruzioni per DMS Pro, contattare l'Assistenza Clienti al numero gratuito negli USA 844-SENSE4U (844-736-7348). Al di fuori degli Stati Uniti, contattare il proprio distributore locale o visitare il sito global.eversenseddiabetes.com per rintracciare il proprio distributore locale.

2. Operazioni preliminari

2

Registrare una clinica e creare un account amministratore

Per registrare la propria clinica, è necessario registrare anche un account amministratore della clinica. Per farlo, visitare globalpro.eversensedms.com. Dopo la registrazione, alla clinica verrà assegnato un numero di clinica che verrà utilizzato come identificativo dai pazienti per richiedere di unirsi alla clinica.

Per registrare la propria clinica e creare un account amministratore:

1. Visitare globalpro.eversensedms.com
2. Fare clic su “**Registrati**” sulla schermata di login

eversense®

Italian ▾

Ho bisogno di un account DMS Pro Eversense?

Registrati

Email *

sample@email.com

Password *

Password

* Campo obbligatorio

Registrazione

[Password dimenticata?](#)

Problema durante il login? [Contatti](#)

Per registrare in DMS Eversense il tuo Sistema CGM, fai clic [qui](#)

3. Compilare il modulo di registrazione

IMPORTANTE: Non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo e-mail come nome utente per Eversense DMS Pro e un account Eversense DMS personale.

4. Fare clic su “Invia”

Italian

Richiedi un account DMS Pro Eversense

Informazioni di contatto

Nome * Cognome * Titolo *

Nome Cognome Seleziona il titolo

E-mail * Conferma e-mail * Numero di telefono *

sample@email.com sample@email.com Numero di telefono

Nome dello studio o della struttura sanitaria * Paese *

Nome del professionista sanitario Seleziona il Paese

Riga indirizzo 1

Indirizzo 1

Riga indirizzo 2

Indirizzo 2

Città Stato CAP

Città Seleziona lo Stato CAP

Rivedi e conferma quanto segue prima di continuare

Accetta [Termini e condizioni d'uso](#)

Digita di nuovo il codice: *

2498

Invia

Hai già un account? [Vai a Registrazione](#)

Copyright © 2022 Senseonics® Tutti i diritti riservati.

5. Quando l'account della clinica e quello da amministratore saranno approvati, verrà inviato via email un link di attivazione. Il link scadrà dopo 72 ore.

6. Una volta cliccato il link per attivare l'account, verrà richiesto di creare la password personale per Eversense DMS Pro.

Dopo che è stata creata la password, è possibile accedere e visualizzare il proprio numero di clinica nella parte superiore dello schermo, accanto al nome della clinica.



Accesso a Eversense DMS Pro

Per accedere a Eversense DMS Pro, visitare globalpro.eversensedms.com. L'indirizzamento alla pagina di accesso avviene dopo che è stata selezionata la regione di riferimento.

Amministratore Eversense DMS Pro

Eversense DMS Pro richiede almeno un amministratore dell'account, che è in grado di:

- Registrare la clinica, che genera l'ID unico della clinica.
- Invitare altri membri del personale a unirsi al sito della clinica e impostare le loro autorizzazioni.
- Modificare le autorizzazioni dei membri del personale.
- Rimuovere i membri del personale dall'account dell'amministratore della clinica.
- Offrire assistenza per resettare la password di altri membri del personale.

Livelli di autorizzazione DMS Pro

In Eversense DMS Pro, esistono diverse autorizzazioni per gli utenti del personale della clinica. Le autorizzazioni sono **Amministratore**, **Vista**, **Modifica**, e **Aggiungi**. L'amministratore della clinica assegna le autorizzazioni agli altri utenti del personale della clinica.

- **Amministratore:** può visualizzare, modificare e aggiungere.
- **Vista:** permette all'utente del personale della clinica di visualizzare l'elenco dei pazienti accettati e di visualizzare i dati nell'account DMS di ciascun paziente.
- **Aggiungi:** darà all'utente del personale della clinica le stesse autorizzazioni della tipologia Vista, oltre all'abilità di accettare le richieste dei pazienti di unirsi alla clinica e di invitare i pazienti a unirsi alla clinica.
- **Modifica:** permette all'utente del personale della clinica di modificare le informazioni del paziente in DMS pro, annullare l'iscrizione del paziente dalla clinica e visualizzare i suoi dati Eversense DMS. Qualsiasi modifica fatta in DMS Pro non cambierà alcuna informazione salvata dal paziente nel suo account personale.

eversense®

Italian ▾

Ho bisogno di un account DMS Pro Eversense ?
[Registrati](#)

E-mail *

Password *


* Campo obbligatorio

[Registrazione](#)

[Password dimenticata?](#)

Problema durante il login? [Contatti](#)
 Per registrare in DMS Eversense il tuo Sistema CGM, fai clic [qui](#)


Menu di navigazione

Il menu di navigazione si trova in alto a sinistra sulla Home page. È possibile aprire e chiudere il menu di navigazione facendo clic su . Fare clic su qualsiasi pulsante del menu per passare a quella selezione.


Nota:

- È inoltre possibile selezionare la lingua preferita cliccando sull'icona della bandiera nell'angolo in alto a destra della pagina.
- Il menu di navigazione può avere un aspetto diverso a seconda dell'autorizzazione assegnata dall'amministratore della clinica.


Amministratore

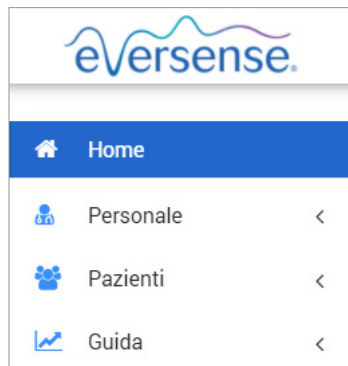


Vista



Aggiungi

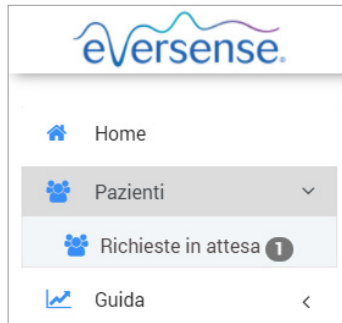


Modifica

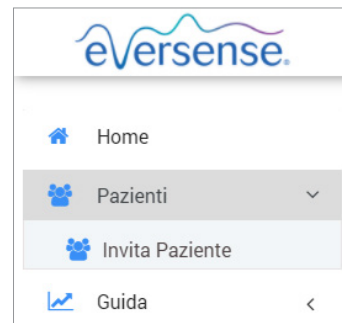


Per aggiungere membri del personale:

1. Fare clic su “Personale” nella barra di navigazione sinistra
2. Fare clic su “Aggiungi personale”
3. Inserire le informazioni di contatto e selezionare il titolo
4. Controllare e modificare le autorizzazioni secondo necessità
Possono essere assegnate autorizzazioni multiple.
5. Fare clic su “Invia”
6. Il personale della clinica riceverà l'invito via e-mail e dovrà fare clic sul link di verifica nell'e-mail per accedere utilizzando la password temporanea fornita nell'e-mail.
Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, verrà richiesto di creare una nuova password.





IMPORTANTE: Le autorizzazioni predefinite vengono assegnate in base al titolo selezionato. Se il titolo di un utente viene modificato, controllare le autorizzazioni e modificarle secondo necessità.



Per modificare le informazioni e autorizzazioni dei membri del personale:

1. Fare clic su **“Personale”** nella barra di navigazione sinistra
2. Fare clic su  per aprire la relativa pagina di informazioni
3. Da questa pagina è possibile:
 - a. Modificare il nome e/o il titolo
 - b. Aggiornare le autorizzazioni
4. Fare clic su **“Aggiorna”** quando si è finito

IMPORTANTE: Se il titolo di un utente viene modificato, controllare le autorizzazioni e modificarle secondo necessità.

Cognome	Nome	Titolo	E-mail	Stato		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Attivo		

Modifica personale clinica

Informazioni di contatto

Nome *

Cognome *


Titolo *

Attivo Non attivo

Autorizzazione *

<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizzazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Amministratore
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiungi
<input checked="" type="checkbox"/>	Modifica
<input checked="" type="checkbox"/>	Vista

Per disattivare gli account del personale della clinica:

1. Fare clic su “Personale” nella barra di navigazione sinistra
2. Fare clic su  per aprire la relativa pagina di informazioni
3. Scegliere Non attivo in fondo alla pagina

Quando un account non è attivo, il membro del personale della clinica non potrà più aggiungere, modificare o visualizzare gli account dei pazienti in DMS Pro.

Modifica personale clinica ✕

Informazioni di contatto

Nome *

Cognome *



Titolo *





Attivo Non attivo

Autorizzazione *

<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizzazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Amministratore
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiungi
<input checked="" type="checkbox"/>	Modifica
<input checked="" type="checkbox"/>	Vista

Offrire assistenza per resettare la password di membri del personale della clinica:

1. Fare clic su “Personale” nella barra di navigazione sinistra
2. Fare clic su 
Individuare il membro del personale della clinica e fare clic su .
3. Inserire la nuova password e confermarla
4. Fare clic su notifica all'utente se si desidera notificare il membro del personale via e-mail che la password è stata resettata
5. Fare clic su “Resetta password”

Cognome	Nome	Titolo	E-mail	Stato		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Attivo		

Resetta password del personale della clinica ✕

Nome utente

Jon Johnson

Nuova password

Nuova password

Conferma password

Conferma password

Notifica all'utente

Resetta password Annulla

Utente Eversense DMS Pro del personale

L'amministratore creerà l'account in Eversense DMS Pro. Verrà inviata una mail con una password temporanea e un link per attivare l'account e creare una password permanente. Fare clic sul link per completare la configurazione del tuo account e visualizzare la Home page. Una volta che l'account è attivato, è possibile visitare **globalpro.eversensedms.com** per accedere in qualsiasi momento.

Il profilo e il menu di navigazione

Dopo aver effettuato con successo l'accesso, verrà visualizzata la Home page.

- In alto a destra sulla pagina è possibile accedere alle informazioni del **Profilo**.
- In alto a sinistra sulla pagina è visibile un **Menu di navigazione**. Il menu di navigazione può avere un aspetto diverso a seconda dell'autorizzazione assegnata dall'amministratore della clinica.

The screenshot displays the Eversense DMS Pro interface. At the top left is the Eversense logo. A blue navigation menu is on the left, containing: Home, Personale, Pazienti, and Guida. The top right header shows 'Italian' and a user profile for 'jonj97329@gmail.com'. The main content area is for 'High Street Clinic' (ID clinica: 7322) and shows a 'Elenco dei pazienti' section with a search bar, a refresh button, and a checkbox for 'Mostra pazienti disattivati'. Below this is a table with columns for patient information and actions.

Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	Condividi dati	Annulla l'iscrizione
----------------------	-------------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-------	----------------	----------------------


Profilo

Situata in alto a destra della Home page, questa funzione permette di modificare il nome o la password, modificare il profilo utente o uscire da Eversense DMS Pro.


Modificare la password:

1. Fare clic sul nome utente

Apparirà un menu a tendina che mostra la foto del profilo, l'ultimo accesso e le opzioni per visualizzare/modificare il profilo o uscire.

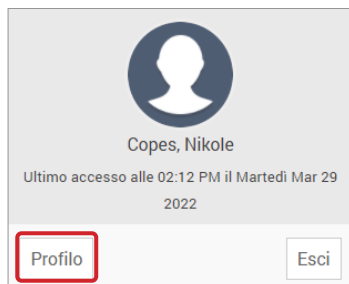

2. Fare clic su “Profilo” per accedere alle Impostazioni profilo utente.

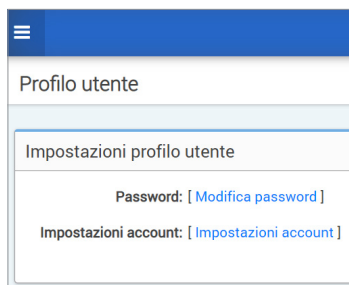

3. Fare clic su “Modifica password” per visualizzare e modificare la password corrente

4. Inserire la password corrente

5. Inserire e confermare la nuova password

6. Fare clic su “Modifica password” per salvare le modifiche

Per aggiornare le informazioni dell'account:

1. Fare clic su “Impostazioni account”

2. Inserire le informazioni che si desidera aggiornare

È possibile cambiare l'immagine del profilo premendo il pulsante **Scegli file** e scegliendo un'immagine dai file del computer.

3. Fare clic su “Salva” per salvare le modifiche

La pagina Impostazioni profilo utente apparirà di nuovo. Per tornare alla Home page, fare clic su “Home” in alto a sinistra nel pannello di navigazione. I pazienti che utilizzano Eversense DMS o gli utenti del personale della clinica che utilizzano Eversense DMS Pro non potranno visualizzare l'immagine del profilo.

Impostazioni account

Dettagli profilo

Immagine del profilo **Choose File** No file chosen

Nome * Nikole

Cognome * Copes

Numero cellulare Numero cellulare

Data di nascita


Domanda segreta * Qual è il nome del tuo primo animale domestico?

Risposta *

Mostra risposta

Password dimenticata

1. Fare clic su “Password dimenticata” sulla pagina di Registrazione
2. Inserire l’e-mail quando richiesto
3. Fare clic su “Invia mail”

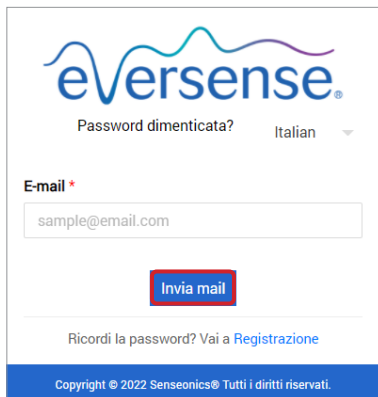

The screenshot shows the Eversense website's password reset request page. At the top is the Eversense logo and the text "Password dimenticata? Italian". Below this is a form with a label "E-mail *" and a text input field containing "sample@email.com". A red box highlights the "Invia mail" button. At the bottom, there is a link "Ricordi la password? Vai a Registrazione" and a footer with "Copyright © 2022 Senseonics® Tutti i diritti riservati."




The screenshot shows a confirmation message from Eversense. It features the Eversense logo at the top, followed by the text "Controllare l'email per resettare la password." and a link "Vai a Registrazione".

Verrà visualizzato un messaggio che conferma l'invio di un'e-mail con le istruzioni per resettare la password.


4. Aprire l'e-mail e fare clic sul link

Si verrà reindirizzati a una pagina web per creare e confermare una nuova password

5. Fare clic su “Resetta password”

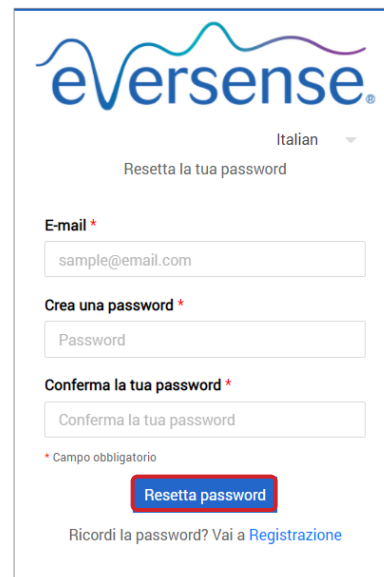

The screenshot shows the Eversense website's password reset confirmation page. It features the Eversense logo, a language dropdown menu set to "Italian", and the text "Resetta la tua password". Below this is a form with a label "E-mail *" and a text input field containing "sample@email.com". A red box highlights the "Resetta password" button. Below the button, there are two more form fields: "Crea una password *" with a "Password" input field, and "Conferma la tua password *" with a "Conferma la tua password" input field. A small asterisk indicates "* Campo obbligatorio". At the bottom, there is a link "Ricordi la password? Vai a Registrazione".

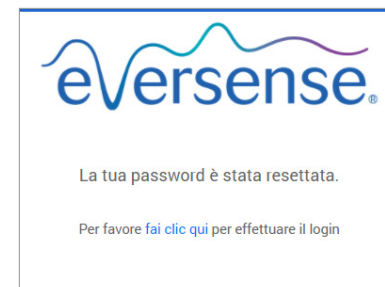

The screenshot shows a confirmation message from Eversense. It features the Eversense logo at the top, followed by the text "La tua password è stata resettata." and a link "Per favore fai clic qui per effettuare il login".

Apparirà un messaggio di conferma che la password è stata resettata. Selezionare il link “fai clic qui” per tornare alla pagina di Registrazione.

Home page

2

La Home page visualizza un elenco di pazienti attivi in base ai filtri selezionati e alle impostazioni predefinite del sistema. Fino a che non vengono aggiunti pazienti alla clinica DMS Pro, questa pagina rimarrà vuota.

Fed
ID clinica: 7321

Elenco dei pazienti

Q Mostra pazienti disattivati [Esporta dati](#)

Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	Condividi dati	Annulla l'iscrizione
Nessun dato da visualizzare								

3. Autorizzazioni

L'amministratore DMS Pro assegnerà un'autorizzazione.

In Eversense DMS Pro, esistono diverse autorizzazioni per gli utenti del personale della clinica. Le autorizzazioni sono **Amministratore**, **Vista**, **Modifica**, e **Aggiungi**. L'amministratore DMS Pro della clinica assegna le autorizzazioni. Tutti i livelli di autorizzazione sono in grado di fare ricerche negli elenchi dei pazienti, applicare filtri ed esportare.

Fare ricerche nell'elenco dei pazienti, applicare filtri, esportare

Elenco dei pazienti

Il record è stato aggiornato correttamente

Q [] Mostra pazienti disattivati Pazienti per provider Esporta dati

Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	Condividi dati	Annulla l'iscrizione
Martin	Paul		Maschio	01 giu 1967	Laura Yankov	Attivo	✓	

Fare clic su		Pazienti per provider	Esporta dati
Per	Cerca	Filtro	Esporta
Come	È possibile fare ricerche nell'elenco dei pazienti inserendo il nome nella barra di ricerca sopra l'elenco dei pazienti.	È inoltre possibile filtrare l'elenco dei pazienti in base all'operatore sanitario cliccando Pazienti per provider. <ol style="list-style-type: none">1. Fare clic su “Pazienti per provider”2. Contrassegnare la casella dell'operatore di cui si desiderano visualizzare i pazienti3. Fare clic su “Procedi”	È possibile esportare l'elenco dei pazienti come foglio Excel facendo clic su Esporta dati.


Vista





Per visualizzare i dati di un paziente:

1. Fare clic sul nome del paziente

3


Elenco dei pazienti

Q  Mostra pazienti disattivati Pazienti per provider Esporta dati

Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	Condividi dati		Annulla l'iscrizione
Martin	Paul		Maschio	01 giu 1967	Laura Yankov	Attivo			

2. Verranno visualizzate le informazioni DMS del paziente

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Visualizzare i dati Eversense DMS del paziente.*



Aggiungi

Per aggiungere un utente CGM Eversense all'elenco dei pazienti, è possibile inviare loro un invito attraverso DMS Pro, oppure il paziente può inviare una richiesta per unirsi alla clinica.


Il paziente deve avere già un account Eversense DMS. Solo gli utenti CGM Eversense possono essere aggiunti alla lista di pazienti Eversense DMS Pro. Per ottenere ulteriori informazioni sulla creazione di un account personale Eversense DMS, i pazienti possono visitare **global.eversenseddiabetes.com** e visualizzare il Manuale di istruzioni Eversense DMS.

Una volta che il paziente ha creato un account personale, è possibile inviargli un invito, oppure il paziente può inviare una richiesta di unirsi alla clinica.

Per inviare un invito al paziente:

1. Fare clic su **Pazienti** 
2. Fare clic su **Invita Paziente** 
3. Digitare l'indirizzo e-mail con cui l'utente ha registrato l'account Eversense

Nota: Non è possibile inviare un invito se l'indirizzo e-mail non è stato registrato con Eversense



Invita paziente

Invita paziente

E-mail *

sample@email.com

Cerca Eversense

Invia Resetta


4. Fare clic su “Cerca Eversense” per confermare che l'indirizzo e-mail è stato registrato

5. Se l'e-mail è stata registrata, verrà richiesto di inserire le informazioni sul paziente

- a. Inserire MRN (facoltativo)
- b. Selezionare un operatore sanitario all'interno della clinica per questo paziente
- c. Modificare il nome o cognome
- d. Inserire la data di nascita (facoltativo)
- e. Inserire il sesso (facoltativo)

6. Una volta terminato, fare clic su “Invia”

È stato inviato un invito al paziente via e-mail.

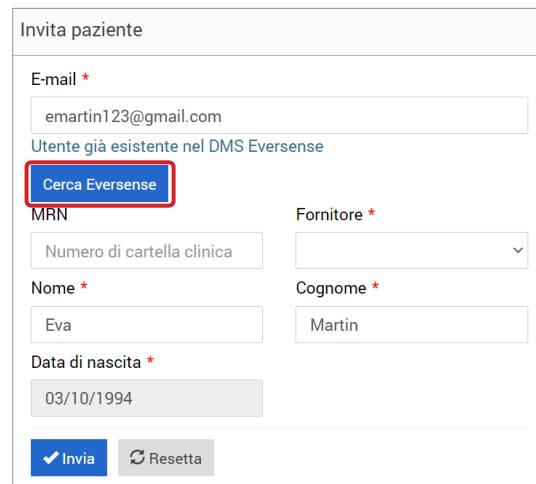

Invita paziente

E-mail *

emartin123@gmail.com

Utente già esistente nel DMS Eversense

Cerca Eversense

MRN

Numero di cartella clinica

Fornitore *

Cognome *

Nome *

Eva

Martin



Data di nascita *

03/10/1994

Invia Resetta

7. Verrà richiesto se si desidera inviare un altro invito. Facendo clic su No, viene visualizzata la schermata con l'elenco dei pazienti, dove è possibile visualizzare il paziente che è appena stato invitato

8. Fino a che il paziente non ha accettato l'invito, ci sarà una  nella colonna Condividi dati

9. Una volta che il paziente ha accettato l'invito, il simbolo  si trasformerà in , e sarà ora possibile fare clic sul nome per visualizzare i dati Eversense DMS


Elenco dei pazienti

Il record è stato aggiornato correttamente

Q  Mostra pazienti disattivati Pazienti per provider Esporta dati

Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	Condividi dati		Annulla l'iscrizione
Garcia	Jean		Femmina	07 ott 2000	Jon Johnson	Attivo			
Martin	Paul		Maschio	01 giu 1967	Laura Yankov	Attivo			
Muller	Ingrid		Femmina	01 dic 1980	Jon Johnson	Attivo			

Accettare la richiesta di un paziente

Un paziente può inviare la richiesta di unirsi alla clinica dall'account personale Eversense DMS se gli è stato fornito il numero Eversense DMS Pro della clinica. Il paziente può inserire il numero della clinica per inviare una richiesta nella pagina Condividi dati del proprio account DMS. Per visualizzare un elenco delle richieste in attesa, fare clic su .

3

Per accettare la richiesta del paziente:

1. Fare clic su Pazienti 

2. Fare clic su Richieste in attesa

Accanto a Richieste in attesa verrà visualizzato un numero. Questo numero indica quante richieste sono attualmente nell'elenco. Se non è presente alcun numero, allora non ci sono richieste in attesa.



Elenco dei pazienti in attesa							
Cognome del paziente	Nome del paziente	MRN	Sesso	DOB	Nome e cognome del provider	Stato	
Green	George		Maschio	03 mar 2004	John Smith	In attesa	Accetta Diminuzione

1 Totale

3. Fare clic su “Accetta” per aggiungere il paziente alla clinica



- Se si fa clic su Accetta, verrà richiesto di assegnare il paziente a un operatore della clinica.
- Se si fa clic su Rifiuta, la richiesta del paziente verrà rimossa, e il paziente non verrà aggiunto all'elenco della clinica.

L'utente CGM Eversense riceverà una notifica via e-mail quando la sua richiesta viene accettata o rifiutata.

Modifica

Il livello di autorizzazione **Modifica** consente di visualizzare e modificare le informazioni di un paziente in DMS Pro, di cancellare un paziente dall'elenco della clinica Eversense DMS Pro. Qualsiasi modifica fatta in DMS Pro non cambierà alcuna informazione salvata dal paziente nel suo account personale.


Per modificare le informazioni di un paziente:

1. Fare clic su **Pazienti** 

2. Fare clic su 

3. Si aprirà una finestra di dialogo con le sue informazioni

È possibile modificare tutte le informazioni tranne l'indirizzo e-mail.

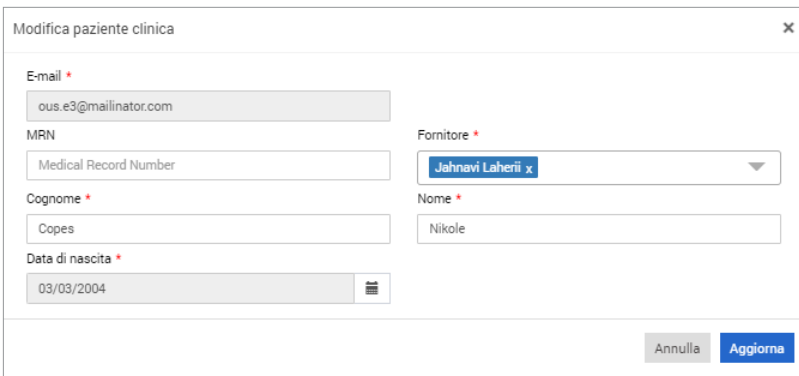

Modifica paziente clinica

E-mail *
ous.e3@mailinator.com

MRN
Medical Record Number

Fornitore *
Jahnavi Laheri x

Cognome *
Copes

Nome *
Nikole

Data di nascita *
03/03/2004

Annulla Aggiorna

Per annullare l'iscrizione di un paziente dalla clinica:

1. Fare clic su **Pazienti** 

2. Fare clic su 

3. Fare clic su **“Sì”**

Il paziente sarà ora rimosso dall'elenco della clinica DMS Pro e i suoi dati Eversense non saranno più disponibili per la visualizzazione.

Il livello di autorizzazione Modifica consente di accettare le Richieste in attesa dei pazienti che desiderano unirsi alla clinica. Fare riferimento a *Per accettare la richiesta del paziente* per ulteriori informazioni.


Amministratore

Il livello di autorizzazione **Amministratore** dà tutte le autorizzazioni dei livelli **Visualizza**, **Aggiungi** e **Modifica**, oltre all'abilità di accettare, modificare e rimuovere i membri del personale. Per saperne di più sull'autorizzazione come **Amministratore**, fare riferimento ad *Amministratore Eversense DMS Pro*.

4. Dashboard DMS

Visualizzare i dati Eversense DMS del paziente

Quando un paziente viene aggiunto alla clinica, è possibile fare clic sul suo nome per aprire una Home page che mostra i suoi dati Eversense DMS. Questa pagina è quasi identica a quella che visualizza il paziente quando accede al suo account personale Eversense DMS.



IMPORTANTE: Qualsiasi modifica apportata alle impostazioni o agli intervalli di date in DMS Pro NON influenzerà le impostazioni dei pazienti, l'account Eversense DMS o l'app mobile Eversense.

Nella parte superiore della Home page, vengono visualizzati nome, età, sesso, MRN, e-mail e operatore sanitario assegnato.

È possibile uscire da questa pagina in qualsiasi momento cliccando su  nell'angolo in alto a destra della finestra o su Chiudi in basso a destra della finestra.

La Home page contiene diverse sezioni:

- Seleziona intervallo di date
- Tempo durante il quale si indossa Eversense
- Profilo glicemico ambulatoriale (AGP)
- Report
- Informazioni sistema
- Scelta rapida per stampare o inviare e-mail

Fino a che il paziente non avrà caricato i dati del glucosio rilevato dal sensore dall'app mobile Eversense o dal suo Smart Transmitter, non verrà visualizzato alcun dato.

IMPORTANTE: Se il paziente ha attivato autosync, i dati saranno caricati automaticamente sul DMS dall'app mobile. I pazienti possono anche caricare manualmente i dati del glucosio dallo Smart Transmitter tramite un cavo USB. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei dati, visitare il sito eversensediabete.com per visualizzare il Manuale di istruzioni Eversense DMS.

Impostazione dell'intervallo di date

Nella parte superiore della Home page, è possibile visualizzare i report basati su un intervallo di date predefinito o su un intervallo di date personalizzato impostato dall'utente.

Per regolare le impostazioni dell'intervallo di date:



1. Se si desidera visualizzare un insieme di dati che non rientra in uno degli intervalli di date predefiniti, fare clic sul pulsante etichettato “Intervallo personalizzato” per visualizzare un calendario a discesa.



Comparirà una finestra pop-up che permetterà di selezionare un intervallo di date personalizzato.

Nota: I dati accessibili tramite DMS Pro comprendono fino all'anno precedente

2. Selezionare la *Data di inizio* del report desiderata
3. Selezionare la *Data di fine* del report desiderata
4. Fare clic su “Ok” una volta completato




Dashboard Eversense DMS

Il Dashboard Eversense DMS è la pagina predefinita che il paziente vedrà ogni volta che accede a DMS. Questa pagina contiene i seguenti dati del paziente: il Tempo durante il quale si indossa Eversense, i report Captur AGP e le Informazioni sistema del paziente.

Tempo durante il quale si indossa Eversense

Il tempo durante il quale si indossa Eversense è la percentuale del tempo in cui il paziente indossa lo Smart Transmitter nell'intervallo di date selezionato. 100% equivale a 23.5 ore giornaliere durante le quali si indossa lo Smart Transmitter. La percentuale non include i momenti in cui il glucosio non viene visualizzato. Ad esempio: l'inizio della fase di inizializzazione o quando viene attivato un avviso che impedisce la visualizzazione del glucosio.

 **Tempo durante il quale si indossa Eversense**

44,36 %

Informazioni sistema: Nella parte superiore del Dashboard AGP si trova la sezione **Informazioni sistema**.

Questa sezione mostra le seguenti informazioni del paziente:


- Numero di serie del trasmettitore
- Numero di serie del sensore
- Impostazioni glucosio: Le impostazioni glucosio possono essere modificate sia nel DMS che attraverso l'app mobile Eversense (vedere *Impostazioni* per maggiori informazioni).

Informazioni sistema	Impostazioni glucosio		
Trasmettitore: 95364	Target	Basso: 75 mg/dL	Alto: 120 mg/dL
Sensor: 58554	Avviso	Basso: 60 mg/dL	Alto: 349 mg/dL

Captur AGP in Eversense DMS

Il report principale del Dashboard Eversense DMS è il report Captur AGP (Profilo glicemico ambulatoriale).

Il report AGP mostra i dati del glucosio in 3 sezioni del report.



Statistiche glucosio: Misurazioni dei dati relativi al glucosio


- Glucosio in media: tutti i valori del glucosio sommati, divisi per il numero di letture
- HbA1c stimata: calcolata dai valori del glucosio di AGP; potrebbe differire dal valore di laboratorio di A1c a causa dei diversi periodi di tempo
- Intervalli glucosio; idealmente, i valori del glucosio devono rientrare nell'intervallo ottimale
 - Basso/Molto basso: Obiettivo – non avere valori molto bassi o bassi; ridurre il numero di valori bassi fa sentire meglio il paziente
 - Alto/Molto alto: Obiettivo – non avere valori molto alti o alti; ridurre il numero di valori alti farà diminuire il valore A1c del paziente nel tempo
- SD (Deviazione standard): quanta variazione c'è nell'insieme dei dati; idealmente un numero basso
- CV (Coefficiente di variazione): la distanza dei valori dalla media; idealmente un numero basso

Profilo glucosio: i profili glucosio giornalieri vengono combinati per ottenere il quadro di un'intera giornata (24 ore). Idealmente, le linee rimangono all'interno dell'area ombreggiata grigia (intervallo ottimale). Le linee potrebbero non arrivare fino in fondo, poiché è possibile che il paziente non testi a ogni ora del giorno.

Arancio: linea mediana (al centro) idealmente, dove la metà dei valori del glucosio è sopra e la metà sotto; idealmente, la linea arancione è prevalentemente piatta e si trova all'interno dell'area ombreggiata grigia

Blu: l'area tra le linee blu mostra il 50% dei valori del glucosio; idealmente, lo spazio tra le linee è stretto

Verde: 10% dei valori sono sopra (linea superiore: 90%) e 10% sono sotto (linea inferiore: 10%); idealmente, più le linee verdi sono vicine all'area ombreggiata grigia, meglio è



Profili glucosio giornalieri: ogni casella rappresenta il pattern del glucosio di un giorno.
Verrà visualizzato solo se l'intervallo delle date è impostato a 14 giorni o meno.



5. Report

I report forniscono varie modalità per organizzare e visualizzare le letture del glucosio nel tempo.

Nota: Se si seleziona un report e non viene visualizzato alcun dato, controllare di aver selezionato un intervallo di date per le quali ci sono dati disponibili.

IMPORTANTE: Se autosync non è attivato, i dati non vengono inviati automaticamente al DMS dall'app mobile Eversense.

5

Stampare o inviare via e-mail ciò che viene visualizzato nei report

In alto a destra della Home page ci sono le opzioni per la stampa e l'invio via e-mail dei report della Home page.




Fare clic su			
Per	Tipo di report	Report via e-mail	Salva report come PDF
Come	Selezionare quale report si desidera stampare o inviare via e-mail.	Seguire le istruzioni della finestra pop-up per inviare via e-mail un report adatto alla stampa a un destinatario designato.	Fare clic sull'icona per convertire il report in un PDF, che permette di stampare il report.


Opzioni report

Per visualizzare le diverse opzioni report, fare clic sul nome del report nel pannello dei report nella Home page.

Nota: Se si seleziona un rapporto e non viene visualizzato alcun dato, controllare quanto segue:

- Espandi l'intervallo di date selezionate. Se non ci sono dati sull'intero intervallo di date degli ultimi 90 giorni, è possibile che il paziente non abbia attivato autosync nella app mobile CGM Eversense. Se autosync non è attivato, chiedere al paziente di attivarlo.
- Chiedere al paziente di effettuare anche un caricamento manuale toccando “**Avvia sincronizzazione**” nella app mobile CGM Eversense.

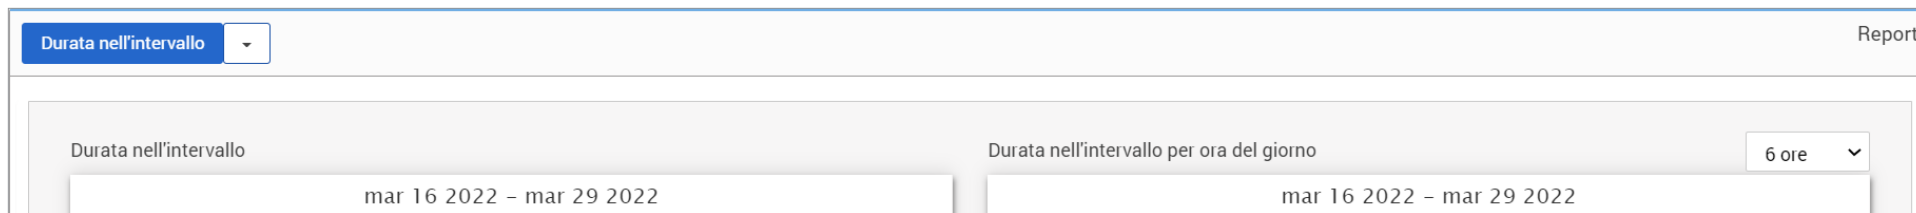

Alcuni report possono essere filtrati per visualizzare determinate informazioni. È possibile selezionare quali tipi di eventi, giorni della settimana; inoltre appariranno altre opzioni nei report cliccando  accanto al nome del report.

Questo filtro non è disponibile per i report AGP, Durata nell'intervallo per ora del giorno o Durata nel target.



Durata nel target


Il report Durata nel target mostra un grafico a torta che analizza la percentuale di tempo per il quale il glucosio del paziente è sopra, sotto o entro l'intervallo ottimale impostato dal paziente nelle impostazioni glucosio.

Visualizzare il report:

La fetta verde rappresenta la percentuale di tempo passato dal paziente entro l'intervallo ottimale.

La fetta grigia rappresenta la percentuale di tempo passato dal paziente sopra l'intervallo ottimale.

La fetta rossa rappresenta la percentuale di tempo passato dal paziente sotto l'intervallo ottimale.



Durata nell'intervallo

Durata nell'intervallo per ora del giorno


Il report Durata nell'intervallo per ora del giorno mostra una serie di grafici a barre che analizzano la percentuale del tempo per il quale il glucosio del paziente è entro gli intervalli di glucosio predefiniti.

- Molto basso: <54 mg/dL o <3,0 mmol/L
- Basso: 54-70 mg/dL o 3,0-3,9 mmol/L
- Entro l'intervallo: 70-180 mg/dL o 3,9-10,0 mmol/L
- Alto: 180-250 mg/dL o 10,0-13,9 mmol/L
- Molto alto: >250 mg/dL o >13,9 mmol/L

Ci sono due sezioni in questo report:

Durata nell'intervallo

Questa sezione mostra la percentuale complessiva del tempo passato dal paziente negli intervalli di glucosio predefiniti, sulla base dell'intervallo di date selezionato.




Durata nell'intervallo per ora del giorno

Questa sezione suddivide il grafico complessivo della Durata nell'intervallo in vari orari segmentati del giorno. È possibile visualizzare i dati del paziente in segmenti di 4 ore, 6 ore o 8 ore. Questa impostazione può essere regolata selezionando un'opzione in alto a destra sul report.

Ogni segmento mostra la percentuale di tempo per il quale il glucosio del paziente era entro quegli stessi segmenti di Molto basso, Basso, Entro l'intervallo, Alto e Molto alto.

5




Report variabilità glucosio

Il report variabilità glucosio mostra le informazioni in due modi:

Il grafico tendenza:

- Mostra il riassunto delle letture dei valori del glucosio nell'arco di 24 ore.
- Include i dati di molteplici giorni sovrapposti sullo stesso grafico.
- Mostra la lettura massima, minima e media del glucosio per ogni ora.
- Fornisce una panoramica visiva delle variazioni dei livelli giornalieri di glucosio del paziente.

Nota: Posizionare il cursore sopra a una lettura media del sensore per visualizzare i dettagli delle letture durante quell'ora.



La tabella:

- Organizza i dati del glucosio per periodi di 4 ore.
- Fornisce un'analisi statistica dettagliata per ciascun periodo.
- Comprende la percentuale di letture che sono sopra, sotto o entro l'intervallo ottimale del glucosio.
- Fornisce una ripartizione dell'uso di insulina e dei carboidrati inseriti per quegli stessi periodi di tempo.

Nota: Se si riscontrano difficoltà nella visualizzazione del report, provare a limitare l'intervallo delle date. Quantità particolarmente ingenti di dati potrebbero impedire il funzionamento del report.

Glucosio	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	Totale
% inferiore ad Avviso basso	-	-	-	-	-	-	-
% superiore ad Avviso alto	-	-	-	-	-	-	-
Numero di valori inferiori ad Avviso basso	-	-	-	-	-	-	-
Numero di valori superiori ad Avviso alto	-	-	-	-	-	-	-
% entro il target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
% inferiore al target	-	-	-	-	-	-	-
% superiore al target	-	-	-	-	-	-	-
Glucosio medio	102 mg/dL	103 mg/dL	103 mg/dL	105 mg/dL	104 mg/dL	103 mg/dL	103 mg/dL
Glucosio minimo	88 mg/dL	89 mg/dL	76 mg/dL	88 mg/dL	86 mg/dL	89 mg/dL	76 mg/dL
Glucosio massimo	114 mg/dL	119 mg/dL	133 mg/dL	138 mg/dL	126 mg/dL	124 mg/dL	138 mg/dL
Deviazione standard	5.3 mg/dL	6 mg/dL	6 mg/dL	8.9 mg/dL	7.5 mg/dL	6.7 mg/dL	7.1 mg/dL
Numero di valori tra il 10-90° percentile	239	157	216	264	268	314	1412
Numero totale di valori glicemici	290	187	262	322	317	368	1746
Numero di giorni con almeno un valore	7	5	7	7	8	8	8
Numero medio di valori al giorno	41	37	37	46	40	46	218

Report tendenza glucosio



Il report tendenza glucosio:

- Mostra le singole letture dei valori del glucosio nell'arco di 24 ore.
- Mostra i dati di molteplici giorni sovrainposti sullo stesso grafico.
- Fornisce la possibilità di individuare facilmente variabilità tra i giorni della settimana.

Visualizzare il report

I punti dati nel rapporto sono codificati a colori; ogni giorno della settimana viene visualizzato con un colore diverso. È possibile usare il filtro del report per scegliere il giorno o i giorni che si desidera o si desiderano visualizzare sul grafico.

Nota: Posizionare il cursore sopra a una lettura del glucosio rilevato dal sensore per visualizzare i dettagli relativi a quella lettura.





Report cronologia dei valori del glucosio

Il report cronologia dei valori del glucosio mostra i dati CGM storici e manualmente inseriti sotto forma di grafico tendenza. Il report cronologia dei valori del glucosio fornisce un modo efficiente per tracciare le letture dei valori del glucosio rilevato dal sensore e le calibrazioni.

Visualizzare il report

Ogni punto dati corrisponde a una lettura del glucosio rilevato dal sensore. Gli eventi che sono stati registrati dal paziente nella app mobile vengono visualizzati nel report all'orario in cui sono stati registrati. Se si seleziona un intervallo di date superiore a 30 giorni, gli eventi come i pasti e l'insulina non vengono visualizzati.

Nota: Posizionare il cursore sopra a una lettura del glucosio rilevato dal sensore per visualizzare i dettagli relativi a quella lettura. È inoltre possibile posizionare il cursore sopra all'icona di un evento per visualizzare i dettagli relativi a quell'evento.



Report glucosio giornaliero


Il report del glucosio giornaliero mostra le letture dei valori del glucosio nell'arco di 24 ore per più giorni di seguito.

Il report glucosio giornaliero:

- ha un intervallo target del glucosio fisso pari a 70-180 mg/dL (3,9-10,0 mmol/L);
- mostra i livelli di avviso glucosio alto e basso (le linee rosse) impostati dall'utente CGM;
- mostra le statistiche chiave per ogni giorno basate sulle impostazioni del glucosio target e degli avvisi;
- include un'opzione per visualizzare le icone degli eventi sul grafico dell'andamento e per espandere una tabella degli eventi per ogni giorno.

Visualizzare il report

Il report glucosio giornaliero mostra più giorni di seguito per l'intervallo di date selezionato e permette di identificare pattern nell'andamento dei valori del glucosio su più giorni. Le statistiche per ogni giorno sono visualizzate a destra del grafico dell'andamento e sono basate sull'intervallo target glucosio standard di 70-180 mg/dL (3,9-10,0 mmol/L) e sui livelli di avviso glucosio alto e basso impostati dal paziente. Per rivedere ulteriori informazioni CGM per ogni giorno (avvisi, calibrazioni, eventi inseriti nell'app CGM) è possibile attivare la visualizzazione delle icone degli eventi sul grafico dell'andamento ed espandere la tabella degli eventi sotto il grafico dell'andamento per visualizzare ulteriori informazioni. La tabella degli eventi espansa mostra informazioni con incrementi di 4 ore, allineati ai segmenti di 4 ore del grafico dell'andamento.

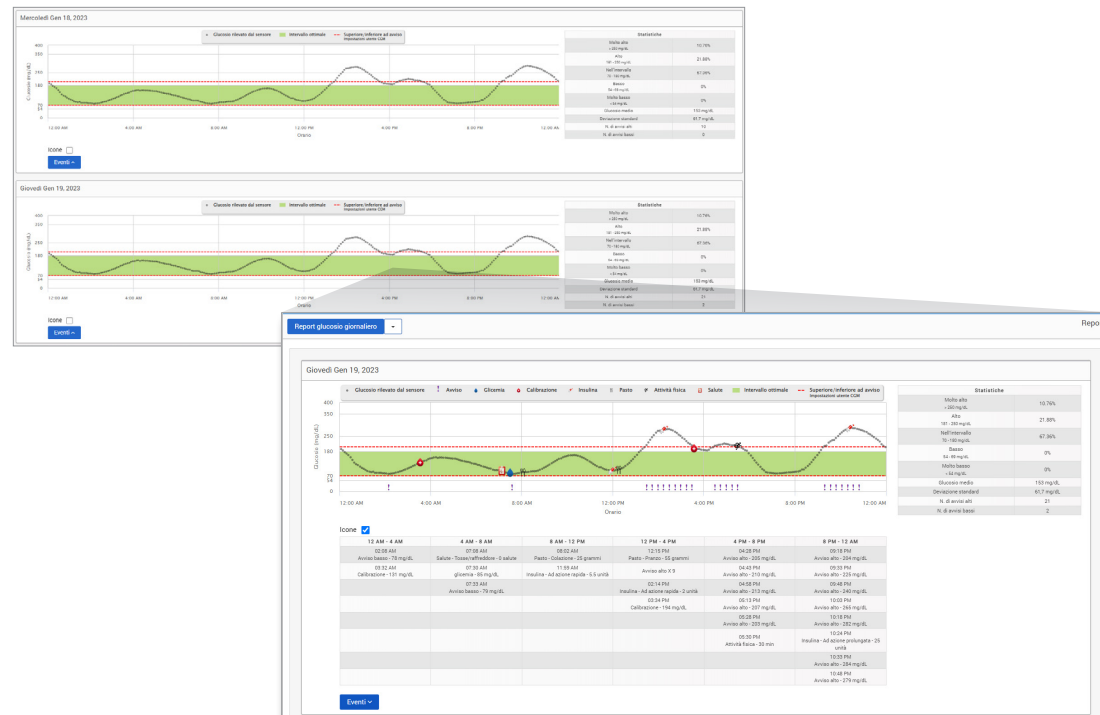

Statistiche:

La tabella delle statistiche fornisce analisi della percentuale del tempo per il quale il glucosio del paziente è entro gli intervalli di glucosio predefiniti.


- Molto basso: <54 mg/dL o <3,0 mmol/L
- Basso: 54-70 mg/dL o 3,0-3,9 mmol/L
- Entro l'intervallo: 70-180 mg/dL o 3,9-10,0 mmol/L
- Alto: 180-250 mg/dL o 10,0-13,9 mmol/L
- Molto alto: >250 mg/dL o >13,9 mmol/L

Include inoltre il glucosio medio giornaliero, la deviazione standard e il numero di avvisi di livello alto e basso.

Icone ed eventi:

Le icone e gli eventi sono visualizzati in base alle impostazioni degli avvisi glucosio, le calibrazioni e gli eventi inseriti dal paziente nell'app CGM.

Nota: è possibile regolare le impostazioni degli avvisi CGM per il report tramite DMS Pro. (Le impostazioni del glucosio target sono fissate a 70-180 mg/dL (3,9-10,0 mmol/L) e non possono essere modificate.) Regolando le impostazioni degli avvisi glucosio verrà modificata la posizione delle linee rosse degli avvisi nei grafici giornalieri dell'andamento CGM, ma non le statistiche giornaliere. Questo può rappresentare un supporto nella selezione delle impostazioni ottimali per gli avvisi di glucosio alto o basso.

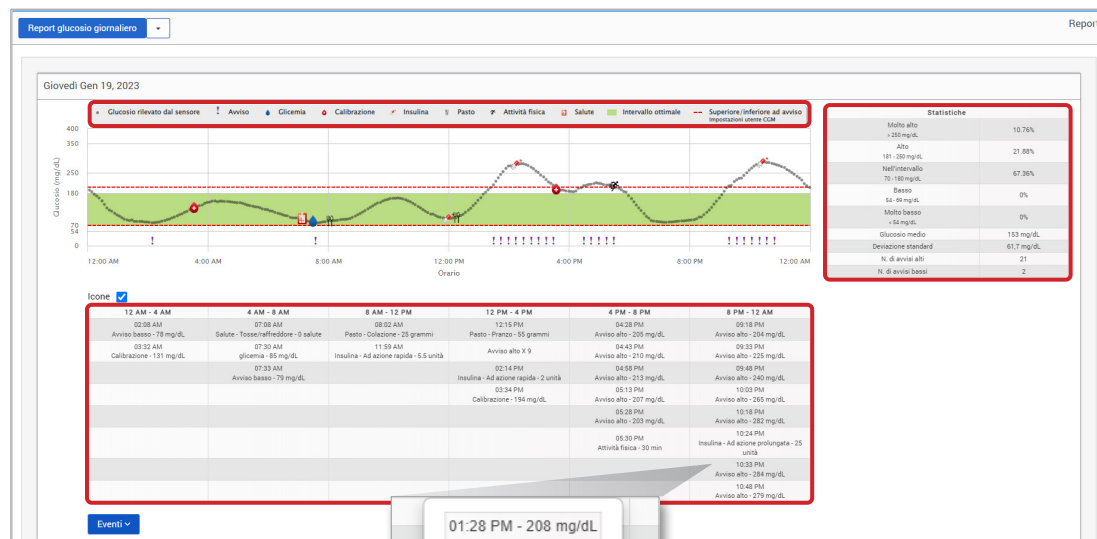

Nota: se più eventi sono registrati in una singola cella della tabella degli eventi, è possibile visualizzare ulteriori informazioni passando sulla cella con il mouse.


Report distribuzione glucosio

Il report distribuzione glucosio:

- Organizza i dati del glucosio del paziente in base ai target di glucosio e agli intervalli di avviso e mostra i dati sotto forma di grafico a torta.
- Mostra grafici a torta separati per il periodo corrente e quelli precedenti.
- Gli intervalli ottimali vengono definiti in impostazioni glucosio.
- Fornisce un check visivo per il numero di letture entro il target durante l'intervallo predefinito selezionato e il cambiamento nel tempo.

Visualizzare il report

Il report distribuzione glucosio visualizza due grafici a torta in base all'intervallo di date predefinito selezionato. Mostrerà la serie di dati attuali e precedenti rispetto all'intervallo di date selezionato. Questi dati permettono di visualizzare un confronto tra i cambiamenti attuali e quelli passati nella gestione del paziente.



Report registro trasmettitore

Il report registro trasmettitore fornisce una revisione completa dei dati nell'intervallo di date selezionato.

Il report registro trasmettitore mostra tre tabelle separate:

- **Glicemia:** visualizza un elenco di tutte le glicemie inserite manualmente e degli eventi correlati in ordine cronologico.
- **Voci evento:** visualizza gli eventi del paziente inseriti tramite la app mobile Eversense.
- **Glucosio rilevato dal sensore:** visualizza i valori di glucosio rilevati dal sensore.

Visualizzare il report

Gli eventi vengono mostrati con informazioni sulla data, sull'Orario e:


- **Glicemia:** valore del glucosio, unità, calibrazione
- **Voci evento:** tipo di evento, sottotipo di evento, valore
- **Glucosio rilevato dal sensore:** valore del glucosio, unità, ID sensore

Data	Orario	Glicemia	Unità	Calibrazione
16-novembre-2021	19:49	100	mg/dL	●
16-novembre-2021	19:48	100	mg/dL	●
16-novembre-2021	05:34	100	mg/dL	●
16-novembre-2021	05:33	100	mg/dL	●
15-novembre-2021	14:18	100	mg/dL	●
15-novembre-2021	14:15	112	mg/dL	●
15-novembre-2021	14:15	100	mg/dL	●
15-novembre-2021	12:13	100	mg/dL	●
15-novembre-2021	09:44	110	mg/dL	●
15-novembre-2021	09:43	110	mg/dL	●

Gli eventi possono essere disposti in ordine crescente o decrescente cliccando sull'intestazione della colonna.

Il numero delle registrazioni è indicato in fondo.

Un simbolo nella colonna **“Calibrazione”** della tabella Glicemia indicherà se un valore del glucosio è stato  Usato per la calibrazione,  Non usato, o se è  Manuale.

-  **Usato:** un valore di glicemia che il paziente ha inserito nella app mobile Eversense come calibrazione e che è accettato dal sistema.
-  **Non usato:** una calibrazione che è stata inserita ed è superiore a 400 mg/dL (22.2 mmol/L) o inferiore a 40 mg/dL (2.2 mmol/L).
-  **Manuale:** un valore di glicemia che non è stato inserito come calibrazione.

Esportare dati

Dalla pagina del report registro trasmettitore, è inoltre possibile esportare dati in formato .xlsx.

1. Selezionare **Report > Registro trasmettitore**

2. Selezionare **“Esporta Dati”** in alto su ciascuna tabella per esportare i dati come .xlsx (foglio Excel)

Glucosio rilevato dal sensore

[Esporta dati](#)

DATA	ORARIO	GLUCOSIO RILEVATO DAL SENSORE	UNITÀ	ID SENSORE
27-marzo-2022	23:59	170	mg/dL	262344
27-marzo-2022	23:54	175	mg/dL	262344

6. Impostazioni

Glucosio

Le impostazioni glucosio permettono di personalizzare il target per il glucosio e i livelli di avviso nei report. Questa impostazione determina come vengono organizzati e visualizzati il glucosio e altri dati relativi agli eventi nei report. Quando il paziente sincronizza i dati in modalità wireless tramite l'applicazione mobile, le impostazioni glucosio che ha salvato sull'applicazione saranno sincronizzate anche sull'account DMS.

IMPORTANTE: Le impostazioni glucosio NON vengono sincronizzate quando i dati vengono caricati dallo Smart Transmitter tramite cavo USB.

Nome e cognome del paziente: Nikole Copes Età: 18 Sesso: Maschio MRN: ous.e3@mailinator.com 📍 Jahnvi Laherii

Ultimi 7 giorni Ultimi 14 giorni Ultimi 30 giorni Ultimi 60 giorni Ultimi 90 giorni **Intervallo personalizzato**

⚙️ ✉️ 📄

Impostazioni glucosio

Per cambiare le impostazioni nella Vista Eversense DMD Pro, seguire i passaggi sotto descritti:

1. Controllare i livelli di glucosio in alto sullo schermo
2. Fare clic sul pulsante mg/dL o mmol/L sotto all'unità di misura per selezionare l'unità di misura desiderata per la visualizzazione dei dati del glucosio.
Se si modifica l'unità di misura, i valori dell'intervallo glucosio e degli intervalli di avviso cambieranno di conseguenza.
3. Fare clic sui pulsanti +/- a destra di Target alto e Target basso per visualizzare e regolare i limiti alto e basso dell'intervallo ottimale del glucosio
4. Ripetere per l'intervallo di avviso del glucosio
5. Quando si sono terminate le modifiche, fare clic su "Salva" per salvare le modifiche

Nota: Queste impostazioni verranno salvate per la prossima visualizzazione dei report del paziente, anche dopo essere usciti da DMS Pro. Le impostazioni Eversense DMS Pro non condizionano le impostazioni del sistema CGM Eversense o la visualizzazione di Eversense DMS del paziente.

Impostazioni glucosio

Unità di misura mg/dL mmol/L


Intervallo ottimale (deve essere compreso tra le Impostazioni avvisi)	Intervallo di avviso (deve essere compreso fra 60 e 350)
Target alto * <input type="text" value="219"/>	Avviso alto* <input type="text" value="279"/>
Target basso* <input type="text" value="70"/>	Avviso basso * <input type="text" value="64"/>

7. Guida

Informazioni

Questa pagina mostra le versioni più aggiornate di Eversense DMS Pro.

IMPORTANTE: Per domande sul proprio account Eversense DMS Pro, contattare il proprio distributore locale. Negli Stati Uniti d'America, chiamare 844-SENSE4U (844-736-7348).

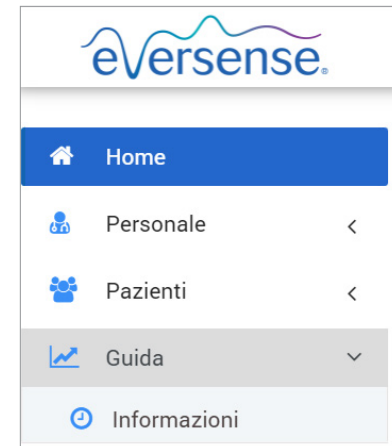

8. Risoluzione dei problemi

1. I miei filtri precedenti non vengono più applicati quando torno alla Home page o alla pagina Pazienti.

- I filtri vengono aggiornati quando si lascia la Home page o la scheda Pazienti. Si prega di riapplicare i filtri per visualizzare l'elenco dei pazienti desiderati.

2. Se l'unico amministratore della clinica rimuove inavvertitamente i propri privilegi di amministratore, si prega di contattare l'assistenza clienti.

3. Gli utenti CGM in Germania possono decidere di non creare un account Eversense. Tali utenti non possono condividere dati con Eversense DMS Pro.



Guide de l'utilisateur du système de gestion des données (DMS) Pro

Eversense et le logo Eversense sont des marques déposées de Senseonics, Incorporated. Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le DMS Eversense ne contient pas de logiciel ni de virus susceptible de nuire à votre ordinateur. Nous vous recommandons d'utiliser un pare-feu approprié et un anti-virus sur votre ordinateur pour vous protéger contre les logiciels malveillants et les virus.

Vous trouverez la politique de confidentialité d'Eversense à la page global.eversenseddiabetes.com.

Table des matières

Glossaire.....	118	4. Tableau de bord du DMS.....	141
I. Introduction.....	119	Affichage de données patient du DMS Eversense	141
Utilisation prévue	119	Configuration de la plage de dates	143
Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité	119	Tableau de bord du DMS Eversense	144
Aide et Support clientèle	119	5. Rapports.....	148
2. Prise en main.....	120	Durée dans la cible	150
Enregistrement d'une clinique et création de votre compte administrateur	120	Durée dans la plage	151
Accès au DMS Pro Eversense	122	Rapport de variabilité du glucose	153
Administrateur DMS Pro Eversense	122	Rapport de tendance du taux de glucose	155
Menu de navigation	123	Rapport d'historique des taux de glucose	156
Utilisateur du DMS Pro Eversense membre du personnel de la clinique	128	Rapport de glucose quotidien	157
Votre profil et le menu de navigation	128	Rapport de distribution du glucose	159
Profil	129	Rapport du journal du transmetteur	160
Mot de passe oublié	131	6. Paramètres.....	162
Page d'accueil	132	Glucose	162
3. Autorisations.....	133	7. Aide.....	164
Afficher	134	À propos	164
Ajouter	136	8. Dépannage.....	165
Modifier	139		
Administrateur	140		

Glossaire

Application Client Eversense Une application de bureau permettant aux utilisateurs d'Eversense de charger les données de leur Smart Transmetteur sur le système de gestion des données via un câble USB.

Application Eversense App Programme logiciel installé sur un appareil mobile et qui affiche les taux de glucose du MGC obtenues avec le Smart Transmetteur.

Capteur Dispositif inséré sous la peau pour mesurer en continu le taux de glucose dans le liquide interstitiel.

Contre-indication État ou circonstance qui empêche une personne d'utiliser le dispositif.

Étalonnage Valeur de glycémie provenant d'un test par piqûre au doigt que l'on entre dans l'application Eversense pour vérifier la précision du système. Avec le système Eversense, il y a deux phases : la phase d'initialisation, durant laquelle vous devez faire 4 piqûres au doigt et la phase d'étalonnage quotidien durant laquelle vous devez faire deux piqûres au doigt par jour.

EULA Licence d'exploitation pour l'utilisateur final.

Glycémie Valeur de la glycémie obtenue au moyen d'un test par piqûre au doigt.

Lecteur de glycémie Appareil vendu commercialement utilisé pour mesurer la glycémie dans une gouttelette de sang prélevée au bout du doigt.

Liquide interstitiel Liquide qui circule entre les cellules du corps. Le système MGC Eversense mesure le taux de glucose du liquide interstitiel et le compare à la valeur de la glycémie (taux de glucose sanguin) obtenu par piqûre au bout du doigt.

MGC Système de mesure continue du taux de glucose. Surveillance continue de votre taux de glucose interstitiel toutes les quelques minutes.

mg/dl Milligrammes par décilitre, unité de mesure qui indique la concentration d'une substance dans une quantité de liquide spécifique. Dans certains pays, dont les États-Unis, les résultats du taux de glucose sont rapportés en mg/dl ; ils indiquent quelle quantité de glucose on trouve dans le sang avec un lecteur de glycémie, ou quelle quantité de glucose on trouve dans le liquide interstitiel avec un système MGC comme le système MGC Eversense.

mmol/l Milli-moles par litre, unité de mesure qui indique la concentration d'une substance dans une quantité de liquide spécifique. Dans de nombreux pays, les résultats du taux de glucose sont rapportés en mmol/L ; ils indiquent quelle quantité de glucose on trouve dans le sang avec un lecteur de glycémie, ou quelle quantité de glucose on trouve dans le liquide interstitiel avec un système MGC comme le système MGC Eversense.

Smart Transmetteur Dispositif réutilisable porté à l'extérieur du corps au-dessus du capteur qui alimente le capteur et envoie les valeurs du taux de glucose vers l'appareil mobile pour y être affichées dans l'application Eversense App.

Synchronisation automatique Lorsque cette fonctionnalité est activée sur l'application mobile Eversense, vos données et paramètres du taux de glucose se synchronisent automatiquement dans le DMS Eversense toutes les deux heures.

Système de gestion des données Eversense (DMS, Data Management System) Application sur serveur compatible avec l'application Eversense dans laquelle sont stockées et visualisées vos valeurs du taux de glucose.

Valeurs glycémiques du capteur Valeur du taux de glucose mesurée par le capteur Eversense.

I. Introduction

Utilisation prévue

Le système de gestion des données (DMS) Pro Eversense est un outil permettant aux professionnels de santé de gérer et examiner les taux de glucose de leurs patients qui utilisent le système MGC Eversense.

Vous trouverez une liste d'appareils compatibles et de systèmes d'exploitation à l'adresse <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.

Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité

L'utilisation du système de gestion des données Pro Eversense est soumise aux termes et conditions de la dernière licence d'exploitation d'Eversense et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis à jour périodiquement et sont postés sur global.eversenseddiabetes.com.

Aide et Support clientèle

Pour toute question concernant le contenu de ce Guide de l'utilisateur du DMS Pro, contactez le Support clientèle au (+1) 844-SENSE4U (numéro gratuit aux États-Unis) ou au (+1) 844-736-7348. En dehors des États-Unis, appelez votre distributeur local ; au besoin, allez à la page global.eversenseddiabetes.com pour le localiser.


2. Prise en main

Enregistrement d'une clinique et création de votre compte administrateur

Pour enregistrer votre clinique, vous devez également enregistrer un compte administrateur de la clinique. Rendez-vous pour cela sur le site globalpro.eversensedms.com. Après l'enregistrement, votre clinique recevra un Numéro de clinique qui servira d'identifiant permettant aux patients de demander de rejoindre votre clinique.

Pour enregistrer votre clinique et créer votre compte administrateur :

1. Accédez à globalpro.eversensedms.com
2. Cliquez sur **Créer un compte** sur l'écran de connexion

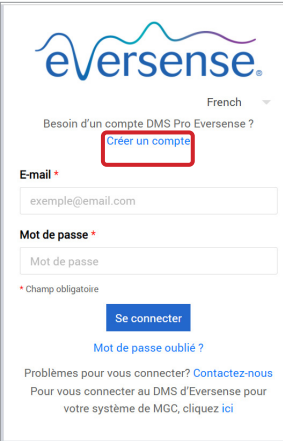

The screenshot shows the Eversense login interface. At the top is the Eversense logo. Below it, the language is set to 'French'. The text asks 'Besoin d'un compte DMS Pro Eversense ?' and a red box highlights the 'Créer un compte' button. Below this are input fields for 'E-mail *' (containing 'exemple@email.com') and 'Mot de passe *'. A 'Se connecter' button is visible below the password field. At the bottom, there is a link for 'Mot de passe oublié ?' and a note about connecting to the MGC system.

3. Remplissez le formulaire d'inscription

IMPORTANT : vous ne pouvez pas utiliser la même adresse électronique qu'un nom d'utilisateur pour le DMS Pro Eversense et un compte personnel pour le DMS Eversense.

4. Cliquez sur Soumettre

French

Demande d'un compte DMS Pro Eversense

Coordonnées

Prénom * Nom * Titre *

E-mail * Confirmez votre adresse e-mail * Numéro de téléphone *

Nom du cabinet ou de l'établissement de soins de santé * Pays *

Adresse ligne 1

Adresse ligne 2

Ville État Code postal

Veillez vérifier et confirmer les éléments suivants avant de continuer

Accepter les [conditions](#) d'utilisation

Retapez le code: *

Vous avez déjà un compte ? Veuillez accéder à [Se connecter](#)

Droits d'auteur © 2022 Eversense® Tous droits réservés.

5. Vous recevrez un e-mail avec un lien permettant d'activer votre compte quand vos comptes de clinique et administrateur seront approuvés

Ce lien expirera après 72 heures.

6. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien pour activer votre compte, vous serez invité à créer votre mot de passe pour le DMS Pro Eversense

Une fois votre mot de passe créé, vous pouvez vous connecter et voir votre Numéro de clinique en haut de l'écran à côté du nom de votre clinique.

eversense

Page d'accueil

Personnel

Patients

Aide

Fed ID de la clinique: 7321

Liste de patients

Q

Accès au DMS Pro Eversense

Pour accéder au DMS Pro Eversense, rendez-vous sur le site globalpro.eversensedms.com. Vous serez redirigé vers la page de connexion après avoir sélectionné votre région.

Administrateur DMS Pro Eversense


Le DMS Pro Eversense nécessite au moins un administrateur de compte qui peut :

- Enregistrer la clinique, qui génère l'ID de clinique unique.
- Inviter d'autres membres du personnel à rejoindre le site de la clinique et à configurer leurs autorisations.
- Modifier les autorisations des membres du personnel.
- Supprimer des membres du personnel du compte administrateur de la clinique.
- Aider les autres membres du personnel à réinitialiser leurs mots de passe.

Niveaux d'autorisations du DMS Pro

Dans le DMS Pro Eversense, un utilisateur membre du personnel de la clinique peut avoir l'un des niveaux d'autorisations suivants : **Administrateur, Afficher, Modifier** et **Ajouter**. L'administrateur de votre clinique affecte les autorisations aux autres utilisateurs membres du personnel de la clinique.

- **Administrateur** : peut Afficher, Modifier et Ajouter.
- **Afficher** : permet à l'utilisateur membre du personnel de la clinique d'afficher la liste des patients acceptés et d'afficher les données dans le compte DMS de chaque patient.
- **Ajouter** : donne à l'utilisateur membre du personnel de la clinique les mêmes autorisations qu'Afficher et lui permet d'accepter des demandes de patients de rejoindre votre clinique et d'envoyer aux patients des invitations à rejoindre votre clinique.
- **Modifier** : permet à l'utilisateur membre du personnel de la clinique de modifier les informations d'un patient dans DMS Pro, de désabonner un patient de la clinique et d'afficher ses données du DMS Eversense. Toute modification apportée dans DMS Pro ne modifie aucune information enregistrée par le patient dans son compte personnel.

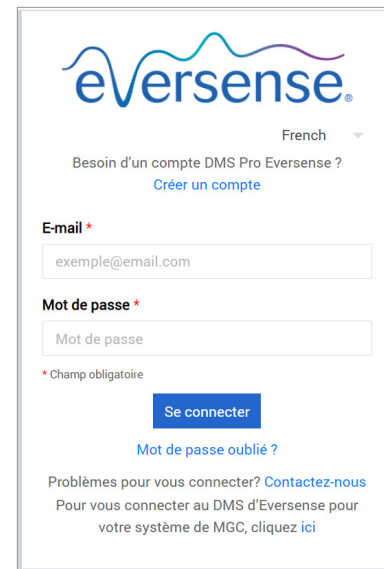

eversense®

French

Besoin d'un compte DMS Pro Eversense ?
[Créer un compte](#)

E-mail *

exemple@email.com

Mot de passe *

Mot de passe

* Champ obligatoire

[Se connecter](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

Problèmes pour vous connecter? [Contactez-nous](#)

Pour vous connecter au DMS d'Eversense pour votre système de MGC, cliquez [ici](#)


Menu de navigation

En haut à gauche de la page d'accueil, il y a le menu de navigation. Vous pouvez ouvrir ou fermer le menu de navigation en cliquant sur . Cliquez sur l'un des boutons du menu pour sélectionner une option.


Remarque :

- Vous pouvez également sélectionner votre langue favorite en cliquant sur l'icône de drapeau dans l'angle supérieur droit de la page.
- Votre menu de navigation peut avoir un aspect différent selon l'autorisation affectée par l'administrateur de votre clinique.

Administrateur

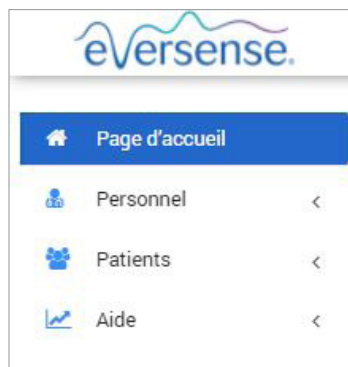

Afficher



Ajouter




Modifier




Pour ajouter des membres du personnel :

1. Cliquez sur « **Personnel** » dans la barre de navigation de gauche
2. Cliquez sur « **Ajouter un membre du personnel** »
3. Indiquez les coordonnées et sélectionnez les titres des membres du personnel
4. Contrôlez et modifiez les autorisations si nécessaire
Il est possible d'affecter plusieurs autorisations.
5. Cliquez sur « **Envoyer** »
6. Le personnel de la clinique reçoit l'invitation par e-mail et doit cliquer sur le lien de vérification dans l'e-mail pour se connecter avec le mot de passe provisoire indiqué dans l'e-mail. Une fois connecté, il est invité à créer un nouveau mot de passe.





IMPORTANT : les autorisations par défaut sont affectées en fonction du titre sélectionné. En cas de modification du titre d'un utilisateur, vous devriez vérifier les autorisations et les modifier si nécessaire.



Pour modifier les informations et les autorisations de membres du personnel :

1. Cliquez sur « **Personnel** » dans la barre de navigation de gauche
2. Cliquez sur  pour ouvrir leur page d'informations
3. Depuis cette page, vous pouvez :
 - a. Modifier le nom et/ou le titre
 - b. Mettre à jour les autorisations
4. Cliquez sur « **Mettre à jour** » une fois terminé

IMPORTANT : en cas de modification du titre d'un utilisateur, vous devriez vérifier les autorisations et les modifier si nécessaire.

Nom	Prénom	Titre	E-mail	Statut		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Actif		

Modifier un membre du personnel de la clinique ✕

Coordonnées

Prénom *

Nom *

Titre *

Actif Inactif

Autorisation *

<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrateur
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter
<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Afficher

Mettre à jour Annuler

Pour désactiver des comptes de membres du personnel de la clinique :

1. Cliquez sur « Personnel » dans la barre de navigation de gauche

2. Cliquez sur  pour ouvrir leur page d'informations

3. Choisissez Inactif en bas de la page

Lorsqu'un compte est inactif, le personnel de la clinique ne peut plus ajouter, modifier ni afficher de compte patient dans DMS Pro.

Modifier un membre du personnel de la clinique

Coordonnées

Prénom *

Nom *

Titre *


Actif Inactif

Autorisation *

<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrateur
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter
<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Afficher

Pour aider des membres du personnel de la clinique à réinitialiser leurs mots de passe :

1. Cliquez sur « **Personnel** » dans la barre de navigation de gauche





2. Cliquez sur 

Trouvez le membre du personnel de la clinique et cliquez sur .

3. Entrez le nouveau mot de passe et confirmez-le

4. Cliquez sur Notifier l'utilisateur si vous voulez informer le membre du personnel par e-mail que son mot de passe a été réinitialisé

5. Cliquez sur « **Réinitialiser le mot de passe** »

Nom	Prénom	Titre	E-mail	Statut		
Johnson	Jon	MD	jonj97329@gmail.com	Actif		

Réinitialiser le mot de passe du personnel de la clinique ✕

Nom d'utilisateur

Jon Johnson

Nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmation du mot de passe

Confirmation du mot de passe

Notifier l'utilisateur

Réinitialiser le mot de passe

Annuler

Utilisateur du DMS Pro Eversense membre du personnel de la clinique

Votre administrateur créera un compte pour vous dans le DMS Pro Eversense. Vous recevrez un e-mail avec un mot de passe provisoire et un lien pour activer votre compte et créer un mot de passe permanent. Cliquez sur le lien pour finir de configurer votre compte et accéder à la page d'accueil. Une fois que votre compte est activé, vous pouvez accéder à la page **globalpro.eversensedms.com** pour vous connecter à tout moment.

Votre profil et le menu de navigation

Une fois que vous êtes connecté(e) à votre compte, la page d'accueil s'ouvre.

- En haut à droite de la page, vous pouvez accéder à vos informations de **Profil**.
- En haut à gauche de la page, vous voyez un **Menu de navigation**. Votre menu de navigation peut avoir un aspect différent selon l'autorisation affectée par l'administrateur de votre clinique.

The screenshot displays the Eversense DMS Pro user interface. At the top left, the Eversense logo is visible. A blue navigation menu is open on the left side, listing: Page d'accueil (Home), Personnel, Patients, and Aide. The main header is blue and contains a hamburger menu icon, the text "French" with a dropdown arrow, and a user profile icon with the email "jonj97329@gmail.com" and a dropdown arrow. Below the header, the page title is "High Street Clinic" with the subtitle "ID de la clinique: 7322". The main content area is titled "Liste de patients" and features a search bar, a refresh icon, a checkbox for "Afficher les patients désactivés", and two buttons: "Patients par fournisseur de soins de santé" and "Exporter les données". Red lines and dots highlight the navigation menu and the user profile area in the screenshot.


Profil

En haut à droite de la page d'accueil, cette fonction vous permet de modifier votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, de modifier votre profil utilisateur ou de vous déconnecter du DMS Pro Eversense.


Modifier votre mot de passe :

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur

Un menu déroulant apparaît avec la photo de votre profil, votre dernière connexion et les options pour visualiser/modifier votre profil ou pour vous déconnecter.

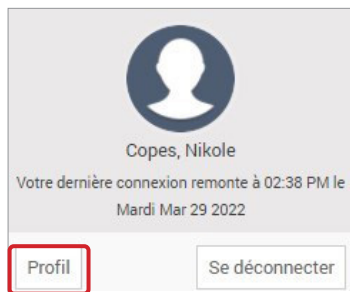

2. Cliquez sur « Profil » pour accéder aux Paramètres du profil utilisateur

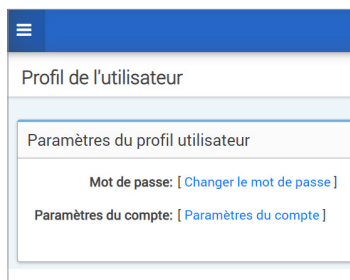

3. Cliquez sur « Changer le mot de passe » pour afficher et modifier votre mot de passe actuel

4. Entrez votre Mot de passe actuel

5. Entrez et confirmez votre nouveau mot de passe

6. Cliquez sur « Changer le mot de passe » pour enregistrer vos modifications

Changer le mot de passe

Mot de passe actuel *

Nouveau mot de passe *

Confirmez le nouveau mot de passe *

Pour ajuster les informations de votre compte :

1. Cliquez sur « Paramètres du compte »

2. Entrez les informations que vous allez modifier

Vous pouvez changer de photo de profil en appuyant sur le bouton **Choisir un fichier** et en sélectionnant une photo depuis les fichiers de votre ordinateur.

3. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications

La page Paramètres du profil utilisateur réapparaît. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur « **Page d'accueil** » en haut à gauche du panneau de navigation. Les patients qui utilisent le DMS Eversense ou les utilisateurs membres du personnel de la clinique qui utilisent le DMS Pro Eversense ne pourront pas afficher votre photo de profil.

Paramètres du compte

Paramètres du compte

Informations du profil

Photo du profil **Choose File** No file chosen

Prénom * Nikole

Nom * Copes

Numéro de portable Numéro de portable

Date de naissance Date de naissance

Question de sécurité * Comment s'appelait votre premier animal domestique ?

Réponse *

Afficher la réponse

Mot de passe oublié

1. Cliquez sur « **Mot de passe oublié** » sur la page Se connecter
2. Entrez votre e-mail lorsque vous y êtes invité
3. Cliquez sur « **Envoyer un e-mail** »

Un message vous informant qu'un e-mail vous a été envoyé avec des instructions pour réinitialiser votre mot de passe s'affiche.

4. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien du site Web


Une page vous permettant de créer et de confirmer un nouveau mot de passe s'ouvre.

5. Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe »

Un message confirmant que votre mot de passe a bien été réinitialisé apparaît. Sélectionnez le lien « cliquez ici » pour retourner à la page Se connecter.

Page d'accueil

La page d'accueil affiche une liste de patients actifs en fonction des filtres sélectionnés et des paramètres par défaut du système. Cette page reste vierge jusqu'à l'ajout de patients au DMS Pro de votre clinique.

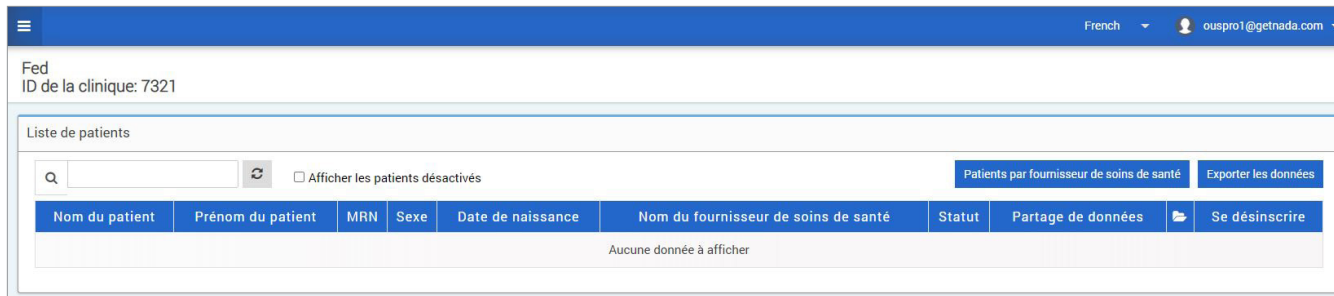

The screenshot displays the user interface for the DMS Pro system. At the top, a blue header bar contains a menu icon, the language 'French', and the user email 'ouspro1@getnada.com'. Below the header, the page title 'Fed' and the clinic ID 'ID de la clinique: 7321' are shown. The main section is titled 'Liste de patients' and includes a search bar with a magnifying glass icon and a refresh button. A checkbox labeled 'Afficher les patients désactivés' is present. Two buttons, 'Patients par fournisseur de soins de santé' and 'Exporter les données', are located on the right. Below this is a table with the following columns: 'Nom du patient', 'Prénom du patient', 'MRN', 'Sexe', 'Date de naissance', 'Nom du fournisseur de soins de santé', 'Statut', 'Partage de données', and 'Se désinscrire'. The table currently displays the message 'Aucune donnée à afficher'.


3. Autorisations





Votre administrateur DMS Pro vous affectera une autorisation.

3

Dans le DMS Pro Eversense, un utilisateur membre du personnel de la clinique peut avoir l'un des niveaux d'autorisations suivants dans une clinique : **Administrateur, Afficher, Modifier et Ajouter**. L'administrateur DMS Pro de votre clinique vous affecte les autorisations. Tous les niveaux d'autorisations permettent de rechercher, filtrer et exporter des listes de patients.

Rechercher, filtrer, exporter une liste de patients




Cliquez sur	 <input type="text"/>				
Pour	Rechercher		Filtrer		Exporter
Comment	Vous pouvez chercher des patients par leurs noms dans la barre de recherche au-dessus de la Liste de patients.		Vous pouvez également filtrer la Liste de patients par fournisseur de soins de santé en cliquant sur Patients par fournisseur de soins de santé. 1. Cliquez sur « Patients par fournisseur de soins de santé » 2. Cochez la case du fournisseur dont vous voulez afficher les patients 3. Cliquez sur « Continuer »		Vous pouvez exporter la liste de patients dans un fichier Excel en cliquant sur Exporter les données.

Afficher


Pour afficher les données d'un patient :

1. Cliquez sur le nom du patient

Liste de patients

Q  Afficher les patients désactivés Patients par fournisseur de soins de santé

[Exporter les données](#)


Nom du patient	Prénom du patient	MRN	Sexe	Date de naissance	Nom du fournisseur de soins de santé	Statut	Partage de données		Se désinscrire
Martin	Paul		Homme	juin 01, 1967	Laura Yankov	Actif	✓		

3

2. Les informations du DMS du patient sont affichées

Pour plus d'informations, voir *Afficher les données du DMS Eversense du patient*.

3





Ajouter

Pour ajouter un utilisateur MGC Eversense à votre liste de patients, vous pouvez lui envoyer une invitation via DMS Pro ou il peut demander de rejoindre votre clinique.


Le patient doit déjà avoir un compte du DMS Eversense. Seuls les utilisateurs du MGC Eversense peuvent être ajoutés à la liste de patients de votre DMS Pro Eversense. Pour plus d'informations sur la création d'un compte personnel DMS Eversense, les patients peuvent consulter le site global.eversensedidiabetes.com et consulter le Guide de l'utilisateur du système de gestion des données (DMS) Eversense.

Une fois que le patient a créé un compte personnel, vous pouvez lui envoyer une invitation ou il peut envoyer une demande pour rejoindre votre clinique.

Pour envoyer une invitation à un patient :

1. Cliquez sur **Patients** 
2. Cliquez sur **Inviter des patients** 
3. Saisissez l'adresse électronique que l'utilisateur a utilisée pour enregistrer son compte Eversense

Remarque : il est impossible d'envoyer une invitation si l'e-mail n'a pas été enregistré avec le DMS Eversense.



Inviter un patient

Inviter un patient


E-mail *

exemple@email.com

Rechercher dans Eversense

✓ Envoyer Réinitialiser

4. Cliquez sur « **Rechercher dans Eversense** » pour vérifier si cette adresse électronique a été enregistrée auprès d'Eversense
5. Si elle a été enregistrée, vous serez invité à entrer les informations du patient
 - a. Pour entrer un MRN (facultatif)
 - b. Pour sélectionner un fournisseur de soins de santé dans votre clinique pour ce patient
 - c. Modifiez le nom ou le prénom
 - d. Entrez la date de naissance (facultatif)
 - e. Entrez le sexe (facultatif)
6. Une fois terminé, cliquez sur « **Envoyer** »
Le patient recevra une invitation par e-mail.

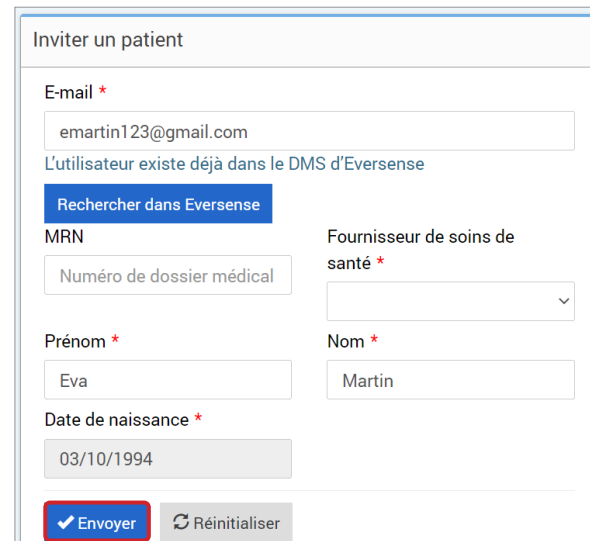

Inviter un patient

E-mail *

emartin123@gmail.com

L'utilisateur existe déjà dans le DMS d'Eversense

Rechercher dans Eversense

MRN

Numéro de dossier médical

Fournisseur de soins de santé *

Prénom *

Eva




Nom *

Martin

Date de naissance *





03/10/1994

✓ Envoyer Réinitialiser

7. Il vous sera demandé si vous voulez envoyer une autre invitation. Si vous cliquez sur Non, vous serez redirigé vers la liste de patients et y verrez le patient que vous venez d'inviter
8. Jusqu'à ce que le patient ait accepté l'invitation, un  apparaît dans la colonne de partage de données
9. Une fois que le patient a accepté l'invitation, le  devient un  et vous pouvez alors cliquer sur son nom pour consulter ses données du DMS Eversense

Liste de patients Dossier mis à jour avec succès

Afficher les patients désactivés Patients par fournisseur de soins de santé
Exporter les données

Nom du patient	Prénom du patient	MRN	Sexe	Date de naissance	Nom du fournisseur de soins de santé	Statut	Partage de données		Se désinscrire
Garcia	Jean		Femme	oct. 07, 2000	Jon Johnson	Actif	✓		
Martin	Paul		Homme	juin 01, 1967	Laura Yankov	Actif	✓		
Muller	Ingrid		Femme	déc. 01, 1980	Jon Johnson	Actif	✗		

Accepter la demande d'un patient


Un patient peut envoyer une demande pour rejoindre votre clinique depuis son compte personnel du DMS Eversense si vous lui avez donné votre numéro de clinique du DMS Pro Eversense. Il peut entrer votre numéro de clinique pour vous envoyer une demande sur la page Partage de données de son compte DMS. Pour afficher une liste des demandes en attente, cliquez sur .

Pour accepter la demande d'un patient :

1. Cliquez sur Patients


2. Cliquez sur Demandes en attente

Un nombre apparaît à côté de Demandes en attente. Il indique le nombre de demandes figurant actuellement dans la liste. S'il n'y a pas de nombre, il n'y a aucune demande en attente.



Liste des patients en attente							
Rechercher un patient en :							
Exporter les données							
Nom du patient	Prénom du patient	MRN	Sexe	Date de naissance	Nom du fournisseur de soins de santé	Statut	
Green	George		Homme	mars 03, 2004	John Smith	En attente	Accepter Refuser
1 Total							« « 1 » » »

3. Cliquez sur « Accepter » pour l'ajouter à votre clinique



- Lorsque vous cliquez sur Accepter, vous êtes invité à l'affecter à un fournisseur de soins de votre clinique.
- Si vous cliquez sur Refuser, sa demande est supprimée et il n'est pas ajouté à la liste de la clinique.

L'utilisateur du MGC Eversense reçoit un e-mail pour l'informer lorsque vous avez accepté ou rejeté sa demande.

Modifier

L'autorisation **Modifier** permet d'afficher et modifier les informations d'un patient dans DMS Pro et de désinscrire un patient de la liste de la clinique du DMS Pro Eversense. Toute modification apportée dans DMS Pro ne modifie aucune information enregistrée par le patient dans son compte personnel.

3


Pour modifier les informations d'un patient :

1. Cliquez sur Patients 

2. Cliquez sur 

3. Une fenêtre apparaît avec ses informations

Vous pouvez modifier toutes ses informations, excepté son adresse électronique.

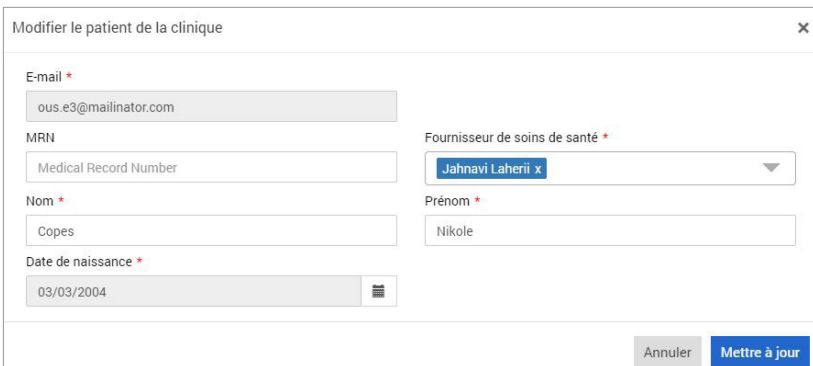

Modifier le patient de la clinique

E-mail *
ous.e3@mailinator.com

MRN
Medical Record Number

Fournisseur de soins de santé *
Jahnavi Laheri x

Nom *
Copes

Prénom *
Nikole

Date de naissance *
03/03/2004

Annuler Mettre à jour

Pour désinscrire un patient de la clinique :

1. Cliquez sur Patients 

2. Cliquez sur 

3. Cliquez sur « Oui »

Le patient est alors retiré de la liste de la clinique de DMS Pro et vous ne pourrez plus afficher ses données Eversense.

L'autorisation Modifier vous permet également d'accepter les Demandes en attente des patients qui souhaitent rejoindre la clinique. Voir *Pour accepter la demande d'un patient* pour plus d'informations.

Administrateur

L'autorisation **Administrateur** vous donne toutes les autorisations d'**Afficher**, **Ajouter** et **Modifier** plus la possibilité d'ajouter, modifier et supprimer des membres du personnel. Pour en savoir plus sur les autorisations **Administrateur**, voir *Administrateur DMS Pro Eversense*.

4. Tableau de bord du DMS

Affichage de données patient du DMS Eversense

Lors de l'ajout d'un patient à votre clinique, vous pouvez cliquer sur son nom pour ouvrir une page d'accueil avec ses données du DMS Eversense. Cette page est pratiquement identique à ce que voit le patient lorsqu'il se connecte à son compte personnel du DMS Eversense.

4

Nom du patient: Jane Abraham Âge: NaN Sexe: Femme MRN: MRN123 ✉ alruser@mailinator.com 👤 Sens Sens, CAN

7 derniers jours 14 derniers jours 30 derniers jours 60 derniers jours 90 derniers jours Plage personnalisée

Paramètres du glucose

IMPORTANT : toute modification apportée aux paramètres ou aux plages de dates dans DMS Pro N'affectera PAS les paramètres des patients, le compte DMS Eversense ni l'application mobile Eversense.

Le nom, l'âge, le sexe, le MRN, l'e-mail et le professionnel de santé affecté apparaissent en haut de la page d'accueil.

Vous pouvez quitter cette page à tout moment en cliquant sur  dans l'angle supérieur droit de la fenêtre ou sur Fermer en bas à droite de la fenêtre.

La page d'accueil comporte plusieurs sections :

- Sélecteur de plage de dates
- Temps de port quotidien d'Eversense
- Profil de glucose ambulatoire (AGP)
- Rapports
- Informations système
- Raccourcis d'impression ou d'e-mail

Aucune donnée n'apparaît avant que le patient ait chargé des valeurs glycémiques du capteur depuis l'application mobile Eversense ou son Smart Transmetteur.


IMPORTANT : si la synchronisation automatique est activée pour le patient, ses données seront chargées automatiquement dans le DMS depuis son application mobile. Il peut aussi charger manuellement ses taux de glucose depuis son Smart Transmetteur via un câble USB. Pour plus d'informations sur le chargement de données, consultez le site Web eversensediabete.com afin de consulter le Guide de l'utilisateur du système de gestion des données (DMS) Eversense.

Configuration de la plage de dates

Vous pouvez voir en haut de la page d'accueil des rapports pour une plage de dates prédéfinie ou pour une plage de dates personnalisée que vous définissez.

Pour régler les paramètres de plage de dates :

1. Si vous voulez afficher un jeu de données en dehors des plages de dates prédéfinies, cliquez sur le bouton « **Plage personnalisée** » pour afficher un calendrier déroulant.



Une fenêtre contextuelle apparaît et permet de sélectionner votre plage de dates personnalisée.

Remarque : les données accessibles dans DMS Pro couvrent une année entière

2. Sélectionnez la *Date de début* du rapport souhaitée
3. Sélectionnez la *Date de fin* du rapport souhaitée
4. Cliquez sur « **OK** » une fois terminé





Tableau de bord du DMS Eversense

Le Tableau de bord du DMS Eversense est la page par défaut que votre patient voit à chacune de ses connexions au DMS. Cette page contient le Temps de port quotidien d'Eversense du patient, les rapports Captur AGP et les Informations système du patient.

Temps de port quotidien d'Eversense

Le **Temps de port quotidien d'Eversense** est le pourcentage de temps de port du Smart Transmetteur sur la plage de dates sélectionnée par le patient. 100 % correspond à 23,5 heures quotidiennes de port du Smart Transmetteur. Ce pourcentage n'inclut pas les temps pendant lesquels le glucose n'est pas affiché. Par exemple : le début de la phase d'initialisation ou lorsqu'une alerte est activée et empêche d'afficher le taux de glucose.

🕒 Temps de port quotidien d'Eversense
44,54 %

Informations système : la section **Informations système** se situe en haut du Tableau de bord AGP.

Cette section affiche les données patient suivantes :


- Numéro de série du transmetteur
- Numéro de série du capteur
- Paramètres du glucose : il est possible de modifier les paramètres du glucose dans le DMS et dans l'application mobile Eversense (voir *Paramètres* pour plus d'informations).

Informations système	Paramètres du glucose		
Transmetteur: 95364	Cible	Faible: 4,2 mmol/L	Élevé: 6,7 mmol/L
Sensor: 58554	Alerte	Faible: 3,3 mmol/L	Élevé: 19,4 mmol/L

Captur AGP dans le DMS Eversense

Le rapport principal du Tableau de bord du DMS Eversense est le rapport Captur AGP (Profil de glucose ambulatoire). Le rapport AGP affiche des données de glycémie dans 3 de ses sections.

4



Statistiques du taux de glucose : mesures concernant vos données de glycémie



- Glucose moyen : toutes les valeurs de glucose additionnées, le tout divisé par le nombre de résultats
- Estimation HbA1c : calculée à partir des valeurs de glucose AGP ; peut différer d'un laboratoire A1c en raison de différentes périodes de temps
- Plages de glucose : idéalement, les valeurs du taux de glucose sont dans la plage cible
 - Faible / très faible : objectif : aucune valeur faible ou très faible ; réduire les valeurs faibles permet au patient de se sentir mieux
 - Élevé / très élevé : objectif : aucune valeur élevée ou très élevée ; réduire les valeurs élevées permet de réduire la valeur A1c du patient au fil du temps
- SD (écart type) : niveau de variation dans un jeu de données ; idéalement un nombre faible
- CV (Coefficient de variation) : écart entre les valeurs et la moyenne ; idéalement un nombre faible

Profil de glycémie : les profils de glycémie quotidiens sont combinés pour créer l'image d'un jour (24 heures). Idéalement, les lignes restent dans la zone grisée (plage cible). Les lignes ne peuvent pas la traverser complètement, car le patient ne peut pas effectuer un test à toutes les heures de la journée.


Orange : ligne médiane (au milieu) séparant les valeurs de glucose en deux avec la moitié supérieure des valeurs d'une part et la moitié inférieure des valeurs d'autre part ; idéalement, cette ligne orange est généralement plate et à l'intérieur de la zone grisée

Bleu : la zone située entre les lignes bleues représente 50 % des valeurs de glucose ; idéalement, l'espace entre les deux est étroit

Vert : 10 % des valeurs sont au-dessus (ligne supérieure située au niveau des 90 %) et 10 % des valeurs sont en dessous (ligne inférieure située au niveau des 10 %) ; idéalement, ces lignes vertes doivent être situées au plus proche de la zone grise



Profils journaliers de glycémie : chaque boîte comprend le modèle de glucose d'un seul jour. Elle n'apparaît que si la plage de dates est définie sur 14 jours ou moins.



5. Rapports


Les rapports offrent différentes manières d'organiser et de visualiser les valeurs du taux de glucose dans le temps.

Remarque : si vous sélectionnez un rapport et qu'aucune donnée n'est affichée, vérifiez que vous avez sélectionné une plage de dates sur laquelle des données sont disponibles.

IMPORTANT : si la synchronisation automatique n'est pas activée, les données ne sont pas envoyées automatiquement de l'application mobile Eversense au DMS.

Imprimer ou envoyer par e-mail le contenu des rapports

Vous trouverez en haut à droite de la page d'accueil des options d'impression et d'envoi par e-mail de rapports de la page d'accueil.



Cliquez sur			
Pour	Type de rapport	Envoyer le rapport par e-mail	Enregistrer le rapport au format PDF
Comment	Sélectionnez le rapport à imprimer ou à envoyer par e-mail.	Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour envoyer par email un rapport imprimable à un destinataire que vous spécifierez.	Cliquez sur l'icône pour convertir le rapport au format PDF, ce qui vous permettra de l'imprimer.


Options de rapports

Pour afficher les différentes options de rapports, cliquez sur le nom du rapport dans le volet de droite de la page d'accueil.

Remarque : si vous sélectionnez un rapport et qu'aucune donnée n'apparaît, vérifiez les points suivants :


- Développez la plage de dates que vous avez sélectionnée. S'il n'y a aucune donnée sur l'ensemble de la plage de dates des 90 derniers jours, il est possible que le patient n'ait pas activé la synchronisation automatique dans l'application mobile MGC Eversense. Si la synchronisation automatique n'est pas activée, demandez au patient de l'activer.
- Demandez également au patient de réaliser un chargement manuel en touchant « **Lancer la synchronisation** » dans l'application mobile MGC Eversense.

5



Certains rapports peuvent être filtrés pour afficher certaines informations. Vous pouvez sélectionner quels types d'événements, jours de la semaine et autres options apparaîtront dans les rapports en cliquant sur  à côté du nom du rapport.

Ce filtre n'est pas disponible pour les rapports AGP, Durée de conservation dans la plage par heure de la journée ni Durée dans la cible.



Durée dans la cible


Le rapport Durée dans la cible présente un diagramme en secteurs qui analyse le pourcentage du temps pendant lequel le taux glucose de votre patient est en-dessous, au-dessus ou à l'intérieur de la plage cible définie par le patient dans les Paramètres du glucose.

Affichage du rapport :

La partie verte représente le pourcentage de temps que le patient a passé dans la plage cible.

La partie grise représente le pourcentage de temps que le patient a passé au-dessus de la plage cible.

La partie rouge représente le pourcentage de temps que le patient a passé sous la plage cible.



Durée dans la plage

Durée de conservation dans la plage par heure de la journée

Le rapport Durée de conservation dans la plage par heure de la journée présente un ensemble de diagrammes en bâtons qui analysent le pourcentage du temps que le glucose de votre patient passe dans les plages de glucose prédéfinies.


- Très faible : <54 mg/dl ou <3,0 mmol/l
- Faible : 54-70 mg/dl ou 3,0-3,9 mmol/l
- Dans la cible : 70-180 mg/dl ou 3,9-10,0 mmol/l
- Élevé : 180-250 mg/dl ou 10,0-13,9 mmol/l
- Très élevé : >250 mg/dl ou >13,9 mmol/l

Ce rapport comporte deux sections :

Durée dans la plage

Représente le pourcentage global du temps passé par le patient dans les plages de glucose prédéfinies en fonction de la plage de dates sélectionnée.


Durée dans la plage



Durée de conservation dans la plage par heure de la journée

Cette section du rapport divise le graphique global de Durée dans la plage en différentes heures de la journée segmentées. Vous pouvez visualiser les données de votre patient en segments de 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Sélectionnez pour cela une option en haut à droite du rapport.

Chaque segment affiche un pourcentage de temps pendant lequel le taux de glucose de votre patient était sur les mêmes segments Très faible, Faible, Dans la cible, Élevé et Très élevé.



Rapport de variabilité du glucose

Le Rapport de variabilité du glucose affiche des informations de deux manières :

Graphe de tendance :

- Affiche un résumé des valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures.
- Comprend des données sur plusieurs jours, rassemblées sur un même graphe.
- Montre les valeurs du taux de glucose maximum, minimum et moyenne sur chaque heure.
- Donne un récapitulatif visuel des variations de taux de glucose de votre patient sur la journée.

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur moyenne du taux de glucose pour faire apparaître les détails sur ces valeurs pendant l'heure concernée.

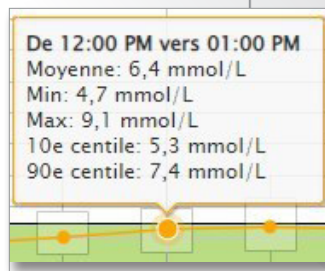



Tableau :

- Structure les données du taux de glucose par tranches de 4 heures.
- Fournit une analyse statistique détaillée pour chacune des périodes.
- Comprend un pourcentage de valeurs qui sont dans la plage cible, au-dessus de celle-ci ou en dessous de celle-ci.
- Donne le détails des quantités d'insuline et de glucides entrées sur chacune des périodes.

Remarque : si vous rencontrez des problèmes pour afficher le rapport, essayez de limiter votre plage de dates. Si la quantité de données est anormalement grande, le rapport peut ne pas fonctionner.

Glucose	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	Total
% en dessous de l'alerte d'hypoglycémie	-	-	-	-	-	-	-
% au-dessus de l'alerte d'hyperglycémie	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de valeurs en dessous de l'alerte d'hypoglycémie	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de valeurs au-dessus de l'alerte d'hyperglycémie	-	-	-	-	-	-	-
% dans la cible	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
% en dessous de la cible	-	-	-	-	-	-	-
% au-dessus de la cible	-	-	-	-	-	-	-
Taux de glucose moyen	5.7 mmol/L	5.7 mmol/L	5.7 mmol/L	5.8 mmol/L	5.8 mmol/L	5.7 mmol/L	5.7 mmol/L
Taux de glucose le plus faible	4.9 mmol/L	4.9 mmol/L	4.2 mmol/L	4.9 mmol/L	4.8 mmol/L	4.9 mmol/L	4.2 mmol/L
Taux de glucose le plus élevé	6.3 mmol/L	6.6 mmol/L	7.4 mmol/L	7.7 mmol/L	7 mmol/L	6.9 mmol/L	7.7 mmol/L
Écart type	0.3 mmol/L	0.3 mmol/L	0.3 mmol/L	0.5 mmol/L	0.4 mmol/L	0.4 mmol/L	0.4 mmol/L
Nbre de valeurs dans la plage 10 - 90 centiles	239	157	216	264	268	314	1,412
Nbre total de valeurs du taux de glucose	290	187	262	322	317	368	1,746
Nbre de jours avec une valeur au moins	7	5	7	7	8	8	8
Nbre moyen de valeurs par jour	41	37	37	46	40	46	218

Rapport de tendance du taux de glucose


Rapport Tendance taux glucose :

- Affiche toutes les valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures.
- Comprend des données sur plusieurs jours, rassemblées sur un même graphe.
- Permet d'identifier facilement la variabilité sur plusieurs jours de la semaine.

Affichage du rapport

Les points qui apparaissent dans le rapport sont codés par couleurs, chaque couleur correspondant à un jour de la semaine. Vous pouvez utiliser le filtre de rapport pour choisir le ou les jours à afficher sur le graphe.

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur glycémique du capteur pour afficher les détails concernant cette valeur.



Valeurs glycémiques du capteur
6,4 mmol/L
3/24/2022 10:20:30 AM
Jeudi


Rapport d'historique des taux de glucose

Le rapport Historique taux glucose affiche un historique des valeurs MGC et des valeurs entrées manuellement sous forme d'un graphe de tendance. Le rapport Historique taux glucose offre un moyen efficace de surveiller les valeurs glycémiques du capteur et les étalonnages du système.

Affichage du rapport

Chaque point de donnée est une valeur glycémique du capteur. Les événements qui ont été entrés par le patient dans l'application mobile sont affichés dans le rapport à l'heure à laquelle ils ont été entrés. Si vous sélectionnez une plage de dates de plus de 30 jours, des événements comme les repas ou les quantités d'insuline ne s'affichent pas.

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur glycémique du capteur pour afficher les détails concernant cette valeur. Vous pouvez aussi placer votre curseur sur une icône d'événement pour afficher les détails concernant cet événement.

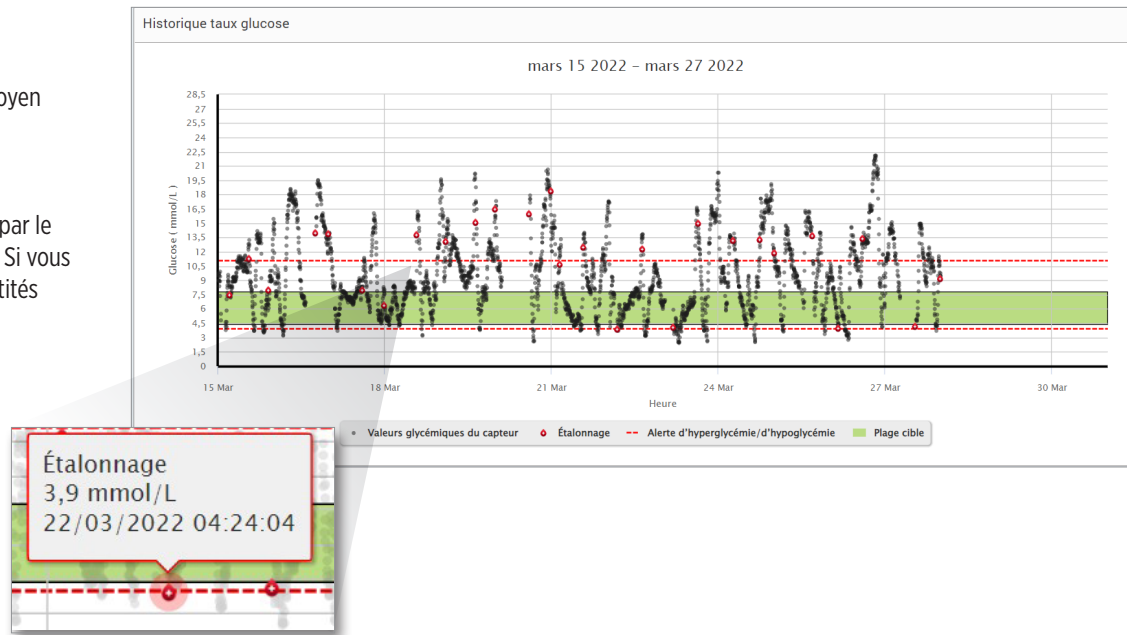

Rapport de glucose quotidien


Le rapport quotidien de taux de glucose affiche les valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures pour plusieurs jours de suite.

Le rapport de glucose quotidien :

- Présente des niveaux cibles du glucose fixes de 70 à 180 mg/dl (3,9 à 10,0 mmol/l).
- Présente les niveaux d'alerte de taux de glucose élevé et faible (lignes rouges) définis par l'utilisateur du MGC.
- Affiche des statistiques importantes pour chaque journée sur la base des réglages d'alerte et de cible de glucose.
- Inclut une option d'affichage d'icônes d'événements sur le graphe de tendance et de développement d'un tableau des événements pour chaque journée.

Affichage du rapport

Le rapport de glucose quotidien affiche plusieurs jours à la suite pour la plage de dates sélectionnée, et permet d'identifier des tendances de glucose sur plusieurs jours. Les statistiques pour chaque journée apparaissent à droite du graphe de tendance et reposent sur la plage cible du glucose standard de 70 à 180 mg/dl (3,9 à 10,0 mmol/l) et sur les niveaux d'alerte de taux de glucose élevé et faible définis par le patient. Pour consulter plus d'informations MGC pour la journée (alertes, étalonnages, événements que vous avez entrés dans l'application MGC), vous pouvez activer l'affichage d'icônes d'événements sur le graphe de tendance et développer le tableau des événements à côté du graphe de tendance pour afficher plus d'informations. Le tableau des événements développé présente des informations par incréments de 4 heures correspondant aux segments de 4 heures sur le graphe de tendance.

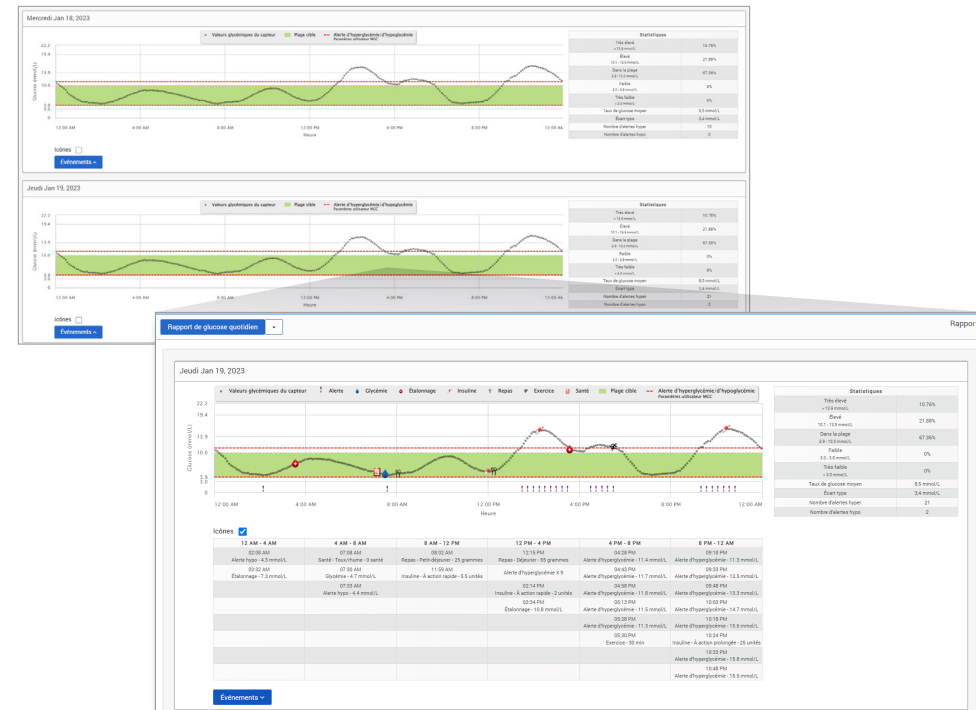

Statistiques :

Le tableau des statistiques présente une analyse du pourcentage de temps pendant lequel le taux de glucose de votre patient était sur les plages de glucose prédéfinies.


- Très faible : <54 mg/dl ou <3,0 mmol/l
- Faible : 54 à 70 mg/dl ou 3,0 à 3,9 mmol/l
- Dans la cible : 70 à 180 mg/dl ou 3,9 à 10,0 mmol/l
- Élevé : 180 à 250 mg/dl ou 10,0 à 13,9 mmol/l
- Très élevé : >250 mg/dl ou >13,9 mmol/l

Inclut le taux de glucose moyen quotidien, l'écart type et le nombre d'alertes hautes et basses.

Icônes et événements :

Les icônes et événements apparaissent en fonction des réglages d'alerte de taux de glucose de votre patient, des étalonnages et de tout événement entré dans l'application MGC.

Remarque : si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les réglages d'alerte MGC pour le rapport dans DMS Pro. (Les réglages des cibles de glucose sont fixés à 70 à 180 mg/dl (3,9 à 10,0 mmol/l) et ne peuvent pas être modifiés.) Un ajustement des réglages des cibles de glucose modifie la position des lignes d'alerte rouges sur les graphes de tendances MGC quotidiennes, mais pas les statistiques quotidiennes. Cela peut faciliter les décisions concernant le réglage optimal pour une alerte de taux de glucose élevé ou faible.

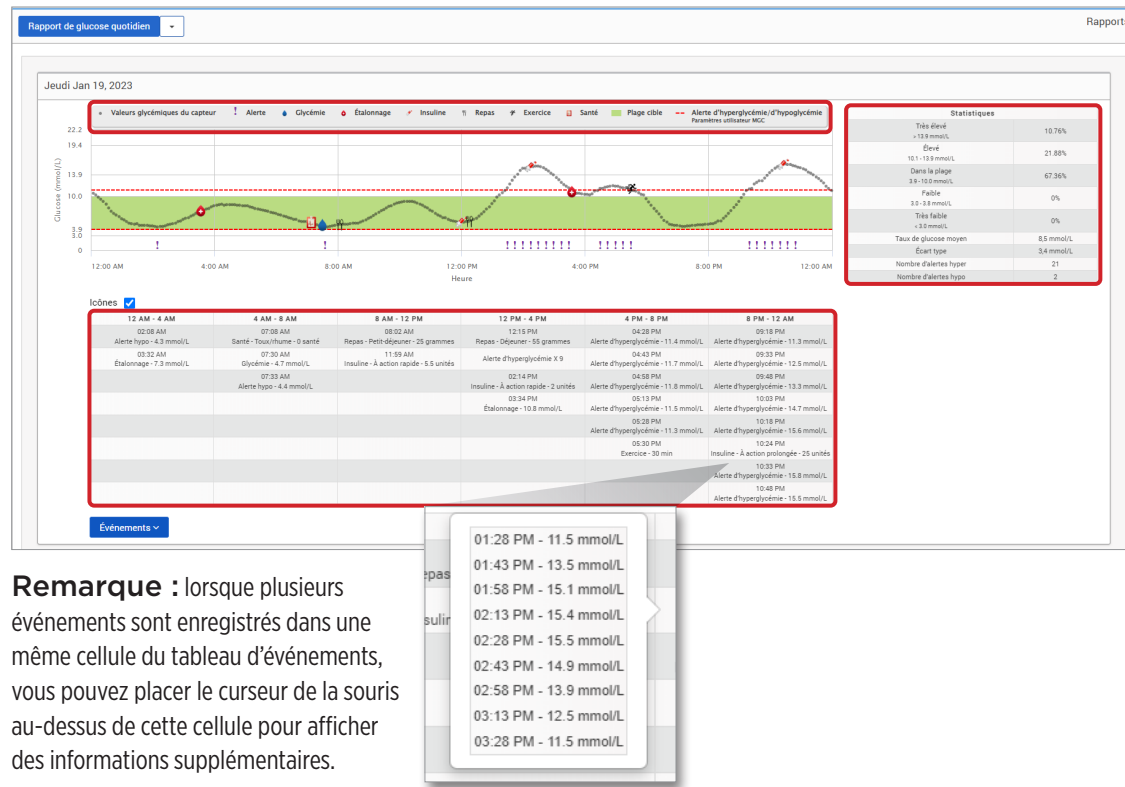

Remarque : lorsque plusieurs événements sont enregistrés dans une même cellule du tableau d'événements, vous pouvez placer le curseur de la souris au-dessus de cette cellule pour afficher des informations supplémentaires.


Rapport de distribution du glucose

Rapport de distribution du glucose :

- Structure les valeurs du taux de glucose de votre patient recueillies selon ses plages cibles et des seuils d'alerte et affiche les données sous forme de graphique à secteurs.
- Affiche un graphique à secteurs pour la période en cours et pour les périodes précédentes.
- Les plages cibles se règlent sous Paramètres du glucose.
- Permet de représenter visuellement le nombre de valeurs qui sont dans la plage cible sur une plage de dates prédéfinie sélectionnée et les variations au cours du temps.

Affichage du rapport

Le rapport de distribution du glucose affiche deux graphiques à secteurs pour la plage de dates que vous avez sélectionnée. Il montre le jeu de données actuel et précédent de la plage de dates sélectionnée. Ces données vous permettent de comparer visuellement les valeurs actuelles et les anciennes valeurs pour la prise en charge de votre patient.

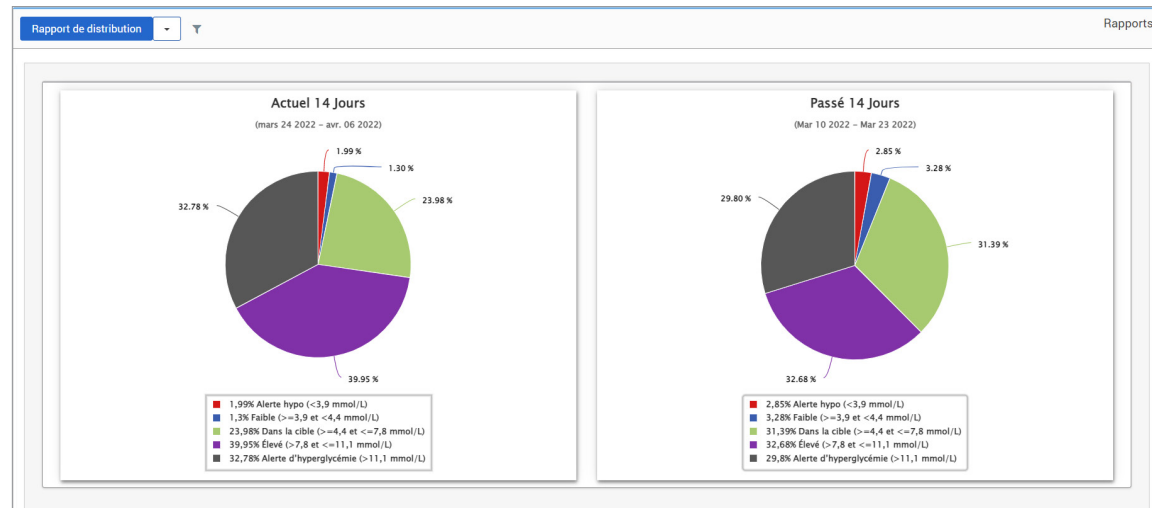

Rapport du journal du transmetteur

Le Rapport du journal du transmetteur propose un examen complet des données sur la plage de dates sélectionnée.

Le Rapport du journal du transmetteur présente trois tableaux distincts :

- **Glycémie** : affiche une liste de tous les événements de glycémie et associés entrés manuellement par ordre chronologique.
- **Entrées d'événements** : affiche les événements patient entrés depuis l'application mobile Eversense.
- **Valeurs glycémiques du capteur** : affiche les valeurs du taux de glucose relevées par le capteur.




Affichage du rapport


Les événements s'affichent avec des informations sur la date, l'heure et :







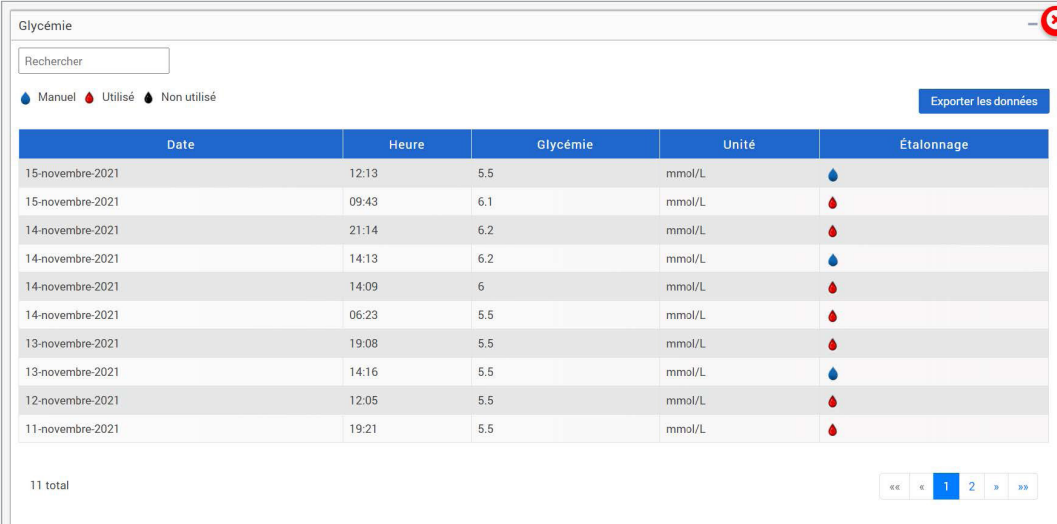



- **Glycémie** : valeur du taux de glucose, unité, étalonnage
- **Entrées d'événements** : type d'événement, sous-type d'événement, valeur
- **Valeurs glycémiques du capteur** : valeur du taux de glucose, unité, ID du capteur

Les événements peuvent être triés par ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le titre de la colonne correspondant. Le nombre d'entrées est indiqué en bas de chaque journal.

Un symbole sous la colonne « **Étalonnage** » du tableau Glycémie indique si une valeur du taux de glucose a été  Utilisé pour l'étalonnage,  Non utilisé ou  Manuel.

-  **Utilisé** : une valeur de glycémie que votre patient a entrée dans l'application mobile Eversense comme étalonnage et qui est acceptée par le système.
-  **Non utilisé** : un étalonnage qui a été entré et qui est supérieur à 400 mg/dl (22,2 mmol/l) ou inférieur à 40 mg/dl (2,2 mmol/l).
-  **Manuel** : une valeur de glycémie qui n'a pas été entrée comme étalonnage.



Date	Heure	Glycémie	Unité	Étalonnage
15-novembre-2021	12:13	5.5	mmol/L	
15-novembre-2021	09:43	6.1	mmol/L	
14-novembre-2021	21:14	6.2	mmol/L	
14-novembre-2021	14:13	6.2	mmol/L	
14-novembre-2021	14:09	6	mmol/L	
14-novembre-2021	06:23	5.5	mmol/L	
13-novembre-2021	19:08	5.5	mmol/L	
13-novembre-2021	14:16	5.5	mmol/L	
12-novembre-2021	12:05	5.5	mmol/L	
11-novembre-2021	19:21	5.5	mmol/L	

Exportation de données

Depuis la page Rapport du journal du transmetteur, vous pouvez également exporter les données au format .xlsx.

1. Sélectionnez **Rapports > Journal du transmetteur**

2. Sélectionnez « **Exporter les données** » en haut de chaque tableau pour exporter les données au format .xlsx (feuille de calcul Excel)

Valeurs glycémiques du capteur

[Exporter les données](#)




DATE	HEURE	VALEURS GLYCÉMIQUES DU CAPTEUR	UNITÉ	ID DU CAPTEUR
27-mars-2022	23:59	9.4	mmol/L	262344
27-mars-2022	23:54	9.7	mmol/L	262344



6. Paramètres

Glucose

Les paramètres du glucose vous permettent de personnaliser les niveaux des cibles et alarmes du taux de glucose dans les rapports. Ce paramètre affecte la manière dont le glucose et d'autres données d'événements sont structurés et affichés dans les rapports. Lorsque le patient synchronise ses données sans fil via de l'application mobile, les paramètres du glucose qu'il a téléchargés sur son application seront aussi synchronisés dans son compte DMS.

IMPORTANT : les paramètres du glucose NE sont PAS synchronisés lors du chargement de données depuis le Smart Transmetteur via le câble USB.

Nom du patient: Nikole Copes Âge: 18 Sexe: Homme MRN:  ous.e3@mailinator.com  Jahnavi Laherii 

7 derniers jours 14 derniers jours 30 derniers jours 60 derniers jours 90 derniers jours **Plage personnalisée**   

Paramètres du glucose

Pour changer les paramètres d'affichage du DMS Pro Eversense, procédez de la manière suivante :

1. Cliquez sur Niveaux du taux de glucose près du haut de l'écran
2. Cliquez sur le bouton mg/dl ou mmol/l sous les Unités de mesure pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée pour les données de glucose.
Si vous changez l'unité de mesure, les valeurs de la plage de glucose et de plage des seuils d'alerte changent en conséquence.
3. Cliquez sur les boutons +/- à droite de Cible hyperglycémie et Cible hypo pour régler les limites haute et basse de votre Plage cible de glucose
4. Recommencez pour la Plage des seuils d'alerte de glucose
5. Une fois les modifications terminées, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications

Remarque : ces paramètres seront enregistrés pour la prochaine fois que vous afficherez les rapports de ce patient, même après vous être déconnecté de DMS Pro. Les paramètres du DMS Pro Eversense n'affectent pas les paramètres du système MGC Eversense des patients ni l'affichage du DMS Eversense.

Paramètres du glucose

Unité de mesure mg/dL mmol/L

Plage cible (doit être comprise dans les paramètres d'alerte)

Cible hyperglycémie* - 12 +

Cible hypo* - 3,8 +

Plage des seuils d'alerte (doit être comprise entre 3,3 et 19,4)

Alerte d'hyperglycémie* - 15 +

Alerte hypo* - 3,6 +

Annuler Enregistrer


Mise à jour réussie

7. Aide

À propos

Cette page présente les dernières versions du DMS Pro Eversense.

IMPORTANT : pour toute question sur votre compte DMS Pro Eversense, veuillez contacter votre distributeur local. Aux États-Unis, appelez le 844-SENSE4U (844-736-7348).

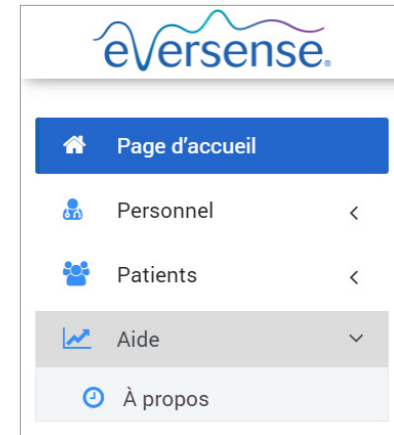

8. Dépannage

1. Mes filtres précédents ne sont plus appliqués lorsque je retourne à ma page d'accueil ou à la page Patients.

- Les filtres sont actualisés lorsque vous quittez la page d'accueil ou l'onglet Patients. Veuillez appliquer à nouveau des filtres pour afficher la liste des patients souhaitée.

2. Si le seul administrateur de la clinique supprime involontairement ses privilèges d'administrateur, veuillez contacter le service clientèle.

3. Les utilisateurs du MGC en Allemagne peuvent refuser de créer un compte Eversense. Ces utilisateurs ne peuvent pas partager de données avec le DMS Pro Eversense.

Basic UDI/DI:
- Eversense DMS Pro: 081749102FG5800U5

Vertrieben von: | Distribuito da: | Distribué par :

Deutschland

Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH
51355 Leverkusen
Deutschland
0800 5088844

www.ascensia.com/eversense

Für Kundendienst 0800 5088844 anrufen.

Italia

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano – Italia
800608368

www.ascensia.com/eversense

Chiamare 800608368 per l'Assistenza Clienti.


Schweiz / Svizzera / Suisse

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
CH-4052 Basel
061 544 79 90

www.ascensia.com/eversense

Appeler 061 544 79 90 pour le support clientèle.



 **Senseonics, Inc.**
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
global.eversenseddiabetes.com

Patente:| Brevetti:|Brevets :
www.senseonics.com/products/patents



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy global BV
EU: Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123, The Hague
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



MedEnvoy Switzerland
CH: Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



(241) LBL-4207-50-201_REV_E

Dimensions	
Trim: 11.75" w X 5" h	Bleed: 0.125"
Folded <i>(Include folded dimensions if applicable)</i> :	

Colors: 4/color
Spot <i>(Name PMS colors if applicable)</i> : N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text